

## Proc. Administrativo 896/2024

**De:** Jailton S. - SEADM-DESUP

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 12/12/2024 às 16:43:08

**Setores envolvidos:**

SEADM-DESUP

### Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Boa tarde! Anexo aos autos o [Memorando 11.395/2024 - Envio de DFD | Insumos Odontológicos](#) referente a Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

—  
**Jailton Pereira Dos Santos**  
*Divisão de Licitações e Contratos*

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/634E-260D-2887-395A> e informe o código 634E-260D-2887-395A



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 634E-260D-2887-395A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/12/2024 16:43:18 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/634E-260D-2887-395A>

## Memorando 11.395/2024

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

**Para:** SEADM - Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

**Data:** 25/06/2024 às 15:54:50

**Setores envolvidos:**

SEADM, SMS, SMS-DAS-DAS-CEODON, SMS-DGS-AQUI

### Envio de DFD | Insumos Odontológicos

Prezados,

Segue a manifestação desta Secretaria sobre a demanda para a Aquisição de insumos odontológicos para atendimento da Seção de Saúde Bucal, acompanhada do Documento de Formalização de Demanda (DFD) devidamente preenchido e justificado.

Sem mais.

—  
**Bruna Morelli R. Pereira**  
Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

**Anexos:**

2\_de\_2024\_DFD\_002\_de\_2024\_Documento\_de\_formalizacao\_de\_demanda\_Insumos\_Odontologicos.pdf

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD Nº 002/2024 – SMS/SSB**

**TIPO DA DEMANDA:**

- ( ) Serviços e fornecimentos contínuos (art. 6º, inc. XV)  
( ) Serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra (art. 6º, inc. XVI)  
( ) Serviços não contínuos ou contratados por escopo (art. 6º, inc. XVII)  
( ) Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual (Art. 6º, inc. XVIII)  
( ) Serviço de obra e/ou engenharia  
(X) Aquisição de material de consumo  
( ) Aquisição de bens e/ou materiais permanentes ( ) Locações  
( ) Outro: \_\_\_\_\_

**I – DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA**

Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP, a fim de garantir a continuidade dos atendimentos odontológicos prestados à população. Justificado também pelo termino de vigência da ATA 55/2023 do PREGÃO 64/2023, em 14/08/2024.

Previsão de consumo: 12 (doze) meses da Abertura de Ata de Registro de Preços.

**II – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO**

A aquisição dos materiais odontológicos tem como finalidade assegurar o acesso à população aos atendimentos odontológicos ofertados na rede de atenção básica do Município de Cajati/SP, resguardando os princípios de equidade e justiça social. Vale ainda mencionar a Lei nº 14572/2023, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para incluir a saúde bucal no campo de atuação do SUS. Buscando garantir acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no SUS. As principais diretrizes do programa são baseadas no direito de todos os brasileiros a um sorriso saudável, parte fundamental para uma vida digna, aumento da autoestima e o exercício da cidadania.

**III – QUANTIDADE A SER CONTRATADA (CONSIDERAR A EXPECTATIVA DE CONSUMO ANUAL)**

A quantidade estimada de aquisição dos insumos odontológicos, com previsão anual, segue abaixo relacionados:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	100 PCT	<b>ABAIXADOR DE LÍNGUA COM SABOR, PONTA ANIMAIS, PCT COM 40 UND</b> – Especificação técnica: Abaixador de Língua com aroma, sabor de Tutti-Frutti, ponta animais; pacote com 40 unidades cada, embalados individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto; cada abaixador deve ser decorado com figuras de animais em cores sortidas; produzido em plástico atóxico, livre de toxicidade, que não irrita, sem açúcar, sem látex e sem medicamentos; não esterilizável; descartável/uso único; higienizado; colorido com dióxido de titânio rutilo e pigmentos orgânicos; com aroma artificial de Tutti-Frutti; dimensões (unidade): 124 mm x 16 mm x 3 mm. Certificações: Aprovação pelo FDA, possuir testagens de biocompatibilidade feitas periodicamente no Brasil e nos Estados Unidos desde 1999 a cada dois anos e produzido de acordo com as normas ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e RDC 59/ BPF e Registro ANVISA: 10438720003.



2	10 KITS	<b>ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO EM KIT (1 ADULTO e 1 CRIANÇA), EM SILICONE ATÔXICO</b> – Especificação técnica: Abridor de boca anatômico; em Kit (1 unidade tamanho adulto e 1 unidade tamanho infantil); formato trapezoidal com ranhuras laterais; em silicone atômico; esterilização em meios físico-químicos; garantia mínima de 01 ano a partir da entrega; Kit embalado individualmente, em material apropriado que garanta integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
3	10 UND	<b>ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM 4 MEDIDAS</b> – Especificação técnica: Abridor de boca anatômico; para Pessoas com Deficiência, reposição compatível com Abritec PCD/Indusbello; com 4 medidas diferentes em um único produto (14mm, 20mm, 26mm e 32mm); em silicone atômico; esterilização em meios físico-químicos; garantia mínima de 1 ano; embalagem individual, em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
4	15 PTS	<b>ABRASIVO EM PÓ, PEDRA POMES, PARA PROFILAXIA DENTAL, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, POTE C/100 GRAMAS</b> - Abrasivo, em pó, pedra pomes, para polimento e profilaxia dental, granulação extrafina, embalado em pote com 100 gramas, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
5	30 KITS	<b>ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA</b> - em pontas de silicone flexíveis ;impregnadas com óxido de alumínio, não produzindo calor excessivo; caixa com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Composição de tri polímero (estireno Butadieno-Metacrilato de Metila) Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetanolamina e óxido de alumínio .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
6	60 UND	<b>ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL</b> - Sistema de adesivo de frasco único (prime e adesivo), com tampa flip top e bico dosador, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, sistema adesivo com nanotecnologia, contendo cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Utilizado nas técnicas de condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), auto condicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte, indicado para restaurações diretas e indiretas, sem a necessidade de aplicação de um primer metálico e silano.Composição: Metacrilato de 2- hidroxietila (15 a 25% em peso), Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA) (15 a 25% em peso), Decametileno dimetacrilato (5 a 15% em peso), Etanol (10 a 15% em peso), Sílica tratada de silano (5 a 15% em peso), Água (10 a 15% em peso), 1,10-Decanodiol fosfato metacrilato (1 a 10% em peso), Copolímero de acrílico e ácido itacônico (1 a 5% em peso), Caforoquinona (menor que 2% em peso), N-Dimetilbenzocaína (menor que 2% em peso). Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

7	200 GALÕES	<b>ÁGUA DEIONIZADA</b> – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega.
8	10 CX	<b>AGULHA GENGIVAL 27G LONGA</b> - Agulha gengival longa em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
9	60 CX	<b>AGULHA GENGIVAL 30G CURTA</b> - Agulha gengival curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
10	25 CX	<b>AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA</b> - Agulha Gengival 30G extra curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médico, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
11	20 LT	<b>ALCOOL ETILÍCO 92,8 IGPM (CATEGORIA COMERCIAL) - FRASCO COM 1 LITRO</b> - Líquido; com teor de no mínimo 92,8 IGPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rotulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Com registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
12	800 LT	<b>ALCOOL ETILÍCO A 70 % PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES – FRASCO COM 1 LITRO</b> – Indicado para desinfecção de superfícies e artigos semi e não críticos; frasco de 1 litro, contendo dados de identificação, nº de lote, validade e responsável técnico; em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesse atender a legislação atual vigente. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
13	120 CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000</b> - Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) +Epinefrina 10 µg /mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, cada embalagem contém 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

14	15 CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML</b> - Anestésico local injetável, a base de lidocaína a 3% e norepinefrina, tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as normas de procedimentos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
15	5 CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2 % SEM VASOCONSTRITOR</b> - Tubetes com 1.8 ml, embalados em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
16	60 UND	<b>ANESTÉSICO TÓPICO GEL</b> - Frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel, benzocaina a 20%, hidrossolúvel, em pote, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
17	150 UND	<b>BABADOR DESCARTÁVEL</b> – Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável; folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico; maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades.
18	10 UND	<b>BICARBONATO DE SÓDIO</b> - Bicarbonato de sódio odontológico; pó extrafino para polimento e profilaxia dental, pureza (99,6%), sem aroma, sem corantes; em frasco plástico; acondicionados em pote de 250g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, o produto deverá obedecer a legislação vigente; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
19	100 UND	<b>BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 COM CABO E LÂMINA</b> - Composto por um cabo plástico resistente, com lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
20	100	<b>BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 COM CABO E LÂMINA</b> - Composto por um cabo plástico resistente, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
21	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

22	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
23	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
24	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
25	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
26	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
27	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.



28	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
29	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
30	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
31	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
32	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
33	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

34	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
35	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
36	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
37	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
38	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
39	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

40	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
41	30 UND	<b>BROCAS ZÉCRYA HL</b> - Broca do tipo Zécrya número 151, formato tronco-cônico, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Utilizada para odontosecção e corte/desgaste de osso. Ideal para cirurgia de ciso incluso. Tamanho: 28 mm de comprimento total. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
42	15 UND	<b>BLOCO PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO</b> – Bloco para espatulação; de papel plastificado; tamanho de 15cm x 8cm aproximadamente; com 50 Folhas; embalagem que garanta a integridade do produto.
43	30 PCT	<b>CANUDO DESCARTAVEL EM PP, DIAM. 5,5 mm, LISO</b> - Canudo descartável; de polipropileno; com diâmetro de 5,5mm; medindo 210mm; branco, liso e acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto. Embalagem com 100 unidades.
44	30 UND	<b>CARIOSTÁTICO 30 %</b> – Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos proteicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de carióstáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
45	5 UND	<b>CIMENTO CIRÚRGICO</b> – sem eugenol produzido através da mistura de seus componentes, ótima textura e plasticidade após a presa. Produto de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol e cera natural. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido de zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol e BHT. Validade mínima: 2 anos da data de entrega.
46	15 UND	<b>CIMENTO PROVISÓRIO ENDODÔNTICO COM IODOFORMIO</b> – Material temporário para obturação de canal radicular; com Iodofórmio que confere a pasta propriedade anti-infecciosa e intensa radiopacidade; pasta de Hidróxido de Cálcio pronta para o uso; de fácil aplicação; ação anti- bacteriana; que induz a formação de dentina reparadora; com consistência ideal para escoamento no canal radicular; apresentação: 1 seringa de 2,5g e 3 bicos aplicadores. Validade mínima de 12 meses da

		data de entrega.
47	6 UND	<b>CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ. (10ml)</b> - Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de óxido de zinco com até 10% de óxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por ácido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.
48	6 UND	<b>CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO</b> – Benefícios: massa de fácil manipulação; endurecimento rápido; menor microinfiltração marginal. Características: obturador provisório normal. Aplicação: indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos. Apresentação: Embalagem c/25g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
49	150 LT	<b>CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO, EMBALAGEM DE 1 LITRO</b> – Solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de clorhexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo espectro pronto para o uso. Embalagem contendo 1 litro. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
50	20 UND	<b>CLOREXIDINA 2%</b> - Antisséptico com atividade antibacteriana, com eficácias para gram-negativas, fungos leveduras e alguns dermatófilos. Composição- digluconato de clorhexidina 2%, metilparabeno, água deionizada. (livre de álcool etílico) Frascos com 100ml. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.
51	20 UND	<b>COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTE</b> – Capacidade para 05 litros, para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc. Alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853.
52	6.000 UND	<b>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL</b> - Com 13 fios, 7,5x7,5 cm; em 100% de viscose branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras; medindo 7,5cm x 7,5 cm; com formato quadrado; estéril; embalado com 10 unidades cada, embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico e laudo analítico laboratorial, de cumprimento da NBR 13843. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
53	200 PCT	<b>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5x7,5 cm, NÃO ESTÉRIL, PACOTE C/500 UND</b> – Compressa de gaze hidrófila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 5 dobras, 8 camadas, sem filamento radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 cm; com formato quadrado; não estéril; embalado em pacote com 500 unidades que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 anos da data de entrega.
54	60 UND	<b>CONDICIONADOR DENTAL GEL</b> - Gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, espessado com Sílica Coloidal. Composição: Ácido Fosfórico, Sílica Coloidal, Surfactante e Corante. Embalagem com 3 seringas de 3 ml e 3 ponteiros p/ aplicação. Possui corante azul que



		facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
55	10 KITS	<b>CUNHA INTERDENTAL ANATÔMOCA DE MADEIRA, 5 TAMANHOS, CODIF. POR CORES</b> - Embalagem com 100 unidades; Especificação Técnica: Cunha interdental; confeccionada em madeira; formato anatômico da ameia, em 5 tamanhos diferentes codificados por cores; constando externamente quantidade, marca comercial, procedência de fabricação.
56	15 UND	<b>DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM FLUORETO DE SÓDIO 2% E NITRATO DE POTÁSSIO, SER. 2,5g</b> – Gel de baixa viscosidade dessensibilizante oclusivo à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2% que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
57	100 UND	<b>DETERGENTE ENZIMÁTICO</b> - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carbohidrase); sendo as principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; específico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
58	30 UND	<b>ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, (tipo de unha)</b> – Para uso na limpeza de artigos de pequeno e médio porte. Descrição: Escova plástica para limpeza delicada, cor sortida. Dimensões: 9,5 x 2,5 cm.
59	200 UND	<b>ESCOVA ROBSON, PEQUENA, CERDA PLANA, NA COR BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO</b> - Escova de Robson; pequena; para profilaxia; com cerda plana; haste metálica, e cerdas em nylon na cor branca; para contra angulo; embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial, numero de lote, data de fabricação e procedência.
60	20 UND	<b>ESPATULA PARA ODONTO PLÁSTICA, FLEXIVEL, PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO</b> - Especificação Técnica: Espátula para odontologia; de plástico, flexível; para manipulação de Ionometro de Vidro. Medidas aprox. 21,50x3,20x0,50cm (c x l x a); embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
61	100 UND	<b>ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX</b> - Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos, passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto, embalado individualmente, marca comercial, procedência de fabricação.
62	10 UND	<b>ESPELHO TOUCADOR COM CABO, FORMATO DENTE</b> – Espelho de mão para procedimentos clínicos; toucador com cabo; formato dente; disponível em diversas cores; tamanho aproximado de 19,5cm de comprimento. Embalagem com 1 unidade.

63	20 CX	<b>ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UND</b> - Esponja Hemostática produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado; com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; que seja completamente reabsorvida pelo organismo em 15 dias; material atóxico e não pirogênico; esterilizada por raios gama; com material leve com peso aproximado de 10 mg; dimensões: 1x1x1 cm e com Registro ANVISA. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.
64	40 UND	<b>EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA SOLUÇÃO</b> , frasco C/10 ml. Evidenciador de placa bacteriana em solução, em frasco c/10 ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
65	50 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0</b> Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 20 mm- fio agulha de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 2,0 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
66	20 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0</b> - Monofilamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 15 mm- fio agulha de sutura nylon monofilamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
67	30 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 4-0</b> - Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ. – CT 15 mm - Fio agulhado de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 4-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
68	10 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA SEDA, NÚMERO 4-0</b> - Fio de Sutura de Seda Preta. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm.Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.* Esterilizado em Raio Gama.As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Uso exclusivo em Odontologia.Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
69	20 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 5-0, AGULHA 3/8 Cir.</b> - Fio de sutura de nylon obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.5-0, preto trançado, agulhado -3/8 circ. triangular, CT 1,5cm, fio medindo 45 cm, uso odontológico, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ter comprovação de sua esterilidade, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.

70	40 UND	<b>FIO DENTAL</b> - Embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
71	5 UND	<b>FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, Nº. 00, CORDÃO TRANÇADO MALEÁVEL, NÃO IMPREGNADO</b> - Fio para retração gengival; composto por cordão trançado e maleável 100% algodão, não impregnado por substância química, n. 00; embalado em frasco com 240 cm aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 02 ano da data de entrega.
72	3 CX	<b>FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4 cm.</b> Filme para radiografia periapical para adulto, 3 x 4cm, compatível com processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
73	40 UND	<b>FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE</b> - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe1(ISO11140-1). Apresentações: Medidas – 19mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
74	60 FRC	<b>FLÚOR GEL</b> – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
75	10 UND	<b>FORMOCRESOL, SOLUÇÃO</b> - Formula BUCKLEY, frasco c/10 ml em solução, composição formula buckley, em frasco com 10 ml, embalado individualmente, constando externamente procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
76	50 PCT	<b>GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL EM TNT POLIPROPILENO</b> – Gorro cirúrgico descartável; em não tecido polipropileno, gramatura 50, branco, hipoalergenico, atóxico; com elástico na parte posterior; com formato anatômico; que permita ventilação adequada; embalagem com em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Contendo 10 unidades em cada pacote.
77	06 UND	<b>HEMOSTÁTICO LIQUIDO</b> – Indicações: indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restaurações, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Composição: Álcoois, cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoloina e água purificada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

78	15 UND	<b>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.</b> - Indicação capeador pulpar, material para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Propriedades: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimul o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de Hidróxido de Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
79	100 LT	<b>HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%-</b> Bactericida, desinfetante ,ação química de solvente de tecidos, antisséptico, característica físico química de baixa tensão superficial ,embalagem contendo 1000 ml. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
80	20 CX	<b>INDICADOR BIOLÓGICO</b> - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de <i>GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS</i> que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
81	1CX	<b>INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5, COM 100 UND</b> – Descrição: Indicador químico integrador Classe 5, para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, de acordo com a RDC 15; que reaja a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor); que permita a leitura imediata do resultado através da migração da tinta para a área identificada. Características: Classificação Classe 5; Composição: produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; Parâmetros: Classe 5 - 135°C por 1,5 minutos / 121°C por 21 minutos; Dimensões da tira: aproximadamente 102 x 19 mm (l x c); Apresentação: Embalagem com 100 unidades; Prazo de validade informado na embalagem do produto; Validado de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e Registrado no FDA e de acordo com AMMI ST60. Validade de 2 anos da data de entrega.
82	20 UND	<b>IODOFÓRMIO</b> - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega



83	80 KITS	<b>IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDADE:</b> Apresentação: kit contendo um frasco de pó com no mínimo 5g e um frasco de líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água, com quantidade compatível com o quantitativo de pó, com medidor pó/líquido; Características do material: o cimento de ionômero de vidro restaurador deve ser do tipo de alta viscosidade, condensável, quimicamente ativado, radiopaco, autopolimerizável, com erosão máxima: 0,17mm, máximo 5 min, conjunto completo indicado para realização do tratamento restaurador atraumático (ART); Descrição complementar: resultados comprovados pela norma iso 9917; proporção de mistura pó/líquido superior a 3,5; resistência à compressão: mínima de 200mpa; resistência flexural: mínima de 25mpa; o produto deve ser reconhecido no meio científico através de estudos publicados em jornais e revistas de circulação do meio acadêmico, nacional e internacional; As embalagens primária e secundária deverão estar em conformidade com a legislação vigente do ministério da saúde e código de defesa do consumidor. Validade mínima de 2 anos da data de validade.
84	80 KITS	<b>IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido</b> , cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão do esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Ionômero pó (10g), composto de Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de Bário, Ácido Poliacrílico. Pigmentos, composição do líquido: Ácido Tartárico e Água Destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
85	20 KITS	<b>KIT REVELADOR E FIXADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO – REVELADOR:</b> Para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. <b>FIXADOR:</b> Para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml. Ambos da mesma marca comercial. Validade mínima de ambos de 2 anos da data de entrega.
86	2 CX	<b>LÂMINA DE BISTURÍ Nº12</b> – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
87	2 CX	<b>LÂMINA DE BISTURÍ Nº15</b> – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
88	1000 PARES	<b>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5-</b> Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas, oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
89	1000 PARES	<b>LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0</b> - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.

90	3000	<b>LUA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5</b> Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.
91	100 CX	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO M-</b> Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante. Microtexturizada. Ação Antiderrapante. Totalmente isenta de pó. Hipoalergênica. Ambidestra. Embalagem: 100 Unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
92	150 CX	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP-</b> Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega
93	200 CX	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M</b> - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
94	500 CX	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P</b> - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
95	15 UND	<b>MANDRIL ODONTOLÓGICO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, PARA ENCAIXE DE DISCOS POP-ON-</b> Para polimento e acabamento de restaurações, adaptação em contra- ângulo, com haste de 15mm de comprimento; embalagem individual que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
96	20 PCT	<b>MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, Nº 1</b> – Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, nº 1, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
97	20 PCT	<b>MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, PRÉ-MOLAR</b> – Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo pré-molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.

98	20 PCT	<b>MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, MOLAR</b> – Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
99	30 UND	<b>MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm</b> - Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 nos da data de entrega.
100	30 UND	<b>MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm</b> – Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
101	10 KIT	<b>MATRIZ SECCIONAL PRE CONTORNADA</b> - Kit com 50 matrizes seccionais, pré contornadas de tamanho variado, com espessura das matrizes de 0,05mm e em aço inox. Facilidade na reconstrução do ponto de contato, obtenção de uma anatomia natural devido a convexidade das matrizes. Maior conforto para o paciente. Espessura das matrizes de 0,05mm. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
102	8 UND	<b>MEDICAÇÃO OCLUSIVA; PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE</b> - Medicação oclusiva; pasta para tratamento de alveolite composta basicamente por: Lidocaína, Eugenol, Laurilsulfato de sódio, Carbonato de cálcio, Penghawar djambi, Azeite, Água purificada e Aroma natural de hortelã; Composição do aroma natural de hortelã: mistura de óleo essencial de hortelã-verde e de óleo essencial de eucalipto; exclusivamente para uso tópico; embalada em frasco de 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 18 meses da data da entrega.
103	5 CX	<b>MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS SORTIDAS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR EM GEL</b> - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; em tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) e 6 a 12 anos (azul); caixas com moldeiras sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
104	40 UND	<b>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO</b> – Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
105	30 UND	<b>PAPACÁRIE DUO GEL</b> – Apresentação: seringa com 3 ml; Características: gel com base em papaína, azul de toluidina e cloramina; Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data validade. Validade de no mínimo 18 meses da data de entrega.

106	50 UND	<b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE AZUL E VERMELHO</b> utilizado para marcação de pontos oclusais possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais que atinja anatomicamente os pontos oclusais. Possua folhas especiais 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelha e 100 micras de espessura. Embalagem com 10 folhas -25mm x 97 mm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
107	30 RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx100m</b> - Composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxicidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
108	15 RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25cm x 100m-</b> composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
109	30 RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100m-</b> composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
110	20RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m --</b> composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.



111	50 RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m-</b> composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
112	15 UND	<b>PARAMONOCLOROFENOL</b> - material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curtiduração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
113	25 UND	<b>PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</b> - Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas + 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas + 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
114	50 UND	<b>PASTA PROFILÁTICA 90GR</b> – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado Apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
115	5 UND	<b>PEDRA DE AFIAR DE ARKANSAS, GRANULAÇÃO FINA</b> - Especificação Técnica: Pedra de Afiar Instrumental Odontológico; de Arkansas; granulação fina; tamanho: 10 x 2,5 x 6 cm; Tipo: Pedra natural, em tonalidades que variam de cor branca a cinza, sedo suaves para afiação dos instrumentais com desgaste mínimo da ponta. Embalada Individualmente; Constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
116	20 CX	<b>PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO</b> - Indicado para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
117	30 CX	<b>PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR</b> - Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

118	6 UND	<b>PORTA AMALGAMA ADULTO DE PLÁSTICO ATÓXICO</b> - Porta amalgama; adulto; corpo contendo inscrição de marca; confeccionado em plástico/similar atóxico; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
119	5 KITS	<b>POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO ADULTO</b> - Kit com 4 peças sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior, um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garante a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis, utilizados para dentes anteriores e posteriores, esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.
120	30 UND	<b>POTE DAPPEN, PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL</b> - Pote Dappen; plástico; composto a base de nylon; com boa resistência; esterilizável em autoclave a 137°C; possuindo duas cavidades para as manipulações; Medindo: altura 3 cm, concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml, concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; possuindo 12 dimensões; embalagem Individual.
121	20 UND	<b>POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO COLORIDO, AUTOCLAVÁVEL</b> - Pote Dappen; de vidro temperado colorido, autoclavável; espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarba, com 2 concavidades e capacidade de 5ml e 2ml; para manipulação de materiais odontológicos; embalagem individual.
122	30 UND	<b>PRENDEDOR DE GUARDANAPO DE METAL JACARÉ</b> - Prendedor de guardanapo; de metal, passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
123	10 UND	<b>RESINA COMPOSTA COR A1 - Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro-híbrida, seringa com 4 g; cor A1; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
124	30 UND	<b>RESINA COMPOSTA COR A2 Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A2; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
125	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA COR A3 Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A3; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho

			médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
126	15 UND		<b>RESINA COMPOSTA A 3,5 Z 100 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO</b> – Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A3,5; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
127	15 UND		<b>RESINA COMPOSTA A2 Z250 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; cor A2; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
128	15 UND		<b>RESINA COMPOSTA A3 Z250 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; cor A3; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
129	06 UND		<b>RESINA COMPOSTA COR OA2</b> - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação : seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
130	06 UND		<b>RESINA COMPOSTA COR OA3</b> - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação: seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

131	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A2</b> - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g na cor A2. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
132	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A3</b> - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g na cor A3. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
133	5 UND	<b>RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW OPACA</b> - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: seringas com 2,4g na cor OPACA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
134	6 KITS	<b>RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO TIPO II, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL- KIT PÓ 38g E LÍQUIDO 15ml</b> – Cimento de óxido de zinco uso odontológico; tipo II reforçado para restaurações temporárias de longa duração; apresentação kit pó e líquido; pó cor marfim em frasco com aproximadamente 38g; composto basicamente de óxido de zinco metacrilato de metila; líquido em frasco com aproximadamente 15ml; composto basicamente por eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%; embalado individualmente kit pó, líquido, conta gotas + colher dosadora; constando externamente marca comercial e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
135	500 UND	<b>ROLETE DE ALGODÃO</b> –com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
136	300 RL	<b>ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO</b> -com fibra 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos; embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
137	100 PCT	<b>SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, POLIETILENO, PROTEÇÃO DE CANETA, 4,5x23CM, PAC. 100 und.</b> - Saco plástico descartável; de polietileno; para proteção de caneta (tipo Geladinho); medindo aproximadamente 4,5 x 23 cm; pacote c/ 100 unidades.
138	100 PCT	<b>SACO PLÁSTICO LEITOSO 17x17cm, TIPO PARA LANCHE</b> - Saco plástico leitoso, tipo para lanche; medindo aproximadamente 17x17 cm; embalagem com 100 unidades.



139	5 KITS	<b>SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS</b> – Apresentação Kit contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação; fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
140	20 UND	<b>SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO FINA REPOSIÇÃO</b> – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
141	20 UND	<b>SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO MÉDIA REPOSIÇÃO</b> – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
142	20 UND	<b>SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO GROSSA REPOSIÇÃO</b> – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
143	200 UND	<b>SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDRIGÊNIO 3% - AGUA OXIGENADA 10 vol FRASCO COM 100 ml</b> - Água oxigenada 10 volumes; princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%; sem conservantes; medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos; apresentação: em frasco plástico opaco, tipo almotolia, contendo 100 ml; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade, fórmula e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
144	5 UND	<b>SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA</b> – Especificação técnica: Acondicionada em frasco com 10 ml; hemostático local uso odontológico; em solução sem epinefrina atóxica; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; Registro Conforme Legislação Vigente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
145	200 PCT	<b>SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM 40 UND</b> - Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti-frutti colorido, rosa, verde, transparente e azul; cada pacote contendo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

146	50 UND	<b>TIRA DE LIXA DE AÇO</b> – Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 6 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 6 mm x 150mm. Embalagem individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
147	50 UND	<b>TIRA DE LIXA DE AÇO</b> – Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 4 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 4 mm x 150mm. Embalagem individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
148	15 CX	<b>TIRA DE LIXA DE POLIESTER SOF-LEX REPOSIÇÃO</b> - indicada para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Características : tamanho das tiras 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Tira possuindo um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies Inter proximais dos dentes. apresentação: caixa com 50 tiras .com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
149	100 PCT	<b>TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO</b> – Atóxico 100% polipropileno, gramatura 20 colorido não estéril, diâmetro: 50 x 50 não inflamável, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 3 anos da data de entrega
150	6 UND	<b>TRICRESOL</b> - Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96° e água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução. Embalagem com 50 tiras. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
151	10 UND	<b>VASELINA SÓLIDA</b> - Indicada como emoliente; mistura de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos; auxilia no tratamento de rachaduras de pele, como umectante; tem efeito emoliente e melhora a elasticidade; embalagem com 1 pote de 90g. Validade de no mínimo 2 anos da data de entrega.
152	15 BISN	<b>VERNIZ COM FLÚOR</b> - Verniz de flúor para uso profissional; apresentação em bisnaga com 10 ml; com alta concentração de flúor - 22.600ppm (NaF 5%); sem a necessidade da adição de solventes; deve ser: altamente tolerante a água e com cobertura mesmo em superfícies úmidas, com filme verniz de boa aderência e endurecendo com a saliva; Composição: Aqua, Calcium Carbonate, Sorbitol, Arginine Bicarbonate, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Tetrasodium Pyrophosphate, Tricalcium Phosphate, Sodium Saccharin, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, CI 77891, Limonene. Contém Monofluorofosfato de Sódio (1450ppm de Flúor). Validade de no mínimo 2 anos da data de fabricação.

**IV – VALOR ESTIMADO ANUAL DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa do valor é de **R\$ 136.975,26** (cento e trinta e seis mil novecentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Obs.: A estimativa de valor foi baseada no valor da ATA 55/2023 do PREGÃO 64/2023, somado ao valor dos

itens acrescentados ao TR do PREGÃO 64/2023, obtidos em pesquisa de preço em Empresas Dentais.	
<b>V – INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO</b>	
01 de AGOSTO de 2024.	
<b>VI – GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO OU PRORROGAÇÃO CONTRATUAL</b>	
Alta prioridade, dada a necessidade do objeto.	
<b>VII – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO RESPONSÁVEL</b>	
<b>Unidade requisitante/demandante:</b> Divisão de Assistência em Saúde / Seção de Saúde Bucal	
<b>Responsável pela demanda:</b> Isaura da Conceição Oliveira de Freitas	
<b>Secretaria demandante:</b> Secretária Municipal de Saúde	
<b>Email:</b> <a href="mailto:saude@cajati.sp.gov.br">saude@cajati.sp.gov.br</a>	<b>Telefone:</b> (13) 3854-8500



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EC8-04AA-E852-BE3A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ISAURA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE FREITAS (CPF 103.XXX.XXX-05) em 25/06/2024 16:24:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 26/06/2024 11:14:00 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6EC8-04AA-E852-BE3A>



**Memorando 1- 11.395/2024**

**De:** Gabriel F. - SEADM

**Para:** SMS-DGS-AQUI - Aquisições da Secretaria de Saúde

**Data:** 27/06/2024 às 11:07:12

Prezada,

Após análise do DFD em anexo, não identificamos irregularidades, dado que essa demanda não afeta diretamente outras unidades, não é necessário formar uma equipe específica para a elaboração do ETP, portanto devolvo para elaboração do referido estudo.

Atenciosamente,

—

**Gabriel Orbeli França**

**Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**

**Memorando 2- 11.395/2024**

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

**Para:** SMS - Secretaria Municipal de Saúde - A/C Maria B.

**Data:** 27/06/2024 às 14:06:26

Prezada,

Considerando que se tratam de materiais de consumo comuns, me coloco à disposição para a elaboração do ETP.

Sem mais.

—  
**Bruna Morelli R. Pereira**  
Secretaria Municipal de Saúde  
*DIVISÃO DE SUPRIMENTOS*

**Memorando 3- 11.395/2024**

**De:** Gabriel F. - SEADM

**Para:** SEADM-DAGEP - Departamento de Administração e Gestão de Pessoas - A/C Gustavo C.

**Data:** 01/07/2024 às 15:07:19

Prezado,

Segue para acompanhamento.

Atenciosamente.

—

**Gabriel Orbeli França**

**Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**

**Memorando 4- 11.395/2024**

**De:** Isaura F. - SMS-DAS-DAS-CEODON

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Rosemeire S.

**Data:** 09/08/2024 às 12:43:53

Prezada Rosemeire

Segue para ciência, conforme questionamento no memorando 12.776/2024. Encaminhei o DFD e o TR, dos insumos anual, à gestão da SMS em maio de 2024.

Att,

—

**Isaura da Conceicao Oliveira de Freitas**

*Cirurgiã Dentista - RT*

**Memorando 5- 11.395/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 09/08/2024 às 12:58:18

Boa tarde!

Prezados,

Aguardo o envio do ETP e TR para que possamos deflagrar o novo procedimento licitatório com a urgência que o caso requer, haja vista que a ata vigente encerrar-se-á no dia 14/08/2024.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*



## Memorando 6- 11.395/2024

**De:** Isaura F. - SMS-DAS-DAS-CEODON

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 09/08/2024 às 17:04:17

**Setores envolvidos:**

SEADM, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SMS-DAS-DAS-CEODON, SMS-DGS-AQUI

### Envio de DFD | Insumos Odontológicos

Prezada [Rosemeire Vieira Dos Santos - SEADM-DESUP](#)

Segue anexo o TR referente a aquisição anual de insumos para a Seção de Saúde Bucal de Cajati.

Att,

—

**Isaura da Conceicao Oliveira de Freitas**

*Cirurgiã Dentista - RT*

**Anexos:**

6\_de\_2024\_TR\_\_MATERIAL\_ODONTOLOGICO\_ANUAL\_10\_05\_2024.pdf

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **1. OBJETO**

Aquisição de material de consumo odontológico em geral para uso no Centro Odontológico do Município de Cajati – SP, com as características descritas neste anexo.

### **2. DO FORNECIMENTO**

As quantidades abaixo se referem à previsão estimada anual de fornecimento, sendo:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	100 PCT	<b>ABAIXADOR DE LÍNGUA COM SABOR, PONTA ANIMAIS, PCT COM 40 UND</b> – Especificação técnica: Abaixador de Língua com aroma, sabor de Tutti-Frutti, ponta animais; pacote com 40 unidades cada, embalados individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto; cada abaixador deve ser decorado com figuras de animais em cores sortidas; produzido em plástico atóxico, livre de toxicidade, que não irrita, sem açúcar, sem látex e sem medicamentos; não esterilizável; descartável/uso único; higienizado; colorido com dióxido de titânio rutilo e pigmentos orgânicos; com aroma artificial de Tutti-Frutti; dimensões (unidade): 124 mm x 16 mm x 3 mm. Certificações: Aprovação pelo FDA, possuir testagens de biocompatibilidade feitas periodicamente no Brasil e nos Estados Unidos desde 1999 a cada dois anos e produzido de acordo com as normas ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e RDC 59/ BPF e Registro ANVISA: 10438720003.
2	10 KITS	<b>ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO EM KIT (1 ADULTO e 1 CRIANÇA), EM SILICONE ATÓXICO</b> – Especificação técnica: Abridor de boca anatômico; em Kit (1 unidade tamanho adulto e 1 unidade tamanho infantil); formato trapezoidal com ranhuras laterais; em silicone atóxico; esterilização em meios físico-químicos; garantia mínima de 01 ano a partir da entrega; Kit embalado individualmente, em material apropriado que garanta integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
3	10 UND	<b>ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM 4 MEDIDAS</b> – Especificação técnica: Abridor de boca anatômico; para Pessoas com Deficiência, reposição compatível com Abrace PCD/Indusbello; com 4 medidas diferentes em um único produto (14mm, 20mm, 26mm e 32mm); em silicone atóxico; esterilização em meios físico-químicos; garantia mínima de 1 ano; embalagem individual, em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

4	15 PTS	<b>ABRASIVO EM PÓ, PEDRA POMES, PARA PROFILAXIA DENTAL, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, POTE C/100 GRAMAS</b> - Abrasivo, em pó, pedra pomes, para polimento e profilaxia dental, granulação extrafina, embalado em pote com 100 gramas, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
5	30 KITS	<b>ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA</b> - em pontas de silicone flexíveis ;impregnadas com óxido de alumínio, não produzindo calor excessivo; caixa com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2 discos). Composição de tri polímero (estireno Butadieno-Metacrilato de Metila) Sílica Pirofítica Silanizada, Uretano Dimetanolamina e óxido de alumínio .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
6	60 UND	<b>ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL</b> - Sistema de adesivo de frasco único (prime e adesivo), com tampa flip top e bico dosador, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, sistema adesivo com nanotecnologia, contendo cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Utilizado nas técnicas de condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), auto condicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte, indicado para restaurações diretas e indiretas, sem a necessidade de aplicação de um primer metálico e silano.Composição: Metacrilato de 2- hidroxietila (15 a 25% em peso), Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA) (15 a 25% em peso), Decametileno dimetacrilato (5 a 15% em peso), Etanol (10 a 15% em peso), Sílica tratada de silano (5 a 15% em peso), Água (10 a 15% em peso), 1,10-Decanodiol fosfato metacrilato (1 a 10% em peso), Copolímero de acrílico e ácido itacônico (1 a 5% em peso), Caforoquinona (menor que 2% em peso), N-Dimetilbenzocaína (menor que 2% em peso). Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
7	200 GALÕES	<b>ÁGUA DEIONIZADA</b> – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega.
8	10 CX	<b>AGULHA GENGIVAL 27G LONGA</b> - Agulha gengival longa em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.

9	60 CX	<b>AGULHA GENGIVAL 30G CURTA</b> - Agulha gengival curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
10	25 CX	<b>AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA</b> - Agulha Gengival 30G extra curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médico, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
11	20 LT	<b>ALCOOL ETILÍCO 92,8 IGPM (CATEGORIA COMERCIAL) - FRASCO COM 1 LITRO</b> - Líquido; com teor de no mínimo 92,8 IGPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rotulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Com registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
12	800 LT	<b>ALCOOL ETILÍCO A 70 % PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES – FRASCO COM 1 LITRO</b> – Indicado para desinfecção de superfícies e artigos semi e não críticos; frasco de 1 litro, contendo dados de identificação, nº de lote, validade e responsável técnico; em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devesse atender a legislação atual vigente. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
13	120 CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000</b> - Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) +Epinefrina 10 µg /mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, cada embalagem contém 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
14	15 CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML</b> - Anestésico local injetável, a base de lidocaína a 3% e norepinefrina, tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as normas de procedimentos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
15	5 CX	<b>ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2 % SEM VASOCONSTRITOR</b> - Tubetes com 1.8 ml, embalados em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
16	60 UND	<b>ANESTÉSICO TÓPICO GEL</b> - Frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel, benzocaina a 20%, hidrossolúvel, em pote, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

17	150 UND	<b>BABADOR DESCARTÁVEL</b> – Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável; folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico; maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades.
18	10 UND	<b>BICARBONATO DE SÓDIO</b> - Bicarbonato de sódio odontológico; pó extrafino para polimento e profilaxia dental, pureza (99,6%), sem aroma, sem corantes; em frasco plástico; acondicionados em pote de 250g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, o produto deverá obedecer a legislação vigente; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
19	100 UND	<b>BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 COM CABO E LÂMINA</b> - Composto por um cabo plástico resistente, com lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
20	100	<b>BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 COM CABO E LÂMINA</b> - Composto por um cabo plástico resistente, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
21	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
22	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
23	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.



24	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
25	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
26	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
27	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
28	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
29	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

30	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
31	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
32	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
33	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
34	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
35	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

36	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
37	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
38	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
39	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
40	30 UND	<b>BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF</b> – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
41	30 UND	<b>BROCAS ZÉCRYA HL</b> - Broca do tipo Zécrya número 151, formato tronco-cônico, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Utilizada para odontosecção e corte/desgaste de osso. Ideal para cirurgia de ciso incluso. Tamanho: 28 mm de comprimento total. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

42	15 UND	<b>BLOCO PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO</b> – Bloco para espátula; de papel plastificado; tamanho de 15cm x 8cm aproximadamente; com 50 Folhas; embalagem que garanta a integridade do produto.
43	30 PCT	<b>CANUDO DESCARTAVEL EM PP, DIAM. 5,5 mm, LISO</b> - Canudo descartável; de polipropileno; com diâmetro de 5,5mm; medindo 210mm; branco, liso e acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto. Embalagem com 100 unidades.
44	30 UND	<b>CARIOSTÁTICO 30 %</b> – Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos proteicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
45	5 UND	<b>CIMENTO CIRÚRGICO</b> – sem eugenol produzido através da mistura de seus componentes, ótima textura e plasticidade após a presa. Produto de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol e cera natural. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido de zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol e BHT. Validade mínima: 2 anos da data de entrega.
46	15 UND	<b>CIMENTO PROVISÓRIO ENDODÔNTICO COM IODOFORMIO</b> – Material temporário para obturação de canal radicular; com Iodofórmio que confere a pasta propriedade anti-infecciosa e intensa radiopacidade; pasta de Hidróxido de Cálcio pronta para o uso; de fácil aplicação; ação anti- bacteriana; que induz a formação de dentina reparadora; com consistência ideal para escoamento no canal radicular; apresentação: 1 seringa de 2,5g e 3 bicos aplicadores. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.
47	6 UND	<b>CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ. (10ml)</b> - Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de oxido de zinco com até 10% de oxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por ácido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.
48	6 UND	<b>CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO</b> – Benefícios: massa de fácil manipulação; endurecimento rápido; menor microinfiltração marginal. Características: obturador provisório normal. Aplicação: indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos. Apresentação: Embalagem c/25g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.



49	150 LT	<b>CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO, EMBALAGEM DE 1 LITRO</b> – Solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de clorexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo espectro pronto para o uso. Embalagem contendo 1 litro. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
50	20 UND	<b>CLOREXIDINA 2%</b> - Antisséptico com atividade antibacteriana, com eficácias para gram-negativas, fungos leveduras e alguns dermatófilos. Composição- digluconato de clorexidina 2%, metilparabeno, água deionizada. (livre de álcool etílico) Frascos com 100ml. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.
51	20 UND	<b>COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE</b> – Capacidade para 05 litros, para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc. Alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853.
52	6.000 UND	<b>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL</b> - Com 13 fios, 7,5x7,5 cm; em 100% de viscose branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras; medindo 7,5cm x 7,5 cm; com formato quadrado; estéril; embalado com 10 unidades cada, embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico e laudo analítico laboratorial, de cumprimento da NBR 13843. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
53	200 PCT	<b>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5x7,5 cm, NÃO ESTÉRIL, PACOTE C/500 UND</b> – Compressa de gaze hidrófila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 5 dobras, 8 camadas, sem filamento radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 cm; com formato quadrado; não estéril; embalado em pacote com 500 unidades que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 anos da data de entrega.
54	60 UND	<b>CONDICIONADOR DENTAL GEL</b> - Gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, espessado com Sílica Coloidal. Composição: Ácido Fosfórico, Sílica Coloidal, Surfactante e Corante. Embalagem com 3 seringas de 3 ml e 3 ponteiros p/ aplicação. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
55	10 KITS	<b>CUNHA INTERDENTAL ANATÔMOCA DE MADEIRA, 5 TAMANHOS, CODIF. POR CORES</b> - Embalagem com 100 unidades; Especificação Técnica: Cunha interdental; confeccionada em madeira; formato anatômico da ameia, em 5 tamanhos diferentes codificados por cores; constando externamente quantidade, marca comercial, procedência de fabricação.
56	15 UND	<b>DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM FLUORETO DE SÓDIO 2% E NITRATO DE POTÁSSIO, SER. 2,5g</b> – Gel de baixa viscosidade dessensibilizante oclusivo à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2% que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.



57	100 UND	<b>DETERGENTE ENZIMÁTICO</b> - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carboxilase); sendo as principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; específico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
58	30 UND	<b>ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, (tipo de unha)</b> – Para uso na limpeza de artigos de pequeno e médio porte. Descrição: Escova plástica para limpeza delicada, cor sortida. Dimensões: 9.5 x 2.5 cm.
59	200 UND	<b>ESCOVA ROBSON, PEQUENA, CERDA PLANA, NA COR BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO</b> - Escova de Robson; pequena; para profilaxia; com cerda plana; haste metálica, e cerdas em nylon na cor branca; para contra angulo; embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial, numero de lote, data de fabricação e procedência.
60	20 UND	<b>ESPATULA PARA ODONTO PLÁSTICA, FLEXIVEL, PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO</b> - Especificação Técnica: Espátula para odontologia; de plástico, flexível; para manipulação de Ionometro de Vidro. Medidas aprox. 21,50x3,20x0,50cm (c x l x a); embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
61	100 UND	<b>ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX</b> - Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos, passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto, embalado individualmente, marca comercial, procedência de fabricação.
62	10 UND	<b>ESPELHO TOUCADOR COM CABO, FORMATO DENTE</b> – Espelho de mão para procedimentos clínicos; toucador com cabo; formato dente; disponível em diversas cores; tamanho aproximado de 19,5cm de comprimento. Embalagem com 1 unidade.
63	20 CX	<b>ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UND</b> - Esponja Hemostática produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado; com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; que seja completamente reabsorvida pelo organismo em 15 dias; material atóxico e não pirogênico; esterilizada por raios gama; com material leve com peso aproximado de 10 mg; dimensões: 1x1x1 cm e com Registro ANVISA. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.
64	40 UND	<b>EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA SOLUÇÃO</b> , frasco C/10 ml. Evidenciador de placa bacteriana em solução, em frasco c/10 ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.

65	50 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0</b> Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 20 mm- fio agulha de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 2,0 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
66	20 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0</b> - Monofilamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 15 mm- fio agulha de sutura nylon monofilamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
67	30 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 4-0</b> - Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ. – CT 15 mm - Fio agulhado de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 4-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
68	10 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA SEDA, NÚMERO 4-0</b> - Fio de Sutura de Seda Preta. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm.Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.* Esterilizado em Raio Gama.As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Uso exclusivo em Odontologia.Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
69	20 CX	<b>FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 5-0, AGULHA 3/8 Cir.</b> - Fio de sutura de nylon obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.5-0, preto trançado, agulhado -3/8 circ. triangular, CT 1,5cm, fio medindo 45 cm, uso odontológico, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ter comprovação de sua esterilidade, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
70	40 UND	<b>FIO DENTAL</b> - Embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
71	5 UND	<b>FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, Nº. 00, CORDÃO TRANÇADO MALEÁVEL, NÃO IMPREGNADO</b> - Fio para retração gengival; composto por cordão trançado e maleável 100% algodão, não impregnado por substância química, n. 00; embalado em frasco com 240 cm aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 02 ano da data de entrega.

72	3 CX	<b>FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4 cm.</b> Filme para radiografia periapical para adulto, 3 x 4cm, compatível com processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
73	40 UND	<b>FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE</b> - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe I (ISO 11140-1). Apresentações: Medidas – 19mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
74	60 FRC	<b>FLÚOR GEL</b> – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
75	10 UND	<b>FORMOCRESOL, SOLUÇÃO</b> - Formula BUCKLEY, frasco c/10 ml em solução, composição formula buckley, em frasco com 10 ml, embalado individualmente, constando externamente procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
76	50 PCT	<b>GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL EM TNT POLIPROPILENO</b> – Gorro cirúrgico descartável; em não tecido polipropileno, gramatura 50, branco, hipoalergenico, atóxico; com elástico na parte posterior; com formato anatômico; que permita ventilação adequada; embalagem com em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Contendo 10 unidades em cada pacote.
77	06 UND	<b>HEMOSTÁTICO LIQUIDO</b> – Indicações: indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restaurações, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Composição: Álcoois, cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoloina e água purificada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
78	15 UND	<b>HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.</b> - Indicação capeador pulpar, material para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Propriedades: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimul o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de Hidróxido de Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

79	100 LT	<b>HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%-</b> Bactericida, desinfetante, ação química de solvente de tecidos, antisséptico, característica físico química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000 ml. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
80	20 CX	<b>INDICADOR BIOLÓGICO</b> - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de <i>GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS</i> que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
81	1CX	<b>INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5, COM 100 UND</b> – Descrição: Indicador químico integrador Classe 5, para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, de acordo com a RDC 15; que reaja a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor); que permita a leitura imediata do resultado através da migração da tinta para a área identificada. Características: Classificação Classe 5; Composição: produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; Parâmetros: Classe 5 - 135°C por 1,5 minutos / 121°C por 21 minutos; Dimensões da tira: aproximadamente 102 x 19 mm (l x c); Apresentação: Embalagem com 100 unidades; Prazo de validade informado na embalagem do produto; Validado de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e Registrado no FDA e de acordo com AMMI ST60. Validade de 2 anos da data de entrega.
82	20 UND	<b>IODOFÓRMIO</b> - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
83	80 KITS	<b>IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDADE:</b> Apresentação: kit contendo um frasco de pó com no mínimo 5g e um frasco de líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água, com quantidade compatível com o quantitativo de pó, com medidor pó/líquido; Características do material: o cimento de ionômero de vidro restaurador deve ser do tipo de alta viscosidade, condensável, quimicamente ativado, radiopaco, autopolimerizável, com erosão máxima: 0,17mm, máximo 5 min, conjunto completo indicado para realização do tratamento restaurador atraumático (ART); Descrição complementar: resultados comprovados pela norma iso 9917; proporção de mistura pó/líquido superior a 3,5; resistência à compressão: mínima de 200mpa; resistência flexural: mínima de 25mpa; o produto deve ser reconhecido no meio científico através de estudos publicados em jornais e revistas de circulação do meio acadêmico, nacional e internacional; As embalagens primária e secundária deverão estar em conformidade com a legislação vigente do ministério da saúde e código de defesa do consumidor. Validade mínima de 2 anos da data de validade.



84	80 KITS	<b>IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido</b> , cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão do esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Ionômero pó (10g), composto de Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de Bário, Ácido Poliacrílico. Pigmentos, composição do líquido: Ácido Tartárico e Água Destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
85	20 KITS	<b>KIT REVELADOR E FIXADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO – REVELADOR:</b> Para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. <b>FIXADOR:</b> Para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiossulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml . Ambos da mesma marca comercial. Validade mínima de ambos de 2 anos da data de entrega.
86	2 CX	<b>LÂMINA DE BISTURÍ Nº12</b> – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
87	2 CX	<b>LÂMINA DE BISTURÍ Nº15</b> – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
88	1000 PARES	<b>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5-</b> Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas , oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
89	1000 PARES	<b>LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0</b> - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.
90	3000	<b>LUVA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5</b> Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.
91	100 CX	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO M-</b> Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante. Microtexturizada. Ação Antiderrapante. Totalmente isenta de pó. Hipoalergênica. Ambidestra. Embalagem: 100 Unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.



92	150 CX	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP-</b> Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega
93	200 CX	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M</b> - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
94	500 CX	<b>LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P</b> - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
95	15 UND	<b>MANDRIL ODONTOLÓGICO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, PARA ENCAIXE DE DISCOS POP-ON-</b> Para polimento e acabamento de restaurações, adaptação em contra- ângulo, com haste de 15mm de comprimento; embalagem individual que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
96	20 PCT	<b>MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, Nº 1</b> – Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, nº 1, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
97	20 PCT	<b>MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, PRÉ-MOLAR</b> – Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo pré-molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
98	20 PCT	<b>MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, MOLAR</b> – Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
99	30 UND	<b>MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm</b> - Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
100	30 UND	<b>MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm</b> – Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

101	10 KIT	<b>MATRIZ SECCIONAL PRE CONTORNADA</b> - Kit com 50 matrizes seccionais, pré contornadas de tamanho variado, com espessura das matrizes de 0,05mm e em aço inox. Facilidade na reconstrução do ponto de contato, obtenção de uma anatomia natural devido a convexidade das matrizes. Maior conforto para o paciente. Espessura das matrizes de 0,05mm. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
102	8 UND	<b>MEDICAÇÃO OCLUSIVA; PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE</b> - Medicação oclusiva; pasta para tratamento de alveolite composta basicamente por: Lidocaína, Eugenol, Laurilsulfato de sódio, Carbonato de cálcio, Penghawar djambi, Azeite, Água purificada e Aroma natural de hortelã; Composição do aroma natural de hortelã: mistura de óleo essencial de hortelã-verde e de óleo essencial de eucalipto; exclusivamente para uso tópico; embalada em frasco de 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 18 meses da data da entrega.
103	5 CX	<b>MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS SORTIDAS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR EM GEL</b> - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; em tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) e 6 a 12 anos (azul); caixas com moldeiras sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
104	40 UND	<b>ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO</b> - Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
105	30 UND	<b>PAPACÁRIE DUO GEL</b> - Apresentação: seringa com 3 ml; Características: gel com base em papaína, azul de toluidina e cloramina; Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data validade. Validade de no mínimo 18 meses da data de entrega.
106	50 UND	<b>PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE AZUL E VERMELHO</b> utilizado para marcação de pontos oclusais possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais que atinja anatomicamente os pontos oclusais. Possua folhas especiais 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelha e 100 micras de espessura. Embalagem com 10 folhas -25mm x 97 mm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

107	30 RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx100m</b> - Composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxicidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
108	15 RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25cm x 100m-</b> composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
109	30 RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100m-</b> composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
110	20RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m --</b> composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
111	50 RL	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m-</b> composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.

112	15 UND	<b>PARAMONOCLOROFENOL</b> - material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curtiduração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
113	25 UND	<b>PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO</b> - Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas + 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas + 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
114	50 UND	<b>PASTA PROFILÁTICA 90GR</b> – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado. Apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
115	5 UND	<b>PEDRA DE AFIAR DE ARKANSAS, GRANULAÇÃO FINA</b> - Especificação Técnica: Pedra de Afiar Instrumental Odontológico; de Arkansas; granulação fina; tamanho: 10 x 2,5 x 6 cm; Tipo: Pedra natural, em tonalidades que variam de cor branca a cinza, sedo suaves para afiação dos instrumentais com desgaste mínimo da ponta. Embalada Individualmente; Constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
116	20 CX	<b>PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO</b> - Indicado para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
117	30 CX	<b>PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR</b> - Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
118	6 UND	<b>PORTA AMALGAMA ADULTO DE PLÁSTICO ATÓXICO</b> - Porta amalgama; adulto; corpo contendo inscrição de marca; confeccionado em plástico/similar atóxico; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.



119	5 KITS	<b>POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO ADULTO</b> - Kit com 4 peças sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis, utilizados para dentes anteriores e posteriores, esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.
120	30 UND	<b>POTE DAPPEN, PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL</b> – Pote Dappen; plástico; composto a base de nylon; com boa resistência; esterilizável em autoclave a 137°C; possuindo duas cavidades para as manipulações; Medindo: altura 3 cm, concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml, concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; possuindo 12 dimensões; embalagem Individual.
121	20 UND	<b>POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO COLORIDO, AUTOCLAVÁVEL</b> - Pote Dappen; de vidro temperado colorido, autoclavável; espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarba, com 2 concavidades e capacidade de 5ml e 2ml; para manipulação de materiais odontológicos; embalagem individual.
122	30 UND	<b>PRENDEDOR DE GUARDANAPO DE METAL JACARÉ</b> - Prendedor de guardanapo; de metal, passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
123	10 UND	<b>RESINA COMPOSTA COR A1 - Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro-híbrida, seringa com 4 g; cor A1; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
124	30 UND	<b>RESINA COMPOSTA COR A2 Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A2; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
125	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA COR A3 Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A3; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.



126	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA A 3,5 Z 100 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO</b> – Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A3,5; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
127	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA A2 Z250 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; cor A2; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
128	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA A3 Z250 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO</b> - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; cor A3; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
129	06 UND	<b>RESINA COMPOSTA COR OA2</b> - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação : seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
130	06 UND	<b>RESINA COMPOSTA COR OA3</b> - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação: seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

131	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A2</b> - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g na cor A2. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
132	15 UND	<b>RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A3</b> - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g na cor A3. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
133	5 UND	<b>RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW OPACA</b> - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: seringa com 2,4g na cor OPACA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
134	6 KITS	<b>RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO TIPO II, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL- KIT PÓ 38g E LÍQUIDO 15ml</b> – Cimento de óxido de zinco uso odontológico; tipo II reforçado para restaurações temporárias de longa spera; apresentação kit pó e líquido; pó cor marfim em frasco com aproximadamente 38g; composto basicamente de óxido de zinco metacrilato de metila; líquido em frasco com aproximadamente 15ml; composto basicamente por eugenol 99,5%e ácido acético 0,5%; embalado individualmente kit pó, líquido, conta gotas + colher dosadora; constando externamente marca comercial e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
135	500 UND	<b>ROLETE DE ALGODÃO</b> –com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
136	300 RL	<b>ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO</b> -com fibra 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos; embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
137	100 PCT	<b>SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, POLIETILENO, PROTEÇÃO DE CANETA, 4,5x23CM, PAC. 100 und.</b> - Saco plástico descartável; de polietileno; para proteção de caneta (tipo Geladinho); medindo aproximadamente 4,5 x 23 cm; pacote c/ 100 unidades.
138	100 PCT	<b>SACO PLASTICO LEITOSO 17x17cm, TIPO PARA LANCHE</b> - Saco plástico leitoso, tipo para lanche; medindo aproximadamente 17x17 cm; embalagem com 100 unidades.

139	5 KITS	<b>SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS</b> – Apresentação Kit contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação; fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
140	20 UND	<b>SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO FINA REPOSIÇÃO</b> – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
141	20 UND	<b>SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO MÉDIA REPOSIÇÃO</b> – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
142	20 UND	<b>SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO GROSSA REPOSIÇÃO</b> – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
143	200 UND	<b>SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDRIGÊNIO 3% - AGUA OXIGENADA 10 vol FRASCO COM 100 ml</b> - Água oxigenada 10 volumes; princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%; sem conservantes; medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos; apresentação: em frasco plástico opaco, tipo almotolia, contendo 100 ml; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade, fórmula e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
144	5 UND	<b>SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA</b> – Especificação técnica: Acondicionada em frasco com 10 ml; hemostático local uso odontológico; em solução sem epinefrina atóxica; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; Registro Conforme Legislação Vigente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
145	200 PCT	<b>SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM 40 UND</b> - Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti-frutti colorido, rosa, verde, transparente e azul; cada pacote contendo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

146	50 UND	<b>TIRA DE LIXA DE AÇO</b> – Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 6 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 6 mm x 150mm. Embalagem individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
147	50 UND	<b>TIRA DE LIXA DE AÇO</b> – Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 4 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 4 mm x 150mm. Embalagem individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
148	15 CX	<b>TIRA DE LIXA DE POLIESTER SOF-LEX REPOSIÇÃO</b> - indicada para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Características : tamanho das tiras 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Tira possuindo um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies Inter proximais dos dentes. apresentação: caixa com 50 tiras .com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
149	100 PCT	<b>TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO</b> – Atóxico 100% polipropileno, gramatura 20 colorido não estéril, diâmetro: 50 x 50 não inflamável, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 3 anos da data de entrega
150	6 UND	<b>TRICRESOL</b> - Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96° e água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução. Embalagem com 50 tiras. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
151	10 UND	<b>VASELINA SÓLIDA</b> - Indicada como emoliente; mistura de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos; auxilia no tratamento de rachaduras de pele, como umectante; tem efeito emoliente e melhora a elasticidade; embalagem com 1 pote de 90g. Validade de no mínimo 2 anos da data de entrega.
152	15 BISN	<b>VERNIZ COM FLÚOR</b> - Verniz de flúor para uso profissional; apresentação em bisnaga com 10 ml; com alta concentração de flúor - 22.600ppm (NaF 5%); sem a necessidade da adição de solventes; deve ser: altamente tolerante a água e com cobertura mesmo em superfícies úmidas, com filme verniz de boa aderência e endurecendo com a saliva; Composição: Aqua, Calcium Carbonate, Sorbitol, Arginine Bicarbonate, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Tetrasodium Pyrophosphate, Tricalcium Phosphate, Sodium Saccharin, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, CI 77891, Limonene. Contém Monofluorofosfato de Sódio (1450ppm de Flúor). Validade de no mínimo 2 anos da data de fabricação.

### 3. DA DISTRIBUIÇÃO

Em cada fornecimento, o prazo de entrega será o solicitado pela unidade



requisitante, não podendo, todavia, ultrapassar 15 (quinze) dias contados da data do recebimento da nota de empenho pelo fornecedor. Os materiais não deverão ser entregues parcialmente.

**4. PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias corridos.

**5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** 15 dias para pagamento.

**6. LOCAL DE ENTREGA**

**6.1** O local de entrega dos materiais deverá ser entregue no Almoxarifado Municipal, na Rua Darci Bueno da Cruz, nº 200 (ao lado da Garagem Municipal), de **segunda-feira a sexta-feira das 13:30 às 17:00 horas**. Cidade: Cajati – SP – Telefone: (13) 3854-2079 – email: [almoxarifado@cajati.sp.gov.br](mailto:almoxarifado@cajati.sp.gov.br) .

**7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

As empresas participantes deverão apresentar os seguintes documentos:

Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis Complementares.

Cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do Licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via Internet.

Declaração de que a(s) empresa(s) fabricante(s) dos materiais de enfermagem ofertados por sua empresa, possui(em) Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

Comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde, para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

- a) Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência.
- b) Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao do vencimento.
- c) Para os materiais odontológicos em que não seja necessário Registro a empresa deverá apresentar documento que comprove a dispensa do registro na ANVISA.

## **8 – DAS PENALIDADES:**

O descumprimento dos prazos ou de qualquer uma das condições especificadas, inerentes à correta execução do objeto, bem como de qualquer cláusula contratual, implicarão nas seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de 0,5% (meio por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado do(s) item (s) prejudicado(s) pela conduta da licitante;
- c) impedimento de licitar e de contratar com o Município de Cajati/SP pelo prazo de



até 05(cinco) anos.

O Contratante recusará total ou parcialmente o objeto executado pela Contratada, que apresente qualquer desconformidade, conforme previsto no Art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93;

**Cajati, 10 de maio de 2024**

---

**ISAURA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE FREITAS**  
**RT DE ODONTOLOGIA**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC49-4467-8EB1-E6F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ISAURA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE FREITAS (CPF 103.XXX.XXX-05) em 09/08/2024 17:05:20  
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DC49-4467-8EB1-E6F3>

**Memorando 7- 11.395/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** SMS-DAS-DAS-CEODON - Centro Odontológico - A/C Isaura F.

**Data:** 12/08/2024 às 09:55:00

Bom dia.

Aguardo o envio do ETP e TR, nesta ordem de acordo com a nova lei de licitações (Lei 14.133/2021).

O termo de referência deve ser elaborado nos termos do artigo 6º, inciso XXIII da referida lei.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Memorando 8- 11.395/2024**

**De:** Rosemeire S. - SEADM-DESUP

**Para:** SMS - Secretaria Municipal de Saúde - A/C Maria B.

**Data:** 12/08/2024 às 10:00:15

Bom dia [Maria Carmen Amarante Botelho - SMS](#)

Para conhecimento e providências com a urgência que o caso requer.

—

**Rosemeire Vieira Dos Santos**

*Diretora do Departamento de Suprimentos*

**Memorando 9- 11.395/2024**

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 13/08/2024 às 11:34:12

Prezados,

Para ciência,

Informo que a Isaura já foi devidamente orientada quanto às etapas que devem ser seguidas, bem como em relação ao Termo de Referência, conforme disposto na NLL 14.133.

Ressalto que o ETP está finalizado, porém ainda necessito de cotações para dois itens pendentes. Já solicitei apoio à RT, que foi responsável por levantar o preço no DFD.

Diante disso, reforço que o ETP será concluído assim que essas cotações forem integralmente finalizadas.

Sem mais.

—  
**Bruna Morelli R. Pereira**  
Secretaria Municipal de Saúde  
*DIVISÃO DE SUPRIMENTOS*



## Memorando 10- 11.395/2024

---

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/08/2024 às 10:09:56

**Setores envolvidos:**

SEADM, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SMS-DAS-DAS-CEODON, SMS-DGS-AQUI

### Envio de DFD | Insumos Odontológicos

Prezados,

Segue anexo o Estudo Técnico Preliminar (ETP) e seus anexos.

Sem mais.

—  
**Bruna Morelli R. Pereira**  
Secretaria Municipal de Saúde  
*DIVISÃO DE SUPRIMENTOS*

**Anexos:**

ETP\_n\_0132024\_Insumos\_Odont\_com\_anexos.pdf

# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ETP nº 013/2024

Em conformidade com o Art. 18, § 1º da Lei 14.133/2021

Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP.

**Unidade administrativa responsável:** Secretaria Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6

## **1. INTRODUÇÃO:**

1.1 Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo analisar a aquisição de insumos e materiais odontológicos necessários para atender às demandas do Centro Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 A iniciativa visa garantir a continuidade dos atendimentos odontológicos oferecidos à população, assegurando a viabilidade das operações e o cumprimento eficiente das atividades. A aprovação desses materiais é essencial para manter a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à comunidade.

## **2. DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO VIGENTE:**

2.1 Atualmente, contamos com uma Ata de Registro de Preços (ARP) para a aquisição dos materiais deste ETP. ARP nº 055/2023 – vinculada ao Pregão Eletrônico nº 064/2023.

2.2 A ARP se mostrou uma excelente opção para adquirir os insumos devido à agilidade nas entregas e aos valores acessíveis.

## **3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. I):**

3.1 A necessidade de aquisição de insumos odontológicos para o Centro Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati/SP é fundamental para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Os insumos são essenciais para a realização de procedimentos odontológicos, garantindo que os atendimentos sejam realizados de forma segura, eficiente e com o padrão de qualidade exigido.

3.2 A manutenção adequada do estoque de materiais odontológicos é crucial para a operacionalidade do Centro Odontológico, pois permite que os profissionais da saúde bucal possam executar suas atividades sem interrupções, atendendo às necessidades dos cidadãos de maneira oportuna. A ausência desses materiais comprometeria gravemente a capacidade de atendimento, resultando em atrasos, redução da qualidade do serviço e, potencialmente, no agravamento das condições de saúde dos pacientes.

3.3 A aquisição dos materiais odontológicos tem como finalidade assegurar o acesso da população aos atendimentos odontológicos ofertados na rede de atenção básica do Município de Cajati/SP, resguardando os princípios de equidade e justiça social. Vale ainda mencionar a Lei nº 14.572/2023, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para incluir a saúde bucal no campo de atuação do SUS. Este marco legal reforça o compromisso de garantir acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no SUS, reconhecendo a saúde bucal como um direito fundamental de todos os brasileiros.

3.4 As principais diretrizes do programa são baseadas no direito de todos os cidadãos a um sorriso saudável, o que é parte fundamental para uma vida digna, para o aumento da autoestima e para o exercício pleno da cidadania. A disponibilização de insumos odontológicos adequados é, portanto, um elemento central para a implementação desta política pública, permitindo que o Município de Cajati/SP continue a oferecer serviços de saúde bucal de excelência, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da população.

#### **4. DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, § 1º, inc. II):**

4.1 O objeto em questão estará contemplado no Plano de Contratações Anual da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati, alinhado com o planejamento desta Administração.

4.1 A falta de insumos odontológicos no Centro Odontológico pode causar impactos negativos significativos nas políticas públicas de saúde. Primeiramente, a ausência desses materiais essenciais pode levar à interrupção ou redução dos atendimentos, comprometendo a continuidade dos cuidados e aumentando o tempo de espera dos pacientes. Essa situação pode gerar insatisfação na população e prejudicar a eficácia dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, a saúde pública pode ser diretamente prejudicada, uma vez que a falta de insumos pode resultar em diagnósticos tardios, tratamentos inadequados ou incompletos, agravando as condições de saúde dos pacientes e aumentando a demanda por serviços de urgência e emergência. Isso, por sua vez, eleva os custos do sistema de saúde a longo prazo.

4.2 A escassez de insumos também pode exacerbar as desigualdades no acesso aos serviços de saúde bucal, especialmente para as populações mais vulneráveis, que dependem exclusivamente do SUS para seus cuidados odontológicos. Essa situação contraria os princípios de equidade e justiça social que fundamentam as políticas públicas de saúde. Além disso, problemas de saúde bucal não tratados podem afetar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos, causando dor, desconforto, dificuldades alimentares e impacto na autoestima, o que evidencia que a falta de insumos afeta não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e social das pessoas.

4.3 Outro impacto relevante é o comprometimento das metas governamentais. A ausência de insumos pode impedir o cumprimento das metas estabelecidas pelas políticas públicas de saúde bucal, como as previstas na Política Nacional de Saúde Bucal. Isso pode resultar em avaliações negativas de desempenho, dificultar a obtenção de recursos e comprometer a credibilidade das gestões locais e estaduais na área da saúde. Além disso, a falta de prevenção e tratamento adequados pode levar a complicações de saúde mais graves e dispendiosas para o sistema público, como a necessidade de tratamentos complexos ou hospitalizações, aumentando a carga financeira sobre o SUS.

4.4 Esses impactos mostram a importância de garantir um fornecimento contínuo e adequado de insumos odontológicos, como forma de proteger a saúde da população e assegurar o sucesso das políticas públicas de saúde.

#### **5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. III):**

5.1 A contratada, além de cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local que constarão no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual deverá constar as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e Lote. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas.

5.2 As empresas participantes deverão apresentar os seguintes documentos:

5.2.1 Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis Complementares.

5.2.2 Cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do Licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via Internet.

5.2.3 Declaração de que a(s) empresa(s) fabricante(s) dos materiais de enfermagem ofertados por sua empresa, possui(em) Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

5.2.4 Comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde, para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

5.2.4.1 Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência.

5.2.4.2 Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao do vencimento.

5.2.4.3 Para os materiais odontológicos em que não seja necessário Registro a empresa deverá apresentar documento que comprove a dispensa do registro na ANVISA.

## **6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. IV):**

6.1 Segue, de forma detalhada, a listagem dos materiais com as especificações e quantitativos necessários, considerando a demanda da Secretaria:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	100 PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM SABOR, PONTA ANIMAIS, PCT COM 40 UND – Especificação técnica: Abaixador de Língua com aroma, sabor de Tutti-Frutti, ponta animais; pacote com 40 unidades cada, embalados individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto; cada abaixador deve ser decorado com figuras de animais em cores sortidas; produzido em plástico atóxico, livre de toxicidade, que não irrita, sem açúcar, sem látex e sem medicamentos; não esterilizável; descartável/uso único; higienizado; colorido com dióxido de titânio rutilo e pigmentos orgânicos; com aroma artificial de Tutti-Frutti; dimensões (unidade): 124 mm x 16 mm x 3 mm. Certificações: Aprovação pelo FDA, possuir testagens de biocompatibilidade feitas periodicamente no Brasil e nos Estados Unidos desde 1999 a cada dois anos e produzido de acordo com as normas ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e RDC 59/ BPF e Registro ANVISA: 10438720003.
2	10 KITS	ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO EM KIT (1 ADULTO e 1 CRIANÇA), EM SILICONE ATÓXICO – Especificação técnica: Abridor de boca anatômico; em Kit (1 unidade tamanho adulto e 1 unidade tamanho infantil); formato trapezoidal com ranhuras laterais; em silicone atóxico; esterilização em meios físico-químicos; garantia mínima de 01 ano a partir da entrega; Kit embalado individualmente, em material apropriado que garanta integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.



3	10 UND	ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM 4 MEDIDAS – Especificação técnica: Abridor de boca anatômico; para Pessoas com Deficiência, reposição compatível com Abritec PCD/Indusbello; com 4 medidas diferentes em um único produto (14mm, 20mm, 26mm e 32mm); em silicone atóxico; esterilização em meios físico-químicos; garantia mínima de 1 ano; embalagem individual, em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
4	15 PTS	ABRASIVO EM PÓ, PEDRA POMES, PARA PROFILAXIA DENTAL, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, POTE C/100 GRAMAS - Abrasivo, em pó, pedra pomes, para polimento e profilaxia dental, granulação extrafina, embalado em pote com 100 gramas, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
5	30 KITS	ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA - em pontas de silicone flexíveis ;impregnadas com óxido de alumínio, não produzindo calor excessivo; caixa com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2discos). Composição de tri polímero (estireno Butadieno-Metacrilato de Metila) Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetanolamina e óxido de alumínio . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
6	60 UND	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - Sistema de adesivo de frasco único (prime e adesivo), com tampa flip top e bico dosador, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, sistema adesivo com nanotecnologia, contendo cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Utilizado nas técnicas de condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), auto condicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte, indicado para restaurações diretas e indiretas, sem a necessidade de aplicação de um primer metálico e silano.Composição: Metacrilato de 2-hidroxieta (15 a 25% em peso), Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA) (15 a 25% em peso), Decametileno dimetacrilato (5 a 15% em peso), Etanol (10 a 15% em peso), Sílica tratada de silano (5 a 15% em peso), Água (10 a 15% em peso), 1,10-Decanodiol fosfato metacrilato (1 a 10% em peso), Copolímero de acrílico e ácido itacônico (1 a 5% em peso), Caforoquinona (menor que 2% em peso), N-Dimetilbenzocafina (menor que 2% em peso). Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
7	200 GALÕES	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega.
8	10 CX	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA - Agulha gengival longa em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
9	60 CX	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - Agulha gengival curta em cânulaem aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade,com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
10	25 CX	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA - Agulha Gengival 30G extra curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médico, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plásticaindividual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

11	20 LT	ALCOOL ETILÍCO 92,8 IGPM (CATEGORIA COMERCIAL) - FRASCO COM 1 LITRO - Líquido; com teor de no mínimo 92,8 IGPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rotulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Com registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
12	800 LT	ALCOOL ETILÍCO A 70 % PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES – FRASCO COM 1 LITRO – Indicado para desinfecção de superfícies e artigos semi e não críticos; frasco de 1 litro, contendo dados de identificação, nº de lote, validade e responsável técnico; em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
13	120 CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) + Epinefrina 10 µg/mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, cada embalagem contém 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
14	15 CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML - Anestésico local injetável, a base de lidocaína a 3% e norepinefrina, tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as normas de procedimentos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
15	5 CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2 % SEM VASOCONSTRITOR - Tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
16	60 UND	ANESTÉSICO TÓPICO GEL - Frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel, benzocaina a 20%, hidrossolúvel, em pote, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
17	150 UND	BABADOR DESCARTÁVEL – Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável; folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico; maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades.
18	10 UND	BICARBONATO DE SÓDIO - Bicarbonato de sódio odontológico; pó extrafino para polimento e profilaxia dental, pureza (99,6%), sem aroma, sem corantes; em frasco plástico; acondicionados em pote de 250g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, o produto deverá obedecer a legislação vigente; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
19	100 UND	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 COM CABO E LÂMINA - Composto por um cabo plástico resistente, com lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

20	100	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 COM CABO E LÂMINA - Composto por um cabo plástico resistente, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
21	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
22	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
23	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
24	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
25	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
26	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
27	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

28	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
29	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
30	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
31	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 11168F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
32	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
33	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
34	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
35	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

36	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
37	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
38	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
39	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
40	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
41	30 UND	BROCAS ZÉCRYA HL - Broca do tipo Zécrya número 151, formato tronco-cônico, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Utilizada para odontosecção e corte/desgaste de osso. Ideal para cirurgia de ciso incluso. Tamanho: 28 mm de comprimento total. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
42	15 UND	BLOCO PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO – Bloco para espatulação; de papel plastificado; tamanho de 15cm x 8cm aproximadamente; com 50 Folhas; embalagem que garanta a integridade do produto.
43	30 PCT	CANUDO DESCARTAVEL EM PP, DIAM. 5,5 mm, LISO - Canudo descartável; de polipropileno; com diâmetro de 5,5mm; medindo 210mm; branco, liso e acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto. Embalagem com 100 unidades.

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



44	30 UND	CARIOSTÁTICO 30 % – Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meioamoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F <sub>2</sub> (Fluoreto de Cálcio) e Ag <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> (Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos proteicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de carióstáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
45	5 UND	CIMENTO CIRÚRGICO – sem eugenol produzido através da mistura de seus componentes, ótima textura e plasticidade após a presa. Produto de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol e cera natural. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido de zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol e BHT. Validade mínima: 2 anos da data de entrega.
46	15 UND	CIMENTO PROVISÓRIO ENDODÔNTICO COM IODOFORMIO – Material temporário para obturação de canal radicular; com Iodofórmio que confere a pasta propriedade anti-infecciosa e intensa radiopacidade; pasta de Hidróxido de Cálcio pronta para o uso; de fácil aplicação; ação anti- bacteriana; que induz a formação de dentina reparadora; com consistência ideal para escoamento no canal radicular; apresentação: 1 seringa de 2,5ge 3 bicos aplicadores. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.
47	6 UND	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ. (10ml) - Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de óxido de zinco com até 10% de óxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por ácido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.
48	6 UND	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO – Benefícios: massa de fácil manipulação; endurecimento rápido; menor microinfiltração marginal. Características: obturador provisório normal. Aplicação: indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos. Apresentação: Embalagem c/25g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
49	150 LT	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO, EMBALAGEM DE 1 LITRO – Solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de clorexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo aspecto pronto para o uso. Embalagem contendo 1 litro. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
50	20 UND	CLOREXIDINA 2% - Antisséptico com atividade antibacteriana, com eficácias para gram-negativas, fungos leveduras e alguns dermatófilos. Composição- digluconato de clorhexidina 2%, metilparabeno, água deionizada. (livre de álcool etílico) Frascos com 100ml. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.
51	20 UND	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTE – Capacidade para 05 litros, para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc. Alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853.
52	6.000 UND	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - Com 13 fios, 7,5x7,5 cm; em 100% de viscose branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras; medindo 7,5cm x 7,5 cm; com formato quadrado; estéril; embalado com 10 unidades cada, embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico e laudo analítico laboratorial, de cumprimento da NBR 13843. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.

53	200 PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5x7,5 cm, NÃO ESTÉRIL, PACOTE C/500 UND – Compressa de gaze hidrófila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 5 dobras, 8 camadas, sem filamento radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 cm; com formato quadrado; não estéril; embalado em pacote com 500 unidades que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 anos da data de entrega.
54	60 UND	CONDICIONADOR DENTAL GEL - Gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, espessado com Sílica Coloidal. Composição: Ácido Fosfórico, Sílica Coloidal, Surfactante e Corante. Embalagem com 3 seringas de 3 ml e 3 ponteiros p/ aplicação. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
55	10 KITS	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMOCA DE MADEIRA, 5 TAMANHOS, CODIF. POR CORES - Embalagem com 100 unidades; Especificação Técnica: Cunha interdental; confeccionada em madeira; formato anatômico da ameia, em 5 tamanhos diferentes codificados por cores; constando externamente quantidade, marca comercial, procedência de fabricação.
56	15 UND	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM FLUORETO DE SÓDIO 2% E NITRATO DE POTÁSSIO, SER. 2,5g – Gel de baixa viscosidade dessensibilizante oclusivo à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2% que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
57	100 UND	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carbohidrase); sendo as principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; específico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
58	30 UND	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, (tipo de unha) – Para uso na limpeza de artigos de pequeno e médio porte. Descrição: Escova plástica para limpeza delicada, cor sortida. Dimensões: 9.5 x 2.5 cm.
59	200 UND	ESCOVA ROBSON, PEQUENA, CERDA PLANA, NA COR BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO - Escova de Robson; pequena; para profilaxia; com cerda plana; haste metálica, e cerdas em nylon na cor branca; para contra angulo; embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial, numero de lote, data de fabricação e procedência.
60	20 UND	ESPATULA PARA ODONTO PLÁSTICA, FLEXIVEL, PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO - Especificação Técnica: Espátula para odontologia; de plástico, flexível; para manipulação de Ionomero de Vidro. Medidas aprox. 21,50x3,20x0,50cm (c x l x a); embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
61	100 UND	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX - Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos, passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto, embalado individualmente, marca comercial, procedência de fabricação.

62	10 UND	ESPELHO TOUCADOR COM CABO, FORMATO DENTE – Espelho de mão para procedimentos clínicos; toucador com cabo; formato dente; disponível em diversas cores; tamanho aproximado de 19,5cm de comprimento. Embalagem com 1 unidade.
63	20 CX	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UND - Esponja Hemostática produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado; com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; que seja completamente reabsorvida pelo organismo em 15 dias; material atóxico e não pirogênico; esterilizada por raios gama; com material leve com peso aproximado de 10 mg; dimensões: 1x1x1 cm e com Registro ANVISA. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.
64	40 UND	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA SOLUÇÃO , frasco C/10 ml. Evidenciador de placa bacteriana em solução, em frasco c/10 ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
65	50 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 20 mm- fio agulha de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 2,0 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
66	20 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 - Monofilamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 15 mm- fio agulha de sutura nylon monofilamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
67	30 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 4-0 - Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ. – CT 15 mm -Fio agulhado de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 4-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
68	10 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA SEDA, NÚMERO 4-0 - Fio de Sutura de Seda Preta. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.* Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Uso exclusivo em Odontologia. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
69	20 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 5-0, AGULHA 3/8 Cir. - Fio de sutura de nylon obtido da proteína e goma docasulo do bicho da seda, n.5-0, preto trançado, agulhado -3/8 circ. triangular, CT 1,5cm, fio medindo 45 cm, uso odontológico, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ter comprovação de sua esterilidade, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
70	40 UND	FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

71	5 UND	FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, Nº. 00, CORDÃO TRANÇADO MALEÁVEL, NÃO IMPREGNADO - Fio para retração gengival; composto por cordão trançado e maleável 100% algodão, não impregnado por substância química, n. 00; embalado em frasco com 240 cm aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 02 ano da data de entrega.
72	3 CX	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4 cm. Filme para radiografia periapical para adulto, 3 x 4cm, compatível com processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
73	40 UND	FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe I (ISO 11140-1). Apresentações: Medidas – 19mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
74	60 FRC	FLUOR GEL – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
75	10 UND	FORMOCRESOL, SOLUÇÃO - Formula BUCKLEY, frasco c/10 ml em solução, composição formula buckley, em frasco com 10 ml, embalado individualmente, constando externamente procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
76	50 PCT	GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL EM TNT POLIPROPILENO – Gorro cirúrgico descartável; em não tecido polipropileno, gramatura 50, branco, hipoalergênico, atóxico; com elástica na parte posterior; com formato anatômico; que permita ventilação adequada; embalagem com em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Contendo 10 unidades em cada pacote.
77	06 UND	HEMOSTÁTICO LIQUIDO – Indicações: indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restaurações, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Composição: Álcoois, cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinololna e água purificada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
78	15 UND	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - Indicação capeador pulpar, material para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Propriedades: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de Hidróxido de Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
79	100 LT	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%- Bactericida, desinfetante, ação química de solvente de tecidos, antisséptico, característica físico química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000 ml. Validade mínima 2 anos da data de entrega.

80	20 CX	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de <i>GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS</i> que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
81	1CX	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5, COM 100 UND – Descrição: Indicador químico integrador Classe 5, para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, de acordo com a RDC 15; que reaja a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor); que permita a leitura imediata do resultado através da migração da tinta para a área identificada. Características: Classificação Classe 5; Composição: produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; Parâmetros: Classe 5 - 135°C por 1,5 minutos / 121°C por 21 minutos; Dimensões da tira: aproximadamente 102 x 19 mm (l x c); Apresentação: Embalagem com 100 unidades; Prazo de validade informado na embalagem do produto; Validado de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e Registrado no FDA e de acordo com AMMI ST60. Validade de 2 anos da data de entrega.
82	20 UND	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
83	80 KITS	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDADE: Apresentação: kit contendo um frasco de pó com no mínimo 5g e um frasco de líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água, com quantidade compatível com o quantitativo de pó, com medidor pó/líquido; Características do material: o cimento de ionômero de vidro restaurador deve ser do tipo de alta viscosidade, condensável, quimicamente ativado, radiopaco, autopolimerizável, com erosão máxima: 0,17mm, máximo 5 min, conjunto completo indicado para realização do tratamento restaurador atraumático (ART); Descrição complementar: resultados comprovados pela norma iso 9917; proporção de mistura pó/líquido superior a 3,5; resistência à compressão: mínima de 200mpa; resistência flexural: mínima de 25mpa; o produto deve ser reconhecido no meio científico através de estudos publicados em jornais e revistas de circulação do meio acadêmico, nacional e internacional; As embalagens primária e secundária deverão estar em conformidade com a legislação vigente do ministério da saúde e código de defesa do consumidor. Validade mínima de 2 anos da data de validade.
84	80 KITS	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão do esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Ionômero pó (10g), composto de Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de Bário, Ácido Poliacrílico. Pigmentos, composição do líquido: Ácido Tartárico e Água Destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
85	20 KITS	KIT REVELADOR E FIXADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO – REVELADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. FIXADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml. Ambos da mesma marca comercial. Validade mínima de ambos de 2 anos da data de entrega.
86	2 CX	LÂMINA DE BISTURÍ Nº12 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
87	2 CX	LÂMINA DE BISTURÍ Nº15 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.



88	1000 PARES	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5- Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes elásticas, oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
89	1000 PARES	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.
90	3000	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL TAMANHO 7,5 Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.
91	100 CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO M- Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante. Microtexturizada. Ação Antiderrapante. Totalmente isenta de pó. Hipoalergênica. Ambidestra. Embalagem: 100 Unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
92	150 CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega
93	200 CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
94	500 CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
95	15 UND	MANDRIL ODONTOLÓGICO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, PARA ENCAIXE DE DISCOS POP-ON- Para polimento e acabamento de restaurações, adaptação em contra-ângulo, com haste de 15mm de comprimento; embalagem individual que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

96	20 PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, Nº 1 – Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, nº 1, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
97	20 PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, PRÉ-MOLAR– Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo pré-molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
98	20 PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, MOLAR– Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
99	30 UND	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm - Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 nos da data de entrega.
100	30 UND	MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm – Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
101	10 KIT	MATRIZ SECCIONAL PRE CONTORNADA - Kit com 50 matrizes seccionais, pré contornadas de tamanho variado, com espessura das matrizes de 0,05mm e em aço inox. Facilidade na reconstrução do ponto de contato, obtenção de uma anatomia natural devido a convexidade das matrizes. Maior conforto para o paciente. Espessura das matrizes de 0,05mm. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
102	8 UND	MEDICAÇÃO OCLUSIVA; PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE - Medicação oclusiva; pasta para tratamento de alveolite composta basicamente por: Lidocaína, Eugenol, Laurilsulfato de sódio, Carbonato de cálcio, Penghawar djambi, Azeite, Água purificada e Aromanatural de hortelã; Composição do aroma natural de hortelã: mistura de óleoessencial de hortelã-verde e de óleo essencial de eucalipto; exclusivamentepara uso tópico; embalada em frasco de 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 18 mesesda data da entrega.
103	5 CX	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS SORTIDAS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR EM GEL - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; em tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) e 6 a 12 anos (azul); caixas com moldeiras sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
104	40 UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO – Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
105	30 UND	PAPACÁRIE DUO GEL – Apresentação: seringa com 1 ml; Características: gel com base em papaína, azul de toluidina e cloramina; Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data validade. Validade de no mínimo 18 meses da data de entrega.

106	50 UND	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE AZUL E VERMELHO utilizado para marcação de pontos oclusais possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais que atinja anatomicamente os pontos oclusais. Possua folhas especiais 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelha e 100 micras de espessura. Embalagem com 10 folhas -25mm x 97 mm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
107	30 RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx100m - Composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxicidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
108	15 RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
109	30 RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
110	20RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m -- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
111	50 RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
112	15 UND	PARAMONOCLOROFENOL - material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
113	25 UND	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6

		ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas + 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas + 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
114	50 UND	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado Apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
115	5 UND	PEDRA DE AFAR DE ARKANSAS, GRANULAÇÃO FINA - Especificação Técnica: Pedra de Afar Instrumental Odontológico; de Arkansas; granulação fina; tamanho: 10 x 2,5 x 6 cm; Tipo: Pedra natural, em tonalidades que variam de cor branca a cinza, sedo suaves para afiação dos instrumentais com desgaste mínimo da ponta. Embalada Individualmente; Constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
116	20 CX	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO - Indicado para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiaposque permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
117	30 CX	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR - Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
118	6 UND	PORTA AMALGAMA ADULTO DE PLÁSTICO ATÓXICO - Porta amalgama; adulto; corpo contendo inscrição de marca; confeccionado em plástico/similar atóxico; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
119	5 KITS	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO ADULTO - Kit com 4 peças sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis, utilizados para dentes anteriores e posteriores, esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.
120	30 UND	POTE DAPPEN, PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL – Pote Dappen; plástico; composto a base de nylon; com boa resistência; esterilizável em autoclave a 137°C; possuindo duas cavidades para as manipulações; Medindo: altura 3 cm, concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml, concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; possuindo 12 dimensões; embalagem Individual.
121	20 UND	POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO COLORIDO, AUTOCLAVÁVEL - Pote Dappen; de vidro temperado colorido, autoclavável; espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarba, com 2 concavidades e capacidade de 5ml e 2ml; para manipulação de materiais odontológicos; embalagem individual.
122	30 UND	PRENDEDOR DE GUARDANAPO DE METAL JACARÉ - Prensador de guardanapo; de metal, passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

123	10 UND	RESINA COMPOSTA COR A1 - Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO - Resina micro-híbrida, seringa com 4 g; cor A1; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência defabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
124	30 UND	RESINA COMPOSTA COR A2 Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A2; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência defabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
125	15 UND	RESINA COMPOSTA COR A3 Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A3; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
126	15 UND	RESINA COMPOSTA A3,5 Z100 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A3,5; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência defabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
127	15 UND	RESINA COMPOSTA A2 Z250 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; cor A2; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
128	15 UND	RESINA COMPOSTA A3 Z250 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; cor A3; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
129	06 UND	RESINA COMPOSTA COR OA2 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação : seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



130	06 UND	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação: seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
131	15 UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A2 - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g nacor A2. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
132	15 UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A3 - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g nacor A3. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
133	5 UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW OPACA - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: seringa com 2,4g nacor OPACA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
134	6 KITS	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO TIPO II, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL- KIT PÓ 38g E LIQUIDO 15ml – Cimento de óxido de zinco uso odontológico; tipo II reforçado para restaurações temporárias de longa spera; apresentação kit pó e líquido; pó cor marfim em frasco com aproximadamente 38g; composto basicamente de óxido de zinco metacrilato de metila; líquido em frasco com aproximadamente 15ml; composto basicamente por eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%; embalado individualmente kit pó, líquido, conta gotas + colher dosadora; constando externamente marca comercial e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
135	500 UND	ROLETE DE ALGODÃO –com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
136	300 RL	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO-com fibra 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos; embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
137	100 PCT	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, POLIETILENO, PROTEÇÃO DE CANETA, 4,5x23CM, PAC. 100 und. - Saco plástico descartável; de polietileno; para proteção de caneta (tipo Geladinho); medindo aproximadamente 4,5 x 23 cm; pacote c/ 100 unidades.

138	100 PCT	SACO PLASTICO LEITOSO 17x17cm, TIPO PARA LANCHE - Saco plástico leitoso, tipo para lanche; medindo aproximadamente 17x17 cm; embalagem com 100 unidades.
139	5 KITS	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS – Apresentação Kit contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação; fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
140	20 UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO FINA REPOSIÇÃO – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
141	20 UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO MÉDIA REPOSIÇÃO – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
142	20 UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO GROSSA REPOSIÇÃO – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
143	200 UND	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDRIGÊNIO 3% - AGUA OXIGENADA 10 vol FRASCO COM 100 ml - Água oxigenada 10 volumes; princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%; sem conservantes; medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos; apresentação: em frasco plástico opaco, tipo almotolia, contendo 100 ml; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade, fórmula e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
144	5 UND	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA – Especificação técnica: Acondicionada em frasco com 10 ml; hemostático local uso odontológico; em solução sem epinefrina atóxica; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; Registro Conforme Legislação Vigente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
145	200 PCT	SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM 40 UND - Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti-frutti colorido, rosa, verde, transparente e azul; cada pacote contendo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
146	50 UND	TIRA DE LIXA DE AÇO – Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 6 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 6 mm x 150mm. Embalagem individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

147	50 UND	TIRA DE LIXA DE AÇO – Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 4 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 4 mm x 150mm. Embalagem individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
148	15 CX	TIRA DE LIXA DE POLIESTER SOF-LEX REPOSIÇÃO - indicada para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Características : tamanho das tiras 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Tira possuindo um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies Inter proximais dos dentes. apresentação: caixa com 50 tiras .com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
149	100 PCT	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – Atóxico 100% polipropileno, gramatura 20 colorido não estéril, diâmetro: 50 x 50 não inflamável, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 3 anos da data de entrega
150	6 UND	TRICRESOL - Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96º e água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução. Embalagem com 50 tiras. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
151	10 UND	VASELINA SÓLIDA- Indicada como emoliente; mistura de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos; auxilia no tratamento de rachaduras de pele, como umectante; tem efeito emoliente e melhora a elasticidade; embalagem com 1 pote de 90g. Validade de no mínimo 2 anos da data de entrega.
152	15 BISN	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz de flúor para uso profissional; apresentação em bisnaga com 10 ml; com alta concentração de flúor - 22.600ppm (NaF 5%); sem a necessidade da adição de solventes; deve ser: altamente tolerante a água e com cobertura mesmo em superfícies úmidas, com filme verniz de boa aderência e endurecendo com a saliva; Composição: Aqua, Calcium Carbonate, Sorbitol, Arginine Bicarbonate, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Tetrasodium Pyrophosphate, Tricalcium Phosphate, Sodium Saccharin, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, CI 77891, Limonene. Contém Monofluorofosfato de Sódio (1450ppm de Flúor). Validade de no mínimo 2 anos da data de fabricação.

## 7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, § 1º, inc. V):

7.1 A contratação em questão é necessária para dar continuidade às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Não foram identificadas situações específicas ou de complexidade técnica que justifiquem outra abordagem. A solução mais adequada para atender aos interesses e necessidades da Administração é a contratação de uma pessoa jurídica especializada para fornecer os produtos com as especificações exigidas pela Secretaria de Saúde.

7.2 Considerando a grande diversidade de fabricantes, marcas, modelos e empresas fornecedoras desses produtos no mercado, a escolha se baseia nas especificações básicas necessárias e no menor preço encontrado. Não há outra solução no mercado que atenda à demanda, uma vez que a locação desses produtos não é comum e a produção pelo município é inviável.

7.3 Portanto, essa estratégia é economicamente e tecnicamente viável para a Administração Pública, pois oferece uma boa relação custo-benefício e qualidade na prestação do serviço.

## 8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. VI):

8.1 A estimativa foi baseada no valor da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 055/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 064/2023, da Prefeitura Municipal de Cajati – SP. Além disso, foram realizadas consultas de preços em empresas do setor odontológico, tanto por meio de websites quanto por e-mail, conforme detalhado no Anexo I.

8.2 A contratação está estimada em **R\$ 155.267,44** (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

*8.2.1 Ressaltamos que os preços obtidos no DFD nº 002/2024, pela Seção de Saúde Bucal, foram atualizados com base nos sites consultados, resultando em alterações nos valores. Dessa forma, o preço estimado deste ETP é superior ao do DFD.*

#### **6. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, § 1º, inc. VII):**

6.1 Diante da especificidade dos materiais necessários e das opções disponíveis, conclui-se que a melhor solução para atender ao interesse público é a aquisição de materiais odontológicos por meio de uma Ata de Registro de Preços, utilizando-se de potenciais fornecedores e fabricantes, com o objetivo de suprir as necessidades institucionais.

6.2 Além de ser uma necessidade nesses produtos no local odontológico, a compra oferece vantagens como agilidade na aquisição e garantia de qualidade nos atendimentos aos munícipes.

6.3 Todos os detalhes necessários para atender à demanda da Administração estarão descritos no Termo de Referência, incluindo as obrigações e responsabilidades da contratada, bem como outras especificidades do objeto.

#### **7. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. VIII):**

7.1 Considerando que a licitação poderá ser realizada por item, onde o objeto é divisível, onde foi verificado não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia, e que levando em consideração o mercado fornecedor, a viabilidade técnica e econômica do parcelamento, o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade, conclui-se pela necessidade da Administração em adotar o parcelamento da solução desta licitação através de itens, pois o objeto é divisível.

7.2 Diante disto, a contratação poderá ser realizada por meio de Pregão Eletrônico, com o tipo de julgamento sendo o de **menor preço por item**, visando à contratação através do Sistema de Registro de Preços, conforme estabelecido na Lei 14.133/21.

7.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

7.4 Todos os detalhes necessários para atender à demanda da Administração estarão descritos no Termo de Referência, incluindo as obrigações e responsabilidades da contratada, bem como outras especificidades do objeto.

#### **8. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, § 1º, inc. IX):**

8.1 A aquisição dos insumos odontológicos visa garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde bucal oferecidos à população, assegurando que o Centro Odontológico possa atender de forma eficaz e sem interrupções.

8.2 Espera-se que essa aquisição resulte em um atendimento mais ágil e seguro, com diagnósticos precisos e tratamentos completos, prevenindo complicações e reduzindo a necessidade de intervenções de urgência.

8.3 Além disso, a disponibilidade constante de materiais permitirá que o município cumpra as metas estabelecidas pela Política Nacional de Saúde Bucal, promovendo a equidade no acesso aos serviços de saúde e fortalecendo a confiança da população no SUS.

8.4 Outro resultado esperado é a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, pois um cuidado odontológico adequado contribui para a saúde geral, o bem-estar e a autoestima dos pacientes.

8.5 Assim, a aquisição desses insumos busca não apenas atender às demandas imediatas, mas também contribuir para a sustentabilidade e eficiência do sistema de saúde pública em Cajati/SP.

#### **9. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (Art. 18, § 1º, inc. X):**

9.1 Antes da celebração do contrato, a administração deve adotar algumas providências essenciais. Isso inclui verificar a regularidade fiscal e jurídica da empresa contratada, elaborar e obter autorização orçamentária, além de garantir o atendimento as qualificações técnicas mencionadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

9.2 Essas medidas são fundamentais para garantir que a contratação seja realizada de forma adequada e em conformidade com as normas vigentes.

#### **10. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, § 1º, inc. XI):**

10.1 Esta contratação não possui correlação ou interdependência com outras contratações no âmbito da Secretaria de Saúde.

#### **11. DA DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, § 1º, inc. XII):**

11.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores quanto à sua atividade.

#### **12. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (Art. 18, § 1º, inc. XIII):**

12.1 O posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina é favorável, considerando que a aquisição dos insumos odontológicos é essencial para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelo Centro Odontológico.



12.2 A contratação é plenamente adequada e justificada, uma vez que atende diretamente às demandas de saúde bucal da população, assegura o cumprimento das metas estabelecidas pelas políticas públicas de saúde e reforça os princípios de equidade e justiça social.

12.3 A aquisição desses materiais não apenas mantém a operacionalidade do serviço, mas também promove a saúde e o bem-estar da comunidade, sendo, portanto, uma medida necessária e de grande relevância para o município.

### 13. RESPONSÁVEIS

Conforme o Memorando nº 11.395/2024 na plataforma 1Doc, onde foi designada a servidora para compor a Equipe de Planejamento da Contratação, visando à elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), como parte das demandas para fins de "Aquisição de materiais odontológicos", a saber:

**Bruna Morelli Rodrigues Pereira**  
Inscrito sob a Matrícula nº 4255  
Escriturária



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
- SÃO PAULO -  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



# ANEXO I

**MAPA DE PREÇOS - INSUMOS ODONTOLÓGICOS**

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	PE nº 64/2023 - Ata nº 55/2023		WEBSITES/E-MAIL	
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	100	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM SABOR, PONTA			R\$ 34,43	R\$ 3.443,00
2	10	KIT	ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO EM KIT (I			R\$ 17,79	R\$ 177,90
3	10	UND	ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO PARA			R\$ 236,68	R\$ 2.366,80
4	15	PCT	ABRASIVO EM PÓ, PEDRA POMES, PARA			R\$ 13,49	R\$ 202,35
5	30	KIT	ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA -			R\$ 149,90	R\$ 4.497,00
6	60	UND	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - Sistema de	R\$ 90,89	R\$ 5.453,40		
7	200	GL	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00		
8	10	CX	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA - Agulha gengival	R\$ 30,25	R\$ 302,50		
9	60	CX	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - Agulha gengival	R\$ 30,24	R\$ 1.814,40		
10	25	CX	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA - Agulha	R\$ 30,24	R\$ 756,00		
11	20	LT	ALCOOL ETILÍCO 92,8 IGPM (CATEGORIA	R\$ 6,79	R\$ 135,80		
12	800	LT	ALCOOL ETILÍCO A 70 % PARA	R\$ 5,28	R\$ 4.224,00		
13	120	CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO	R\$ 92,30	R\$ 11.076,00		
14	15	CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO	R\$ 115,76	R\$ 1.736,40		
15	5	CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO	R\$ 237,60	R\$ 1.188,00		
16	60	UND	ANESTÉSICO TÓPICO GEL - Frascos com 12g sabor	R\$ 13,00	R\$ 780,00		
17	150	UND	BABADOR DESCARTÁVEL – Indicado para proteger o	R\$ 13,90	R\$ 2.085,00		
18	10	UND	BICARBONATO DE SÓDIO - Bicarbonato de sódio	R\$ 9,99	R\$ 99,90		
19	100	UND	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 COM CABO E	R\$ 0,44	R\$ 44,00		
20	100	UND	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 COM CABO E	R\$ 0,44	R\$ 44,00		
21	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
22	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 – Broca	R\$ 2,14	R\$ 64,20		
23	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015 – Broca	R\$ 2,14	R\$ 64,20		
24	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca	R\$ 2,25	R\$ 67,50		
25	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 – Broca			R\$ 3,90	R\$ 117,00
26	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 – Broca			R\$ 3,90	R\$ 117,00
27	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034 – Broca			R\$ 3,90	R\$ 117,00
28	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
29	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF – Broca			R\$ 4,90	R\$ 147,00
30	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F – Broca			R\$ 18,39	R\$ 551,70
31	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F – Broca			R\$ 18,39	R\$ 551,70
32	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
33	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
34	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312 – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
35	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
36	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
37	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
38	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F – Broca			R\$ 20,90	R\$ 627,00
39	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
40	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
41	30	UND	BROCAS ZÉCRYA HL - Broca do tipo Zécrya número			R\$ 27,99	R\$ 839,70
42	15	UND	BLOCO PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO			R\$ 9,90	R\$ 148,50
43	30	PCT	CANUDO DESCARTAVEL EM PP, DIAM. 5,5 mm,			R\$ 3,27	R\$ 98,10
44	30	UND	CARIOSTÁTICO 30 % – Solução de diamino fluoreto	R\$ 20,16	R\$ 604,80		
45	5	UND	CIMENTO CIRÚRGICO – sem eugenol produzido	R\$ 114,00	R\$ 570,00		
46	15	UND	CIMENTO PROVISÓRIO ENDODÔNTICO COM	R\$ 22,91	R\$ 343,65		
47	6	UND	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ.	R\$ 21,53	R\$ 129,18		
48	6	UND	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO –	R\$ 7,32	R\$ 43,92		
49	150	LT	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO,	R\$ 20,86	R\$ 3.129,00		
50	20	UND	CLOREXIDINA 2% - Antisséptico com atividade	R\$ 3,84	R\$ 76,80		
51	20	UND	COLETOR PARA MATERIAL	R\$ 3,85	R\$ 77,00		
52	6000	UND	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL -	R\$ 0,52	R\$ 3.120,00		
53	200	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS,	R\$ 14,41	R\$ 2.882,00		
54	60	UND	CONDICIONADOR DENTAL GEL - Gel à base de	R\$ 3,61	R\$ 216,60		
55	10	KIT	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMOCA DE			R\$ 54,90	R\$ 549,00
56	15	UND	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM	R\$ 7,67	R\$ 115,05		
57	100	UND	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora	R\$ 17,30	R\$ 1.730,00		

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AA9-58F6

58	30	UND	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,	R\$ 4,50	R\$ 135,00		
59	200	UND	ESCOVA ROBSON, PEQUENA, CERDA PLANA,			R\$ 3,09	R\$ 618,00
60	20	UND	ESPATULA PARA ODONTO PLÁSTICA,			R\$ 2,10	R\$ 42,00
61	100	UND	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO	R\$ 2,45	R\$ 245,00		
62	10	UND	ESPELHO TOUCADOR COM CABO, FORMATO			R\$ 28,90	R\$ 289,00
63	20	CX	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO	R\$ 40,49	R\$ 809,80		
64	40	UND	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	R\$ 6,54	R\$ 261,60		
65	50	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON,	R\$ 34,80	R\$ 1.740,00		
66	20	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON,	R\$ 34,50	R\$ 690,00		
67	30	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON,	R\$ 36,40	R\$ 1.092,00		
68	10	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA SEDA, NÚMERO	R\$ 36,25	R\$ 362,50		
69	20	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON,	R\$ 34,80	R\$ 696,00		
70	40	UND	FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui	R\$ 10,25	R\$ 410,00		
71	5	UND	FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, N°. 00,	R\$ 14,04	R\$ 70,20		
72	3	CX	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4			R\$ 208,99	R\$ 626,97
73	40	UND	FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA	R\$ 3,90	R\$ 156,00		
74	60	FR	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% -	R\$ 4,32	R\$ 259,20		
75	10	UND	FORMOCRESOL, SOLUÇÃO - Formula BUCKLEY,	R\$ 4,92	R\$ 49,20		
76	50	PCT	GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL	R\$ 10,00	R\$ 500,00		
77	6	UND	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO – Indicações: indicado	R\$ 12,89	R\$ 77,34		
78	15	UND	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - Indicação capeador	R\$ 4,37	R\$ 65,55		
79	100	LT	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%- Bactericida,	R\$ 2,73	R\$ 273,00		
80	20	CX	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo	R\$ 24,00	R\$ 480,00		
81	1	CX	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5,			R\$ 224,91	R\$ 224,91
82	20	UND	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso	R\$ 22,82	R\$ 456,40		
83	80	KIT	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE			R\$ 139,90	R\$ 11.192,00
84	80	KIT	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	R\$ 28,90	R\$ 2.312,00		
85	20	KIT	KIT REVELADOR E FIXADOR PARA FILME	R\$ 18,42	R\$ 368,40		
86	2	CX	LÂMINA DE BISTURÍ N°12 – Lâminas em aço carbono	R\$ 24,12	R\$ 48,24		
87	2	CX	LÂMINA DE BISTURÍ N°15 – Lâminas em aço carbono	R\$ 24,12	R\$ 48,24		
88	1000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5-	R\$ 1,05	R\$ 1.050,00		
89	1000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 -	R\$ 1,05	R\$ 1.050,00		
90	3000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5	R\$ 1,05	R\$ 3.150,00		
91	100	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX	R\$ 27,03	R\$ 2.703,00		
92	150	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO	R\$ 24,91	R\$ 3.736,50		
93	200	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M -	R\$ 24,82	R\$ 4.964,00		
94	500	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P -	R\$ 24,82	R\$ 12.410,00		
95	15	UND	MANDRIL ODONTOLÓGICO, AÇO INOX,	R\$ 30,90	R\$ 463,50		
96	20	PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO			R\$ 11,90	R\$ 238,00
97	20	PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO			R\$ 14,00	R\$ 280,00
98	20	PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO			R\$ 16,90	R\$ 338,00
99	30	UND	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm - Matriz	R\$ 1,08	R\$ 32,40		
100	30	UND	MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm – Matriz de	R\$ 1,26	R\$ 37,80		
101	10	KIT	MATRIZ SECCIONAL PRE CONTORNADA - Kit			R\$ 79,90	R\$ 799,00
102	8	UND	MEDICAÇÃO OCLUSIVA; PASTA PARA	R\$ 29,85	R\$ 238,80		
103	5	CX	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS SORTIDAS PARA			R\$ 110,50	R\$ 552,50
104	40	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA	R\$ 16,25	R\$ 650,00		
105	30	UND	PAPACÁRIE DUO GEL – Apresentação: seringa com 1			R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
106	50	UND	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA	R\$ 4,62	R\$ 231,00		
107	30	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx100m - Composto	R\$ 42,63	R\$ 1.278,90		
108	15	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25cm x 100m- composto	R\$ 110,00	R\$ 1.650,00		
109	30	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100m- composto	R\$ 23,63	R\$ 708,90		
110	20	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m --	R\$ 118,00	R\$ 2.360,00		
111	50	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m- composto	R\$ 34,89	R\$ 1.744,50		
112	15	UND	PARAMONOCLOROFENOL - material para	R\$ 6,84	R\$ 102,60		
113	25	UND	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Indicado para	R\$ 19,09	R\$ 477,25		
114	50	UND	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para	R\$ 4,53	R\$ 226,50		
115	5	UND	PEDRA DE AFIAR DE ARKANSAS,			R\$ 272,99	R\$ 1.364,95
116	20	CX	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL	R\$ 8,04	R\$ 160,80		
117	30	CX	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR	R\$ 8,04	R\$ 241,20		
118	6	UND	PORTA AMALGAMA ADULTO DE PLÁSTICO			R\$ 10,82	R\$ 64,92
119	5	KIT	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA	R\$ 47,40	R\$ 237,00		
120	30	UND	POTE DAPPEN, PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL –	R\$ 2,19	R\$ 65,70		
121	20	UND	POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO	R\$ 2,52	R\$ 50,40		

122	30	UND	PRENDEDOR DE GUARDANAPO DE METAL			R\$ 9,90	R\$ 297,00
123	10	UND	RESINA COMPOSTA COR A1 - Z100	R\$ 34,21	R\$ 342,10		
124	30	UND	RESINA COMPOSTA COR A2 Z100	R\$ 34,21	R\$ 1.026,30		
125	15	UND	RESINA COMPOSTA COR A3 Z100	R\$ 34,21	R\$ 513,15		
126	15	UND	RESINA COMPOSTA A 3,5 Z 100	R\$ 34,21	R\$ 513,15		
127	15	UND	RESINA COMPOSTA A2 Z250	R\$ 52,13	R\$ 781,95		
128	15	UND	RESINA COMPOSTA A3 Z250	R\$ 52,13	R\$ 781,95		
129	6	UND	RESINA COMPOSTA COR OA2 - Resina composta	R\$ 34,21	R\$ 205,26		
130	6	UND	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta	R\$ 34,21	R\$ 205,26		
131	15	UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW	R\$ 10,60	R\$ 159,00		
132	15	UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW	R\$ 13,50	R\$ 202,50		
133	5	UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW	R\$ 24,00	R\$ 120,00		
134	6	KIT	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO	R\$ 16,05	R\$ 96,30		
135	500	UND	ROLETE DE ALGODÃO –com 100% de fibras de	R\$ 2,08	R\$ 1.040,00		
136	300	RL	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO-com fibra 100%	R\$ 13,05	R\$ 3.915,00		
137	100	PCT	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL,			R\$ 2,19	R\$ 219,00
138	100	PCT	SACO PLASTICO LEITOSO 17x17cm, TIPO PARA			R\$ 5,00	R\$ 500,00
139	5	KIT	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS –	R\$ 69,20	R\$ 346,00		
140	20	UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-	R\$ 64,53	R\$ 1.290,60		
141	20	UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-	R\$ 64,53	R\$ 1.290,60		
142	20	UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-	R\$ 64,53	R\$ 1.290,60		
143	200	UND	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDRIGÊNIO 3% -			R\$ 2,29	R\$ 458,00
144	5	UND	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA – Especificação	R\$ 12,66	R\$ 63,30		
145	200	PCT	SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM	R\$ 7,10	R\$ 1.420,00		
146	50	UND	TIRA DE LIXA DE AÇO – Indicada para dar	R\$ 4,56	R\$ 228,00		
147	50	UND	TIRA DE LIXA DE AÇO – Indicada para dar	R\$ 4,56	R\$ 228,00		
148	15	CX	TIRA DE LIXA DE POLIESTER SOF-LEX	R\$ 42,55	R\$ 638,25		
149	100	PCT	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM	R\$ 9,32	R\$ 932,00		
150	6	UND	TRICRESOL - Tricresol formalina, indicado para casos	R\$ 5,00	R\$ 30,00		
151	10	UND	VASELINA SÓLIDA- Indicada como emoliente; mistura	R\$ 7,66	R\$ 76,60		
152	15	BIS	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz de flúor para uso			R\$ 187,99	R\$ 2.819,85
Total :				R\$ 114.095,59		R\$ 41.171,85	
Total Geral : R\$ 155.267,44							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 1/14

JL SOFT      RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico      Sequência: 64/2023      Data Início: 14/08/2023      Ata: 55/2023  
Processo/Ano: 552/2023      Data da Licitação: 18/07/2023      Data Fim: 14/08/2024

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0001	42.02462	ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA - em pontas de silicone flexíveis ;impregnadas com óxido de alumínio, não produzindo calor excessivo; caixa com 7 pontas sortidas {3 chama de vela, 2 taças e 2 discos }. Composição de tri polímero {estireno Butadieno-Metacrilato de Metila} Sílica Pirolítica Silanizada, Uretano Dimetanolamina e óxido de alumínio .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	50,6300	10,0000	506,3000
0002	42.02463	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL -Sistema de adesivo de frasco único, utilizado para reparos em porcelana, em resinas, restauração em amálgama adesivo, dessensibilização de raízes expostas, primer e adesivo e um só frasco, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, menor espessura de película, sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	90,8900	45,0000	4.090,0550
0003	42.02464	Almotolia plástica branca, bico reto, com tampa presa ao bico, capacidade de 500 ml, graduada na lateral, autoclavável.	UND	3,8400	40,0000	153,6000
0004	42.02465	ÁGUA DEIONIZADA –quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5l.validade mínima de 2 anos da data de entrega.	GL	8,8000	0,0000	0,0000
0005	42.02466	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA- Agulha gengival longa em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.	CX	30,2500	5,0000	151,2500
0006	42.02467	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - Agulha gengival curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	30,2400	45,0000	1.360,8000
0007	42.02468	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA - Agulha Gengival 30G extra curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médico, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	30,2400	15,0000	453,6000
0008	42.02469	ALCOOL ETILÍCO 92,8 IGPM (CATEGORIA COMERCIAL) - FRASCO COM 1 LITRO - Liquido; com teor de no mínimo 92,8 IGPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rotulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Com registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	L	6,7900	0,0000	0,0000

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1docsig.com.br/verificacao



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 2/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0009	42.02470	ALCOOL ETILÍCO A 70 % PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES – FRASCO COM 1 LITRO – Indicado para desinfecção de superfícies e artigos semi e não críticos; frasco de 1 litro, contendo dados de identificação, nº de lote, validade e responsável técnico; em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera atender a legislação atual vigente. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	L	5,2800	500,0000	2.640,00
0010	42.02471	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) +Epinefina 10 µg /mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, cada embalagem contém 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	92,3000	0,0000	0,00
0011	42.02472	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML - Anestésico local injetável, a base de lidocaína a 3% e norepinefrina, tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as normas de procedimentos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	115,7600	15,0000	1.736,40
0012	42.02473	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2 % SEM VASOCONSTRITOR - Tubetes com 1.8 ml, embalados em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	237,6000	5,0000	1.188,00
0013	42.02474	ANESTÉSICO TÓPICO GEL - Frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel, benzocaina a 20%, hidrossolúvel, em pote, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	13,0000	20,0000	260,00
0014	42.02475	BABADOR DESCARTÁVEL - Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável; folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico; maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades.	UND	13,9000	50,0000	695,00
0015	42.02476	BICARBONATO DE SÓDIO Bicarbonato de sódio odontológico; pó extrafino para polimento e profilaxia dental, pureza (99,6%), sem aroma, sem corantes; em frasco plástico; acondicionados em pote de 250g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, o produto deverá obedecer a legislação vigente; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	9,9900	10,0000	99,90
0016	42.02477	Bisturi descartável nº 22, composto por um cabo plástico resistente, com lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	0,4400	0,0000	0,00
0017	42.02478	Bisturi descartável nº 11, composto por um cabo plástico resistente, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	0,4400	0,0000	0,00
0018	42.02479	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1400	20,0000	42,80

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1000brasil.com.br/verificacao/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 3/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0019	42.02480	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1400	20,0000	42,8000
0020	42.02481	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,2500	20,0000	45,0000
0022	42.02483	CARIOSTÁTICO – Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos proteicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	20,1600	15,0000	302,4000
0023	42.02484	CIMENTO CIRÚRGICO – sem eugenol produzido através da mistura de seus componentes, ótima textura e plasticidade após a presa. Produto de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol e cera natural. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido de zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol e BHT. Validade mínima: 2 anos da data de entrega.	UND	114,0000	4,0000	456,0000
0024	42.02485	CIMENTO PROVISÓRIO ENDODÔNTICO COM IODOFORMIO - Material temporário para obturação de canal radicular; com Iodofórmio que confere a pasta propriedade anti-infecciosa e intensa radiopacidade; pasta de Hidróxido de Cálcio pronta para o uso; de fácil aplicação; ação anti-bacteriana; que induz a formação de dentina reparadora; com consistência ideal para escoamento no canal radicular; apresentação: 1 seringa de 2,5g e 3 bicos aplicadores. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.	UND	22,9100	5,0000	114,5500
0025	42.02486	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ. (10ml) - Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de oxido de zinco com até 10% de oxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por ácido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	21,5300	6,0000	129,1800
0026	42.02487	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO benefícios massa de Fácil manipulação; Endurecimento rápido; Menor microinfiltração marginal. Características Obturador provisório normal. Aplicação: indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega APRESENTAÇÃO: Embalagem c/ 25g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	7,3200	4,0000	29,2800
0027	42.02488	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO, EMBALAGEM DE 1 LITRO – Solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de corthexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo aspecto pronto para o uso. Embalagem contendo 1 litro. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	L	20,8600	90,0000	1.877,4000



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matheusperes.com.br/verificacao/24CC-C1B8-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B8-AAA9-58F6

## ID: bruna.morelli 59

## Exercício: 2024

Página: 4/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0028	42.02489	CLOREXIDINA 2%- Antisséptico com atividade antibacteriana, com eficácias para gram-negativas, fungos leveduras e alguns dermatófilos. Composição- digluconato de clorhexidina 2%, metilparabeno, água deionizada. (livre de álcool etílico) Frascos com 100ml. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.	UND	3,8400	10,0000	38,4000
0029	42.02490	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTE Capacidade para 05 litros, para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc. Alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853.	UND	3,8500	10,0000	38,5000
0030	42.02491	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL ,com 13 fios, 7,5x7,5 cm ; em 100% de viscose branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado ; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras ;medindo 7,5cm x 7,5 cm; com formato quadrado ;estéril ;embalado com 10 unidades cada, embalado em material que garante a integridade do produto ;o produto deverá ser entregue com laudo analítico e laudo analítico laboratorial , de cumprimento da NBR 13843.validade mínima de 3 anos da data de entrega.	UND	0,5200	0,0000	0,5200
0031	42.02492	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5x7,5 cm, NAO ESTÉRIL, PACOTE C/500 UND – Compressa de gaze hidrófila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 5 dobras, 8 camadas, sem filamento radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 cm; com formato quadrado; não estéril; embalado em pacote com 500 unidades que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 anos da data de entrega	PCT	14,4100	0,0000	0,0000
0032	42.02493	CONDICIONADOR DENTAL GEL - Gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, espessado com Sílica Coloidal. Composição: Ácido Fosfórico, Sílica Coloidal, Surfactante e Corante. Embalagem com 3 seringas de 3 ml e 3 ponteiros p/ aplicação. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	3,6100	20,0000	72,2000
0033	42.02494	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM FLUORETO DE SÓDIO 2% E NITRATO DE POTÁSSIO, SER. 2,5g – Gel de baixa viscosidade dessensibilizante oclusivo à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2% que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	7,6700	7,0000	53,6900
0034	42.02495	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carboidrase); sendo as principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; específico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	UND	17,3000	76,0000	1.312,8000
0035	42.02496	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, (tipo de unha) – Para uso na limpeza de artigos de pequeno e médio porte. Descrição: Escova plástica para limpeza delicada, cor sortida. Dimensões: 9.5 x 2.5 cm	UND	4,5000	0,0000	0,0000
0036	42.02497	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX - Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos, passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto, embalado individualmente, marca comercial, procedência de fabricação.	UND	2,4500	0,0000	0,0000

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 5/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0037	42.02498	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UNID.- tamanho 1x1x1 cm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	CX	40,4900	20,0000	809,80
0038	42.02499	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA SOLUÇÃO , frasco C/10 ml. Evidenciador de placa bacteriana em solução, em frasco c/10 ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima 2 anos a partir da data	UND	6,5400	15,0000	98,10
0039	42.02500	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 mono filamento preto, agulha 3/8 Circ –CT 20 mm- fio agulha de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 2,0 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.	CX	34,8000	30,0000	1.044,00
0040	42.02501	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 monofilamento preto, agulha 3/8 Circ –CT 15 mm- fio agulha de sutura nylon monofilamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.	CX	34,4500	20,0000	689,00
0041	42.02502	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 4-0, mono filamento preto, agulha 3/8 Circ. – CT 15 mm - Fio agulhado de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 4-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	36,4000	0,0000	0,00
0042	42.02503	FIO AGULHADO PARA SUTURA SEDA, NÚMERO 4-0, Fio de Sutura de Seda Preta. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm.Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.* Esterilizado em Raio Gama.As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Uso exclusivo em Odontologia.Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.	CX	36,2500	0,0000	0,00
0043	42.02504	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 5-0, AGULHA 3/8 Cir. - Fio de sutura de nylon obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.5-0, preto trançado, agulhado -3/8 circ. triangular, CT 1,5cm, fio medindo 45 cm, uso odontológico, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ter comprovação de sua esterilidade, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	34,8000	20,0000	696,00
0044	42.02505	FIO DENTAL FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10,2500	10,0000	102,50
0045	42.02506	FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, Nº. 00, CORDÃO TRANÇADO MALEÁVEL, NÃO IMPREGNADO - Fio para retração gengival; composto por cordão trançado e maleável 100% algodão, não impregnado por substancia química, n. 00; embalado em frasco com 240 cm aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 02 ano da data de entrega.	UND	14,0400	5,0000	70,20

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/24CC-C1B3-9AA9-58F6 e informe o código 1B3-AA9-58F6





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 6/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0046	42.02507	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4 cm. Filme para radiografia periapical para adulto, 3 x 4cm, compatível com processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	172,8000	2,0000	345,6000
0047	42.02508	FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe1(ISO11140-1). Apresentações: Medidas – 19mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	3,9000	10,0000	39,0000
0048	42.02509	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	FR	4,3200	50,0000	216,0000
0049	42.02510	FORMOCRESOL, SOLUÇÃO - Formula BUCKLEY, frasco c/10 ml em solução, composição formula buckley, em frasco com 10 ml, embalado individualmente, constando externamente procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4,9200	7,0000	34,4400
0050	42.02511	GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL EM TNT POLIPROPILENO – Gorro cirúrgico descartável; em não tecido polipropileno, gramatura 50, branco, hipoalergenico, atóxico; com elástico na parte posterior; com formato anatômico; que permita ventilação adequada; embalagem com em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Contendo 10 unidades em cada pacote.	PCT	10,0000	30,0000	300,0000
0051	42.02512	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – Atóxico 100% polipropileno, gramatura 20 colorido não estéril, diâmetro: 50 x 50 não inflamável, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 3 anos da data de entrega	PCT	9,3200	0,0000	0,0000
0052	42.02513	HEMOSTÁTICO LIQUIDO – indicações: indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restaurações, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Composição: Álcoois, cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoloina e água purificada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	12,8900	5,0000	64,4500
0053	42.02514	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - Indicação capeador pulpar, material para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Propriedades: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões;evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de Hidróxido de Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4,3700	12,0000	52,4400
0054	42.02515	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - Bactericida, desinfectante ,ação química de solvente de tecidos, antisséptico, característica físico química de baixa tensão superficial ,embalagem contendo 1000 ml. Validade mínima 2 anos da data de entrega.	L	2,7300	0,0000	0,0000

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao>



## ID: bruna.morelli 59

## Exercício: 2024

Página: 7/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0055	42.02516	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	CX	24,0000	5,0000	120,0000
0056	42.02517	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	22,8200	0,0000	0,0000
0057	42.02518	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão do esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Ionômero pó (10g), composto de Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de Bário, Ácido Poliacrílico. Pigmentos, composição do líquido: Ácido Tartárico e Água Destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	28,9000	35,0000	1.011,5000
0058	42.02519	KIT REVELADOR E FIXADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO – REVELADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfeto de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. FIXADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiossulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Ambos deverão ser da mesma marca comercial.	KIT	18,4200	0,0000	0,0000
0059	42.02520	LÂMINA DE BISTURÍ Nº12 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	24,1200	1,0000	24,1200
0060	42.02521	LÂMINA DE BISTURÍ Nº15 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	24,1200	1,0000	24,1200
0061	42.02522	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas , oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.	PAR	1,0500	400,0000	420,0000
0062	42.02523	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.	PAR	1,0500	0,0000	0,0000
0063	42.02524	LUVA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5 Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.	PAR	1,0500	900,0000	945,0000

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA



## ID: bruna.morelli 59

## Exercício: 2024

Página: 8/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0064	42.02525	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO M - Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante. Microtexturizada. Ação Antiderrapante. Totalmente isenta de pó. Hipoalergênica. Ambidestra. Embalagem: 100 Unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	27,0375	0,0000	0,00
0065	42.02526	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não esteril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega	CX	24,9109	0,0000	0,00
0066	42.02527	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não esteril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	24,8273	200,0000	4.965,46
0067	42.02528	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não esteril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	24,8273	0,0000	0,00
0068	42.02529	MANDRIL ODONTOLÓGICO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, PARA ENCAIXE DE DISCOS POP-ON- Para polimento e acabamento de restaurações, adaptação em contra- ângulo, com haste de 15mm de comprimento; embalagem individual que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	UND	30,9000	0,0000	0,00
0069	42.02530	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm - Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 nos da data de entrega.	UND	1,0800	0,0000	0,00
0070	42.02531	MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm – Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	1,2600	30,0000	37,80
0071	42.02532	MEDICAÇÃO OCLUSIVA; PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE - Medicação oclusiva; pasta para tratamento de alveolite composta basicamente por: Lidocaína, Eugenol, Laurilsulfato de sódio, Carbonato de cálcio, Penghawar djambi, Azeite, Água purificada e Aroma natural de hortelã; Composição do aroma natural de hortelã: mistura de óleo essencial de hortelã-verde e de óleo essencial de eucalipto; exclusivamente para uso tópico; embalada em frasco de 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 18 meses da data da entrega.	UND	29,8500	5,0000	149,25
0072	42.02533	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO – Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	16,2500	15,0000	243,75
0073	42.02534	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE AZUL E VERMELHO utilizado para marcação de pontos oclusais possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais que atinja anatomicamente os pontos oclusais. Possui folhas especiais 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelha e 100 micras de espessura. Embalagem com 10 folhas -25mm x 97 mm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4,6200	15,0000	69,30

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjati.1doc.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 9/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0074	42.02535	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx100m - Composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxicidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	42,6300	20,0000	852,6000
0075	42.02536	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	110,0000	5,0000	550,0000
0076	42.02537	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	23,6300	0,0000	0,0000
0077	42.02538	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m -- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	118,0000	10,0000	1.180,0000
0078	42.02539	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	34,8900	10,0000	348,9000
0079	42.02540	PARAMONOCLOROFENOL -material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20ml . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	6,8400	10,0000	68,4000

Assinado por: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caja120.doc.com.br/verificaca>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 10/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0080	42.02541	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas + 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas + 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	19,0900	15,0000	286,35
0081	42.02542	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado Apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4,5300	30,0000	135,90
0082	42.02543	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO - Indicado para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90º, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	8,0400	10,0000	80,40
0083	42.02544	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR - Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90º, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	8,0400	10,0000	80,40
0084	42.02545	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO ADULTO - Kit com 4 peças sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis, utilizados para dentes anteriores e posteriores, esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.	KIT	47,4000	2,0000	94,80
0085	42.02546	POTE DAPPEN, PLASTICO, AUTOCLAVÁVEL – Pote Dappen; plástico; composto a base de nylon; com boa resistência; esterilizável em autoclave a 137°C; possuindo duas cavidades para as manipulações; Medindo: altura 3 cm, concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml, concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; possuindo 12 dimensões; embalagem Individual.	UND	2,1900	0,0000	0,00
0086	42.02547	POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO COLORIDO, AUTOCLAVÁVEL - Pote Dappen; de vidro temperado colorido, autoclavável; espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarba, com 2 concavidades e capacidade de 5ml e 2ml; para manipulação de materiais odontológicos; embalagem individual.	UND	2,5200	0,0000	0,00
0087	42.02548	RESINA COMPOSTA A 3,5 Z 100 FOTOPOLIMERIZÁVEL- Resina micro hibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	34,2100	2,0000	68,42

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://cajati.sp.gov.br/verificacao>





## ID: bruna.morelli 59

### Exercício: 2024

Página: 11/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/assinaturas>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 12/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0094	42.02555	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação: seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	36,1500	6,0000	216,9000
0095	42.02556	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A2 - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g na cor A2. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10,6000	7,0000	74,2000
0096	42.02557	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A3 - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g na cor A3. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	13,5000	4,0000	54,0000
0097	42.02558	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW OPACA - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: seringa com 2,4g na cor OPACA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	24,0000	3,0000	72,0000
0098	42.02559	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO TIPO II, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL-KIT PÓ 38g E LIQUIDO 15ml – Cimento de óxido de zinco uso odontológico; tipo II reforçado para restaurações temporárias de longa espera; apresentação kit pó e líquido; pó cor marfim em frasco com aproximadamente 38g; composto basicamente de óxido de zinco metacrilato de metila; líquido em frasco com aproximadamente 15ml; composto basicamente por eugenol 99,5%e ácido acético 0,5%; embalado individualmente kit pó, líquido, conta gotas + colher dosadora; constando externamente marca comercial e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	16,0500	4,0000	64,2000
0099	42.02560	ROLETES DE ALGODÃO – com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2,0800	200,0000	416,0000
0100	42.02561	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO - com fibra 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos; embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	13,0500	130,0000	1.696,5000
0103	42.02564	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS – Apresentação Kit contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação; fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	KIT	69,2000	3,0000	207,6000
0104	42.02565	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO FINA – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra- ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	64,5300	5,0000	322,6500



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.cajati.sp.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 13/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0105	42.02566	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO MÉDIA – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra- ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	64,5300	5,0000	322,65
0106	42.02567	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO GROSSA – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra- ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	64,5300	5,0000	322,65
0107	42.02568	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA –acondicionada em frasco com 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	12,6600	2,0000	25,32
0108	42.02569	SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM 40 UND - sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti- frutti colorido, rosa, verde ,transparente e azul; cada pacote contendo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	PCT	7,1000	100,0000	710,00
0109	42.02570	TIRA DE LIXA DE AÇO – indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 6 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 6 mm x 150mm.Embalagem individualmente ;constando Externamente Marca comercial, procedência de fabricação.	UND	4,5600	50,0000	228,00
0110	42.02571	TIRA DE LIXA DE AÇO – indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 4 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 4 mm x 150mm.Embalagem individualmente ;constando Externamente Marca comercial, procedência de fabricação.	UND	4,5600	50,0000	228,00
0111	42.02572	TIRA DE LIXA DE POLIESTER Sof –Lex- indicada para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Características : tamanho das tiras 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Tira possuindo um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies Inter proximais dos dentes. apresentação: caixa com 50 tiras .com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	42,5500	0,0000	0,00
0112	42.02573	TRICRESOL - Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96º e água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução. Embalagem com 50 tiras. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	5,0000	5,0000	25,00
0113	42.02574	VASELINA SÓLIDA - Indicada como emoliente; mistura de hidrocarbonetos parafinicos, naftênicos e aromáticos; auxilia no tratamento de rachaduras de pele, como umectante; tem efeito emoliente e melhora a elasticidade; embalagem com 1 pote de 90g. Validade de no mínimo 2 anos da data de entrega.	UND	7,6600	6,0000	45,96
0114	42.02575	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz; a base de resina natural ou sintética com 5% de fluoreto de sódio ou 2,26% de íon flúor; compatível com aplicação tópica de flúor; em frasco com 10 ml, com acessórios conforme o fabricante; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	25,2400	0,0000	0,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matriculaonline.org>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli  
Exercício: 2024  
Página: 14/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Valor Total: 40.233,48

CAJATI, 13 de Agosto de 2024.

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6>



A loja mais completa do  
Brasil!

Consulte **FRETE GRÁTIS\*** para **SUL** e **SUDESTE** acima de  
R\$450,00 (/faq/envio-e-frete/)

Até **6x** SEM juros  
(/faq/formas-de-  
pagamento/)

Entregas Nacionais



**MAGAZINE  
MÉDICA**.COM



Bem Vindo

Entre

(/accounts/registro/login/)

ou



cadastre-se

(/accounts/registro/login/)



Fale

conosco  
(/ajuda/)



0

O que você procura?



INICIAL (/) / DESCARTÁVEIS (/CATEGORIAS/DESCARTAVEIS/) / ABAIXADORES DE LÍNGUA (/CATEGORIAS/DESCARTAVEIS/ABAIXADORES-DE-LINGUA/) / ABAIXADOR DE LÍNGUA MODELO ANIMAL JUNIOR 40 UN TIC-TONG

# Abaixador de Língua Modelo Animal Junior 40 UN TIC-TONG

Cód.: 7353



(/marcas/tic-tong/)

★★★★★

De R\$ ~~41,18~~

**Por R\$ 34,43 à vista**

no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em **1x de R\$ 34,80** sem juros (4% de desc. já calculado)

**FORMAS DE PAGAMENTO**





Agosto com ➡ cashback ⬅ de até R\$ 100! Use ainda neste mês. ➡



Home > Instrumentais > Abridor De Boca > Abridor De Boca Abritec - Maquira



Abridor De Boca Abritec - Maquira

Embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Escolha a cor.  
Cod. de Referência: DC11372

★★★★★ (7)

A PARTIR DE 2 unidades, PAGUE R\$ 16,69 CADA.

Escolha uma opção \*

Escolha uma opção...

~~R\$20,90~~ 15% OFF

R\$17,79

—

1

+



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AA9-58F6 e informe o código 24CC-C1B3-AA9-58F6

Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: 43 3378 8300

Rastrear minha compra



o que procura hoje?



Precisa de ajuda?



Minha conta



Meu carrinho

USO  
GERAL

CIRURGIA E  
ESTERILIZAÇÃO

DENTÍSTICA E  
ESTÉTICA

ENDODONTIA

FOTOGRAFIA

RADIOLOGIA

POR  
ITEM

IMPLANTODONTIA

CATEGORIAS



VÍDEO



# ABRIDOR DE BOCA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRITEC PCD INDUSBELLO

DESTAQUE

0 OPINIÕES

**R\$ 236,68**

R\$ 227,21 à vista com desconto ou 3x de R\$ 78,89 Sem juros

[Mais informações](#)

1

COMPRA





## DESCRIÇÃO GERAL

é um produto que foi produzido em conjunto com a Dra. Andreia de Aquino Marsiglio, uma profissional que vive as adversidades do meio e nos auxiliou na produção desse produto inovador que vem fazendo a diferença na rotina dos profissionais da área odontológica

### ABRITEC PcD

Abridor de boca indicado para uso em Pessoas com Deficiências.

**Agosto com ➡ cashback ⬅ de até R\$ 100!** Use ainda neste mês. ➡[Home](#) > [Prevenção e Profilaxia](#) > [Pedra Pomes](#) > Pedra Pomes Extra Fina - Maquira

1/3



## Pedra Pomes Extra Fina - Maquira

Embalagem com 1 unidade de 100g.

Cod. de Referência: 384765

★★★★★ (2)

A PARTIR DE 2 unidades, PAGUE  
R\$ 12,69 CADA.~~R\$15,90~~ 15% OFF**R\$13,49**

— 1 +

**Adicionar ao Carrinho**

+Adicionar a lista de desejos✓

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Calcular****Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.**Formas de pagamento** ▼**Detalhes** ^

1Doc: Memorando 10- 11.395/2024 112/6450



🔍 Pesquise por produtos ou marcas

## Kit para Acabamento e Polimento de Resina

### 🏠 > Enhance Sortida CA com 07 unidades - Dentsply



Cód 187020003

(0)

**R\$ 149,90**

3% de desconto no boleto à vista

1 x R\$ 149,90 sem juros



Resgate por 12000 pontos  
no **Surya Club**

Quantidade



1





seus favoritos com até **50% off**

Aproveite

[Laboratório](#)[Universitários](#)[Home](#) > [Prótese Clínica](#) > [Ponta Diamantada](#) > Ponta Diamantada Esférica FG - AllPrime

## Ponta Diamantada Esférica FG - AllPrime

Embalagem com 1 unidade

Cod. de Referência: ALP913

Cód Fabricante: 101101013

★★★★★ (2)

### Escolha uma opção

1013

~~R\$5,90~~ 32% OFF**R\$3,99**

— 1

**Adicionar ao Carrinho**

Adicionar a lista de desejos

### Calcular frete e prazo




A previsão de entrega inicial é de 10 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Mais Speed.** ganhar muitas vantagens

1Doc: Memorando 10- 11.395/2024 114/6450

DentalMaster > Materiais de Consumo > Brocas Diamantadas

CÔNICA INVERTIDA/DUPLO	CÓD.	ISO/FIG.	Ø	L <sup>1</sup>	L <sup>2</sup>	Granulometria	
	1153	225/807	016	4.0	16.5		
	1031	010/805	009	0.9	19		
	1032	010/805	010	1.0	19		
	1033	010/805	012	1.0	19		  
	1034	010/805	014	1.0	19		  
	1035	010/805	016	1.6	19		  
	1036	010/805	018	1.8	19		  

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6





PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA

Cód. 16012 | Marca: Microdont

1153

AVISE-ME

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

OK



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



AVISE-ME

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

OK

1032

Por: **R\$ 3,90**

-

1

+

ADICIONAR AO CARRINHO

1033

 Compra 100% segura

AVISE-ME

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

OK

1034

AVISE-ME

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

OK





🔍 Pesquise por produtos ou marcas

📌   👤 Entrar   🛒

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

🔍 Pesquise por caracte



~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

	Ponta Diamantada FG N° 1016HL - Microdont Cód 047026001	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1
	Ponta Diamantada FG N° 1111 - Microdont Cód 047026002	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1
	Ponta Diamantada FG N° 1111F - Microdont Cód 047026003	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1
	Ponta Diamantada FG N° 1112 - Microdont Cód 047026004	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1
	Ponta Diamantada FG N° 1112F - Microdont Cód 047026005	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1

Ver mais variações   Mais informações

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caja.11doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6>



Agosto com ➡ cashback ⬅ de até **R\$ 100!** Use ainda neste mês. ➡



[Home](#) > [Brocas](#) > [Broca Diamantada](#) > Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - Fava

1/2



## Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - Fava

Embalagem com 1 unidade. FG (alta rotação). Escolha o modelo.

Cod. de Referência: DC11434H




**Escolha uma opção \***

Escolha uma opção...

**R\$4,90**





—

1

+

Adicionar ao Carrinho

+

Adicionar a lista de desejos

▼

Calcular frete e prazo

Digite o CEP

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Calcular

- Lovers. Acumule e troque por benefícios exclusivos.
- Frete Grátis. Em compras acima de R\$ 200.
- Troca Grátis. Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento

▼

Detalhes

^

## Broca Diamantada Ponta Cônica

- Haste fabricada em aço inoxidável.
- Ponta diamantada com formato cônico extremidade em chama.
- Feita em diferentes granulações:  
Ultrafina (FF) Amarelo - 20µm.  
Fina (F) Vermelho - 40µm.  
Média (ø) Cinza - 100µm.  
Grossa (G) Verde - 125µm.
- Ponta diamantada para alta rotação (FG).
- Validade: indeterminada.
- Registro ANVISA: 81629170009.

## Nível de Rotação

A rotação varia conforme o diâmetro da parte ativa da broca:

- ISO 0,09mm - rotação 450,000.
- ISO 0,25mm - rotação 300,000.

## Dimensões das Brocas Fava (comprimento total - parte ativa)

- 1112: 19mm – 5,0mm.
- 1112F: 19mm – 5,0mm.
- 1112FF: 19mm – 5,0mm.
- 1112G: 19mm – 5,0mm.
- 1190: 19mm – 3,2mm.



- 1190F: 19mm – 3,2mm.
- 1190FF: 19mm – 3,2mm.
- 1191F: 19mm – 1,0mm.
- 2112: 19mm – 6,0mm.
- 2137F: 19mm – 1,0mm.
- 2191: 24mm – 1,0mm.
- 2200: 21mm – 10,0mm.
- 2200F: 21mm – 7,0mm.
- 2200FF: 21mm – 7,0mm.
- 3113: 20mm – 8,0mm.
- 3113FF: 20mm – 8,0mm.
- 3138: 19mm – 1,0mm.
- 3138F: 19mm – 1,0mm.
- 3193: 24mm – 8,0mm.
- 3193F: 24mm – 8,0mm.
- 3195: 24mm – 1,0mm.
- 3195F: 24mm – 10mm.
- 3195FF: 24mm – 10,0mm.
- 3200: 24mm – 10,0mm.
- 3203: 24mm – 10,0mm.
- 3203F: 24mm – 10,0mm.
- 3205: 24mm – 10,0mm.
- 4114: 22mm – 10,0mm.



**URGENTE :::: Solicitação de cotação - BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO**

Gestão Saúde Cajati &lt;gestaosaudecajati@gmail.com&gt;

13 de agosto de 2024 às 10:47

Cco: licitacao01@cralab.com.br, distribuidorasupermed@outlook.com, sysma@sysmasolucoes.com.br, licitacao@distrimedica.com.br, medmaia16@gmail.com, licitacao@cmfdistribuidora.com.br, licitacao@panoramamed.com.br, licitacao@jgpharma.com.br, dental@dentalcentrosul.com.br, ybpcomercial@gmail.com, licitach3negocios@gmail.com, licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com, dimecedro@yahoo.com.br, licitacao@prohospital.com.br, licitacao2@fprinter.com.br, doc.pharmaplus@hotmail.com, licitacao2@licitacoes.londrina.br, licitacao@evencomercial.com.br, financeiro.odg@hotmail.com, licitacao@gtgroup.net.br, pregaoeletronico.erimed@outlook.com, licita@forlabexpress.com.br, drogariacasanova@gmail.com, ppf-innova@live.com, licitacao2@renylab.ind.br, pglima.lic@gmail.com, licitacao.ipo@gmail.com, miamimedlicita@gmail.com, financeiro@solutemedical.com.br, dfmedical10@gmail.com, dauana.silva@maquira.com.br, dismathdistribuidora@gmail.com, diagnosticacomercial2@gmail.com, cpm0308@gmail.com, edilberto.brabo@biomedica.bio.br, prscgoiania@gmail.com, costadistribuidora2024@gmail.com, licitacao@ebram.com, mjdistribuidora@gmail.com, licitacao@novamed-saude.com, a2xrcomercial@outlook.com, geison\_guimaraes@outlook.com, tcjm@tcjmimport.com, sabrina@dipromfarma.com.br, licitacao.hospitalar@maquira.com.br, jhmaquinaspr@hotmail.com, distribuidorakmmmedical@gmail.com, 3tprodutosuniversal@gmail.com, PEROLA IMPORTADORA <perolaimportadora@gmail.com>, brumedadm@gmail.com, lokamed@outlook.com, ursaltda@gmail.com, originalbandeiras@gmail.com, inovacoes.licitacoes@outlook.com, fusao.licita@hotmail.com, calulicacoes@gmail.com, licitacao@dentalprimecwb.com.br, licitacao@hiperdental.com.br, licitacao@hcgroudpobrasil.com, licitacao@athenaprodutos.com.br, olimpoequipamentos@gmail.com, licitacao@higix.com.br, licitacao@dentaxodonto.com.br, prepara.negocios@gmail.com, editais@poluxcomercial.com.br, ynemed.saude@gmail.com, cirurgicabiomedica@hotmail.com, licitacoes@altermed.com.br, licitacaovl@gmail.com, contrato.02@majlab.com.br, licita@equipsul.com, saopaulohospitalar@gmail.com, licita@dldental.com.br, camilaprodosimo@hotmail.com, licitacao2@emigeodonto.com.br, gm.distribuidorabr@gmail.com, diabeticos.epp@hotmail.com, multifarmaltda@gmail.com, odontomedicontratos@outlook.com, omar.mourad@primemedhospitalar.com.br, copaulista@live.com, comercial@erdobrasil.com.br

Prezado(s),  
Bom dia!

Solicito, gentilmente, cotação de preços para **Aquisição de brocas de alta rotação** para uso do Centro Odontológico do município, conforme segue:

\* **30 UND** : BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

\* **30 UND** : BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

**Aguardo retorno o mais breve possível.**

Atenciosamente,

--

**Bruna Morelli R. Pereira**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
Prefeitura Municipal de Cajati/SP  
CNPJ 64.037.815/0001-28  
Telefone: (13)3854-8500 | Ramal: 2156  
[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6





Gestão Saúde Cajati &lt;gestaosaudecajati@gmail.com&gt;

---

**Orçamento GM Distribuidora**

---

**Comercial2** <comercial2@gmdistribuidora.com.br>

13 de agosto de 2024 às 16:10

Para: "gestaosaudecajati@gmail.com" &lt;gestaosaudecajati@gmail.com&gt;

Boa Tarde !!!

Segue o Anexo do Orçamento Referente aos Produtos Odontológicos / Brocas de Rotação Sorensen.

Atendemos Também em nosso Portifólio, Produtos De Enfermagem, Odontológicos, Fisioterapêuticos, Clínicos e Equipamentos Médicos.

Demais Duvidas e Esclarecimentos Responderemos Via este E-mail ou Telefone / WhatsApp.

**José Henrique**

13/08/2024

**José Henrique**  
Auxiliar administrativo

17 99681-6379

f@/GM-DISTRIBUIDORASAUDE  
www.gmdistribuidora.com.br**Orçamento GM Distribuidora ao Municipio de Cajati - São Paulo.pdf**  
32601KAssinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



# GM Distribuidora

Materiais hospitalares, odontológicos  
fisioterapia e equipamentos para saúde

GM Distribuidora de Materiais Odontológicos, Médicos e Hospitalares  
CNPJ: 33.521.966/0001-23  
IE: 743.008.589.116  
Rua Martina Dias Fernandes, 31 Conjunto HBTC. Benedito Zancaner  
Telefone: 17 99681-6379 - 17 99686-1199  
comercial2@gmdistribuidora.com.br  
administracao@gmdistribuidora.com.br

**Prefeitura Municipal de Cajati - São Paulo**  
Centro Odontológico do município  
**Orçamento para Aquisição de brocas de alta rotação**

Lote	DESCRIÇÃO	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
1	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F	Unidade	Sorensen	30	R\$ 18,39	R\$ 551,70
2	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F	Unidade	Sorensen	30	R\$ 18,39	R\$ 551,70
Total						R\$ 1.103,40

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 Dias  
PRAZO DE ENTREGA: 07 Dias  
FATURAMENTO MINIMO : R\$ 200,00  
PRAZO DE PAGAMENTO : 30 Dias  
MARIANA PRUDENCIO DE AGUIAR  
CPF : 399.235.898-46  
RG : 46.248.095-1  
DADOS BANCARIOS DA PESSOA JURIDICA:  
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODNTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES  
BANCO: 001  
AGENCIA: 50 - 7  
CONTA: 590371

GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS  
MEDIC:3352196600123  
0123

Assinado de forma digital por GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS  
MEDIC:33521966000123  
Dados: 2024.08.13 16:08:32 -03'00'

**GM Distribuidora de Materiais Odontológicos, Medicos e Hospitalares**  
13 de Agosto de 2024  
Elisario / Sp

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



🔍

Pesquise por produtos ou marcas

Ponta diamantada para alta rotacao  
- Microdont

Cód 047026000 (0)



R\$ 7,39

Resgate por 450 pontos  
no **Surya Club**

R\$ 3,99

3% de desconto no boleto à vista

1 x R\$ 3,99 sem juros

Selecionar variações

🔍

1190

×

	<div>Ponta Diamantada FG N° 1190 - Microdont</div> <div>Cód 047026008</div>	<div>R\$ 3,99 R\$ 7,39</div> <div><div>—</div><div>1</div><div>+</div></div> <div>Adicionar</div>
	<div>Ponta Diamantada FG N° 1190F - Microdont</div> <div>Cód 047026009</div>	<div>R\$ 3,99 R\$ 7,39</div> <div><div>—</div><div>1</div><div>+</div></div> <div>Adicionar</div>
	<div>Ponta Diamantada FG N° 1190EF - Microdont</div> <div>Cód 047026046</div>	<div>R\$ 3,99 R\$ 7,39</div> <div><div>—</div><div>1</div><div>+</div></div> <div>Adicionar</div>

Mais informações

Avaliações do produto





Q Pesquise por produtos ou marcas

Entrar

Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya Club

> Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

Q 1312



R\$ 7,39   Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40



Ponta Diamantada FG N° 1312 - Microdont  
Cód 047026011

R\$ 3,99   R\$ 7,39  
- 1

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6 e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



SURYA DENTAL

Pesquise por produtos ou marcas

Categorias

Entrar

> Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000

(0)

Selecionar variações

1302

-46%



Ponta Diamantada FG N° 1302 - Microdont

Cód 047026010

R\$ 7,39

R\$ 3,99

3% de desconto no boleto à vista

1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Resgate por 450 pontos no Surya Club

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6

1Doc: Memorando 10- 11.395/2024

128/6450

[https://www.suryadental.com.br/ponta-diamantada-fg-microdont.html?gad\\_source=1&gclid=Cj0KCQjw5ea1BhC6ARIsAEOG5pwarprcdxSlhpQ\\_7...](https://www.suryadental.com.br/ponta-diamantada-fg-microdont.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw5ea1BhC6ARIsAEOG5pwarprcdxSlhpQ_7...)



Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ▾   🇧🇷

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya Club

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont   🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)


Selecionar variações   🔍 1342



~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   📄 Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

 Ponta Diamantada FG N° 1342 - Microdont  
Cód 047026012   R\$ 3,99 ~~R\$ 7,39~~  
— 1

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6





Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ⌵   🏠

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

Q 2135



Ponta Diamantada FG N° 2135EF - Microdont   R\$ 3,99 ~~R\$ 7,39~~  
Cód 047026057   —   1



Ponta Diamantada FG N° 2135F - Microdont  
Cód 047026058

~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   📄 Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6>



Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ⌵   🇧🇷

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

Q 311



Ponta Diamantada FG N° 3118F - Microdont  
Cód 047026044

~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6>

Agosto com  
de até **R\$ 100!**[Home](#) > [Brocas](#) > [Broca Diamantada](#) > Ponta Diamantada Chama FG - KG Sorensen

## Ponta Diamantada Chama FG - KG Sorensen

Unidade. Alta Rotação. Escolha a numeração.

Cod. de Referência: 376838

★★★★★ ( [avaliar!](#) )

### Escolha uma opção \*

3168F

**R\$20,90**

—

1

+

**Adicionar ao Carrinho**

+Adicionar a lista de desejos

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Calcular**



**Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.



**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.



**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

**Formas de pagamento**



**Detalhes**



1Doc: Memorando 10- 11.395/2024

132/6450





Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ⌵   🇧🇷

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

Q 3195



Ponta Diamantada FG N° 3195F - Microdont  
Cód 047026080

~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6>



Descrição

Espelho de mão para procedimentos clínicos.

- Espelho toucador com cabo.
- Disponível em diversas cores.
- 19,5cm de comprimento.

Espelho de Mão - Ortoguaru

Cód.: P28R|002169    Ortoguaru

UNIDADE. ESCOLHA A COR.

R\$ 28,90

ou 5% Desconto à vista no Boleto ou Pix

	AZUL	R\$ 28,90 /cada	<div>− 1 +</div>	Adicionar
	CRISTAL	R\$ 28,90 /cada	<div>− 1 +</div>	Adicionar
	ROSA	R\$ 28,90 /cada	<div>− 1 +</div>	Adicionar
	VERDE	R\$ 28,90 /cada	<div>− 1 +</div>	Adicionar
	LARANJA	R\$ 28,90 /cada	<div>− 1 +</div>	Adicionar

Quem Viu Comprou Também

				
Espelho de Mão com Glitter - Confort Odonto	Espéculo Hartmann Adulto 2 - Quinelato	Saca Prótese Pneumático Automático - BSZ	Espátula de Inserção de Fio Retrator Fischer Ultrapak Pequena -...	Gancho para Castração - BSZ
a partir de <b>R\$ 34,63</b>	a partir de <b>R\$ 234,07</b>	a partir de <b>R\$ 729,90</b> 4x de R\$ 182,47 sem juros	a partir de <b>R\$ 388,90</b> 2x de R\$ 194,45 sem juros	a partir de <b>R\$ 93,90</b> Disponível em 2 opções
Adicionar	Adicionar	Adicionar	Adicionar	Adicionar

Assinado por 1 pessoa: BRUNO RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



Home > Radiologia > Filme Radiográfico > Filme Radiográfico Adulto Periapical E-Speed - Carestream

1/4



Filme Radiográfico Adulto Periapical E-Speed - Carestream

Embalagem com 150 unidades.

Cod. de Referência: 238693

★★★★★ (71)

R\$239,90 13% OFF

R\$208,99

2x de R\$104,50 sem juros

—1+

Adicionar ao Carrinho

+Adicionar a lista de desejos▼

Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

Lovers. Acumule e troque por benefícios exclusivos.

Frete Grátis. Em compras acima de R\$ 200.

Troca Grátis. Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento▼

Detalhes

Filme Radiográfico Odontológico

- Filme E-Speed Radiográfico para Odontologia.
- Cor azul.
- Modelo: adulto.
- Velocidade intermediária (Velocidade E).
- Compatibilidade com os métodos de processamento manual e automático.
- Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA: 80378750033.

Aplicação▼









Agosto com cashback de até R\$ 100!

[Home](#) > [Dentística e Estética](#) > [Matriz](#) > Banda Aço Matriz Tofflemire Nº 1 - Microdont

1/4



## Banda Aço Matriz Tofflemire Nº 1 - Microdont

Embalagem c/ 12 unidades.

Cod. de Referência: 109109

( [avaliar!](#) )**R\$11,90**

— 1 +

**Adicionar ao Carrinho**

+Adicionar a lista de desejos✓

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Calcular****Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.**Formas de pagamento****Detalhes**

Sua principal característica é a flexibilidade que permite facilmente contornar as paredes, melhorando a

1 Doc: Memorando 10- 11.395/2024 138/6450





O que você está buscando?



[Início](#) > [Produtos Odontológicos](#) > [Endodontia](#) > [Matriz Seccional Pré-Contornada Odontológica Sortida C/50 - Lysanda](#)

## Matriz Seccional Pré-Contornada Odontológica Sortida C/50 - Lysanda

**R\$79,90**

12 x de R\$8,10

[Ver mais detalhes](#)

**15% OFF COMPRANDO 5 OU MAIS!**

Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.

< 1 >

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

### Descrição

Descrição

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI

1Doc: Memorando 10- 11.395/2024 139/6450


[https://www.newdentale.com.br/produtos/matriz-seccional-pre-contornada-odontologica-sortida-c-50-lysanda/?variant=788146918&pf=mc&gad\\_s...](https://www.newdentale.com.br/produtos/matriz-seccional-pre-contornada-odontologica-sortida-c-50-lysanda/?variant=788146918&pf=mc&gad_s...)

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6





O que você está buscando?

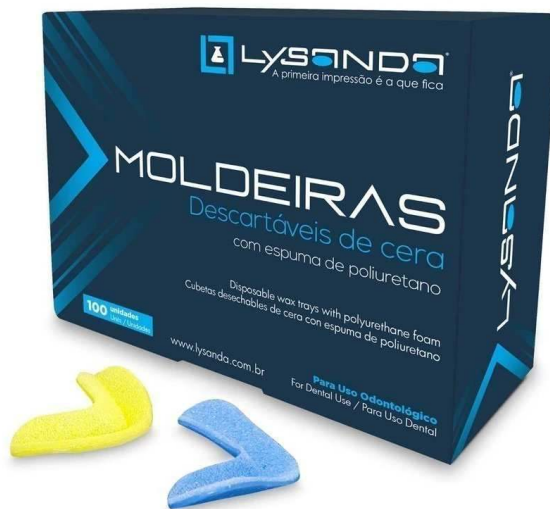

Início > Produtos Odontológicos > Ceras > Moldeira De Cera Descartável - Aplicação de Flúor - Lysanda

## Moldeira De Cera Descartável - Aplicação de Flúor - Lysanda

**R\$110,50**

12 x de R\$11,20

[Ver mais detalhes](#)

**15% OFF COMPRANDO 5 OU MAIS!**

Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.

Cor: **Sortida**



Quantidade: **100**

50 100

< 1 >

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI

1Doc: Memorando 10- 11.395/2024 140/6450

[https://www.newdentale.com.br/produtos/moldeira-de-cera-descartavel-aplicacao-de-fluor-lysanda/?variant=787787730&pf=mc&gad\\_source=4&g...](https://www.newdentale.com.br/produtos/moldeira-de-cera-descartavel-aplicacao-de-fluor-lysanda/?variant=787787730&pf=mc&gad_source=4&g...)

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6





Busque aqui seu produto



## Papacárie Duo Gel

Embalagem com 1 seringa com 1ml.

FÓRMULA & AÇÃO

Código do produto: 026031

**R\$ 150,00**

Quantidade:

1

Adicionar ao carrinho



Calcule frete e prazo



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6







[Laboratório](#)  
[Universitários](#)

[Home](#) > [Instrumentais](#) > [Acessórios](#) > [Pedra para Afiar](#) > Pedra para Afiar Arkansas - Hu-Friedy

1/2



## Pedra para Afiar Arkansas - Hu-Friedy

Embalagem com 1 unidade.

Cod. de Referência: HUF11680A

Cód Fabricante: SS4

★★★★★ (1)

~~R\$286,90~~ 5% OFF

**R\$272,99**

2x de R\$136,50 sem juros

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

+Adicionar a lista de desejos

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

**Mais Speed.** Pontue para ganhar muitos descontos e vantagens

**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 199.

**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6>



receba **cashback** campeão de **5%**

Aproveite

Olá, o que você procura?



Precisa de Ajuda?

2ª via Boleto

0

categorias Acadêmicos Endodontia Ortodontia Dentística e Estética Descartáveis Instrumentais Harmonização Orofacial

Home > Instrumentais > Porta Amálgama > Porta Amalgama Delrin de Plástico - Jon

### Porta Amalgama Delrin de Plástico - Jon

Código: 2003

A partir de  
~~R\$ 24,84~~ economize R\$ 14,02

Condições de pagamento

**R\$ 10,82**

Preço

Quantidade

**R\$ 10,82**

-

1

+

Adicionar ao carrinho

Compre e receba de volta  
até **R\$ 0,54!**



Calcular o frete

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Compartilhar

### Descrição do Produto

Embalagem com 1 unidade

#### CARACTERÍSTICAS

- Material Plástico;
- Autoclavável;
- Validade: Indeterminada;
- Registro ANVISA: 10415649017.

#### INDICAÇÃO

- Indicado para transporte e inserção de amalgama na cavidade dentária.

### Quem viu, viu também

-56%



Porta Amalgama Delrin de Plástico - Jon  
Embalagem com 1 unidade

~~R\$ 24,84~~ **R\$ 10,82**

-

1

+



Porta Amálgama Micro - Golgran  
Embalagem com 1 unidade

**R\$ 63,90**

-

1

+



Porta Amálgama de Plástico - Maquira  
Embalagem com 1 unidade

**R\$ 19,90**

-

1

+



Porta Amálgama - Uma  
Embalagem com 1 unidade

**R\$ 27,93**

-

1

+



Porta Amálgama Simples - Golgran  
Embalagem com 1 unidade

**R\$ 93,36**

-

1

+

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AA9-58F6 e informe o código 24CC-C1B3-AA9-58F6





[Laboratório](#)  
[Universitários](#)

[Home](#) > [Instrumentais](#) > [Prendedor de Guardanapo](#) > Prendedor de Guardanapo Jacaré Corrente - Preven

1/2



## Prendedor de Guardanapo Jacaré Corrente - Preven

Embalagem com 1 unidade.

Cod. de Referência: PRE16194A

Cód Fabricante: 358

★★★★★ (2)

**R\$9,90**

— 1 +

**Adicionar ao Carrinho**


+ Adicionar a lista de desejos ✓


### Calcular frete e prazo


A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Calcular**

 **Mais Speed.** Pontue para ganhar muitos descontos e vantagens

 **Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 199.

 **Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

**Formas de pagamento** ▼

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



Agosto com  
de até **R\$ 100!**[Home](#) > [Biossegurança](#) > [Protetor Descartável](#) > Saco Plástico Sacolé - Segplast

1/2



## Saco Plástico Sacolé - Segplast

Embalagem com 100 unidades. 5cm x 23cm.

Cod. de Referência: 600599

★★★★★ (13)

**R\$2,19**

— 1 +

[Adicionar ao Carrinho](#)[+Adicionar a lista de desejos](#)

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

[Calcular](#)

**Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.

**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.

**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

[Formas de pagamento](#)[Detalhes](#)


\* Embalagem com 100 unidades.

1Doc: Memorando 10- 11.395/2024

145/6450



Saco Plástico para Hambúguer ou Tapioca "G" 17x17cm Montyplast (100 unidades)

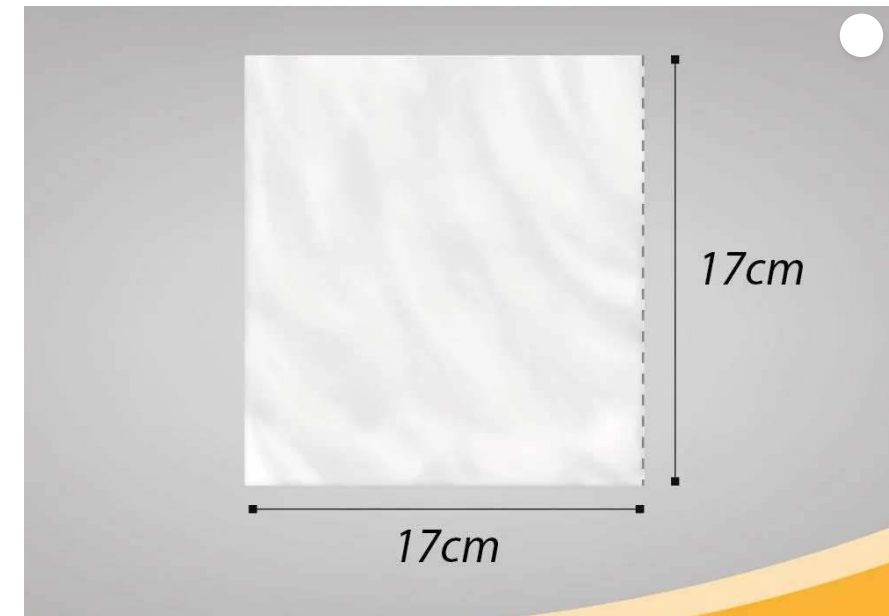

[adicionar aos favoritos](#)

Compartilhar



Saco Plástico para Hambúguer ou Tapioca "G" 17x17cm Montyplast (100 unidades)

[ver as avaliações](#)

Código de barras: 247376

Saco plástico para Hambúguer e Tapiocas grande  
Produzido em Polietileno de Alta Densidade

Ver mais

RECEBA EM ATÉ 24H ÚTEIS

R\$ 5,00

Valor promocional

Compre 10 por R\$ 4,00 cada

- 1 +

Comprar

Insira seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

#### Especificações

Material	Polietileno de Alta Densidade
Modelo	Sacos Fundo Reto

#### Avaliações



Classificação média: 0 (0 avaliações)

[Faça login para escrever uma avaliação](#)

Nenhuma avaliação

#### Descrição do produto

Saco plástico para Hambúguer e Tapiocas grande

Produzido em Polietileno de Alta Densidade 100% virgem na cor branca

Produto inodoro e atóxico

Dimensões:

17cm Largura

17cm Altura

Embalagem contém 100 sacos

#### Promoções



novidade



Pague com PIX

E GANHE 5% OFF NO SEU PEDIDO

Aprove

Categorias Esterilização Estetoscópios Descartáveis Veterinária Novidades Rotina T

Acadêmica

Digite o que você procura...

Home Antisseptico Curativos Agua Oxigenada 10 Volumes Antisseptica 100ml - FARMAX FARMACEUTICOS



18%  
OFF

# Água Oxigenada 10 Volumes Antisséptic 100ml - FARMAX FARMACEUTICOS

(avalie agora!)

Cód.: FAR26360A

Embalagem com 1 unidade.

~~R\$2,79~~ por  
**R\$2,29**

Quantidade

1

## Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da nota fiscal.

Calcular Frete

## Detalhes

Água Oxigenada 100ml 10V

- A água oxigenada 10 volumes da Farmax é um produto com peróxido de hidrogênio a 3% para uso tópico ou em gargarejos.
- É utilizado em locais previamente limpos para assepsia de feridas e queimaduras.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fabricante: Farmax
- Produto: Água Oxigenada 10 Volumes
- Uso: Antisséptico Tópico e Gargarejos
- Volume: 100 ml
- Validade: 36 meses


### COMPOSIÇÃO

- Peróxido de Hidrogênio 3%.
- Excipientes: Água Purificada, Fenacetina, Ácido Fosfórico.

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6> e informe o código 24CC-C1B3-AAA9-58F6



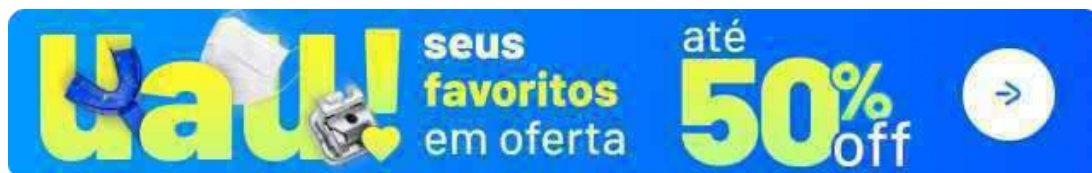

[Laboratório](#)[Universitários](#)[Home](#) > [Prevenção e Profilaxia](#) > [Verniz](#) > Verniz de Flúor Duraphat - Colgate

\*Estoque limitado. Promoção não cumulativa, um brinde por CPF/CNPJ. Imagem ilustrativa. Válido em compras em Colgate.

1/5



## Verniz de Flúor Duraphat - Colgate

Embalagem com 10ml.

Cod. de Referência: COL4839A

Cód Fabricante: FBR10612

★★★★★ (9)

ATENÇÃO! Produto de venda restrita a cirurgiões-dentistas com inscrição ativa em conselho profissional, pessoas jurídicas que prestem serviços odontológicos e estudantes de odontologia.

Nas compras em  
**COLGATE**

Compre acima de **R\$1.499** e  
ganhe 1 **Kit churrasqueira**

Compre acima de **R\$2.999** e  
ganhe 1 **Churrasqueira**

~~R\$216,90~~ 13% OFF

**R\$187,99**

1Doc: Memorando 10- 11.395/2024 148/6450





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 24CC-C1B3-AAA9-58F6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA (CPF 427.XXX.XXX-74) em 14/08/2024 10:14:26  
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24CC-C1B3-AAA9-58F6>

## Memorando 11- 11.395/2024

**De:** Bruna P. - SMS-DGS-AQUI

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/08/2024 às 11:37:29

**Setores envolvidos:**

SEADM, SMS, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SMS-DAS-DAS-CEODON, SMS-DGS-AQUI

### Envio de DFD | Insumos Odontológicos

Favor desconsiderar o anexo do despacho anterior, 10 .

Segue anexo o ETP retificado.

Sem mais.

—  
**Bruna Morelli R. Pereira**  
Secretaria Municipal de Saúde  
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

**Anexos:**

ETP\_n\_0132024\_Insumos\_Odont\_com\_anexos\_002.pdf

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR ETP nº 013/2024

Em conformidade com o Art. 18, § 1º da Lei 14.133/2021

Aquisição de materiais de consumo odontológico para manutenção dos estoques da Seção de Saúde Bucal de Cajati/SP.

**Unidade administrativa responsável:** Secretaria Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F

## **1. INTRODUÇÃO:**

1.1 Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem como objetivo analisar a aquisição de insumos e materiais odontológicos necessários para atender às demandas do Centro Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde.

1.2 A iniciativa visa garantir a continuidade dos atendimentos odontológicos oferecidos à população, assegurando a viabilidade das operações e o cumprimento eficiente das atividades. A aprovação desses materiais é essencial para manter a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à comunidade.

## **2. DA ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO VIGENTE:**

2.1 Atualmente, contamos com uma Ata de Registro de Preços (ARP) para a aquisição dos materiais deste ETP. ARP nº 055/2023 – vinculada ao Pregão Eletrônico nº 064/2023.

2.2 A ARP se mostrou uma excelente opção para adquirir os insumos devido à agilidade nas entregas e aos valores acessíveis.

## **3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. I):**

3.1 A necessidade de aquisição de insumos odontológicos para o Centro Odontológico da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati/SP é fundamental para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados à população. Os insumos são essenciais para a realização de procedimentos odontológicos, garantindo que os atendimentos sejam realizados de forma segura, eficiente e com o padrão de qualidade exigido.

3.2 A manutenção adequada do estoque de materiais odontológicos é crucial para a operacionalidade do Centro Odontológico, pois permite que os profissionais da saúde bucal possam executar suas atividades sem interrupções, atendendo às necessidades dos cidadãos de maneira oportuna. A ausência desses materiais comprometeria gravemente a capacidade de atendimento, resultando em atrasos, redução da qualidade do serviço e, potencialmente, no agravamento das condições de saúde dos pacientes.

3.3 A aquisição dos materiais odontológicos tem como finalidade assegurar o acesso da população aos atendimentos odontológicos ofertados na rede de atenção básica do Município de Cajati/SP, resguardando os princípios de equidade e justiça social. Vale ainda mencionar a Lei nº 14.572/2023, que institui a Política Nacional de Saúde Bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para incluir a saúde bucal no campo de atuação do SUS. Este marco legal reforça o compromisso de garantir acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no SUS, reconhecendo a saúde bucal como um direito fundamental de todos os brasileiros.

3.4 As principais diretrizes do programa são baseadas no direito de todos os cidadãos a um sorriso saudável, o que é parte fundamental para uma vida digna, para o aumento da autoestima e para o exercício pleno da cidadania. A disponibilização de insumos odontológicos adequados é, portanto, um elemento central para a implementação desta política pública, permitindo que o Município de Cajati/SP continue a oferecer serviços de saúde bucal de excelência, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida da população.

#### **4. DA DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (Art. 18, § 1º, inc. II):**

4.1 O objeto em questão estará contemplado no Plano de Contratações Anual da Secretaria Municipal de Saúde de Cajati, alinhado com o planejamento desta Administração.

4.1 A falta de insumos odontológicos no Centro Odontológico pode causar impactos negativos significativos nas políticas públicas de saúde. Primeiramente, a ausência desses materiais essenciais pode levar à interrupção ou redução dos atendimentos, comprometendo a continuidade dos cuidados e aumentando o tempo de espera dos pacientes. Essa situação pode gerar insatisfação na população e prejudicar a eficácia dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, a saúde pública pode ser diretamente prejudicada, uma vez que a falta de insumos pode resultar em diagnósticos tardios, tratamentos inadequados ou incompletos, agravando as condições de saúde dos pacientes e aumentando a demanda por serviços de urgência e emergência. Isso, por sua vez, eleva os custos do sistema de saúde a longo prazo.

4.2 A escassez de insumos também pode exacerbar as desigualdades no acesso aos serviços de saúde bucal, especialmente para as populações mais vulneráveis, que dependem exclusivamente do SUS para seus cuidados odontológicos. Essa situação contraria os princípios de equidade e justiça social que fundamentam as políticas públicas de saúde. Além disso, problemas de saúde bucal não tratados podem afetar significativamente a qualidade de vida dos cidadãos, causando dor, desconforto, dificuldades alimentares e impacto na autoestima, o que evidencia que a falta de insumos afeta não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e social das pessoas.

4.3 Outro impacto relevante é o comprometimento das metas governamentais. A ausência de insumos pode impedir o cumprimento das metas estabelecidas pelas políticas públicas de saúde bucal, como as previstas na Política Nacional de Saúde Bucal. Isso pode resultar em avaliações negativas de desempenho, dificultar a obtenção de recursos e comprometer a credibilidade das gestões locais e estaduais na área da saúde. Além disso, a falta de prevenção e tratamento adequados pode levar a complicações de saúde mais graves e dispendiosas para o sistema público, como a necessidade de tratamentos complexos ou hospitalizações, aumentando a carga financeira sobre o SUS.

4.4 Esses impactos mostram a importância de garantir um fornecimento contínuo e adequado de insumos odontológicos, como forma de proteger a saúde da população e assegurar o sucesso das políticas públicas de saúde.

#### **5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. III):**

5.1 A contratada, além de cumprir com todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, deve efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local que constarão no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual deverá constar as indicações referentes a: marca, fabricante, procedência e Lote. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas.

5.2 As empresas participantes deverão apresentar os seguintes documentos:



5.2.1 Cópia autenticada de Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento da empresa participante da licitação, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis Complementares.

5.2.2 Cópia autenticada da Autorização de Funcionamento do Licitante, expedido pelo Ministério da Saúde ou de sua publicação no Diário Oficial da União ou extraída via Internet.

5.2.3 Declaração de que a(s) empresa(s) fabricante(s) dos materiais de enfermagem ofertados por sua empresa, possui(em) Certificado de Boas Práticas do Fabricante, expedido pelo Ministério da Saúde em vigência.

5.2.4 Comprovação de registro vigente no Ministério da Saúde, para todos os lotes cotados, através de comprovante emitido pela ANVISA, através da Internet, demonstrando sua vigência ou de cópia autenticada de uma das formas a seguir:

5.2.4.1 Publicação do Registro do Produto no Diário Oficial da União, demonstrando sua vigência ou Comprovante de Registro emitido pelo Ministério da Saúde, demonstrando sua vigência.

5.2.4.2 Em todos os casos acima, se a validade estiver vencida, apresentar também o Pedido de Revalidação do Registro (P1 e P2), datado do semestre anterior ao do vencimento.

5.2.4.3 Para os materiais odontológicos em que não seja necessário Registro a empresa deverá apresentar documento que comprove a dispensa do registro na ANVISA.

## **6. DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. IV):**

6.1 Segue, de forma detalhada, a listagem dos materiais com as especificações e quantitativos necessários, considerando a demanda da Secretaria:

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
1	100 PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM SABOR, PONTA ANIMAIS, PCT COM 40 UND – Especificação técnica: Abaixador de Língua com aroma, sabor de Tutti-Frutti, ponta animais; pacote com 40 unidades cada, embalados individualmente em filme plástico transparente e colocado em pacotes plásticos com dados do produto; cada abaixador deve ser decorado com figuras de animais em cores sortidas; produzido em plástico atóxico, livre de toxicidade, que não irrita, sem açúcar, sem látex e sem medicamentos; não esterilizável; descartável/uso único; higienizado; colorido com dióxido de titânio rutilo e pigmentos orgânicos; com aroma artificial de Tutti-Frutti; dimensões (unidade): 124 mm x 16 mm x 3 mm. Certificações: Aprovação pelo FDA, possuir testagens de biocompatibilidade feitas periodicamente no Brasil e nos Estados Unidos desde 1999 a cada dois anos e produzido de acordo com as normas ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 e RDC 59/ BPF e Registro ANVISA: 10438720003.
2	10 KITS	ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO EM KIT (1 ADULTO e 1 CRIANÇA), EM SILICONE ATÓXICO – Especificação técnica: Abridor de boca anatômico; em Kit (1 unidade tamanho adulto e 1 unidade tamanho infantil); formato trapezoidal com ranhuras laterais; em silicone atóxico; esterilização em meios físico-químicos; garantia mínima de 01 ano a partir da entrega; Kit embalado individualmente, em material apropriado que garanta integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

3	10 UND	ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA COM 4 MEDIDAS – Especificação técnica: Abridor de boca anatômico; para Pessoas com Deficiência, reposição compatível com Abritec PCD/Indusbello; com 4 medidas diferentes em um único produto (14mm, 20mm, 26mm e 32mm); em silicone atóxico; esterilização em meios físico-químicos; garantia mínima de 1 ano; embalagem individual, em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
4	15 PTS	ABRASIVO EM PÓ, PEDRA POMES, PARA PROFILAXIA DENTAL, GRANULAÇÃO EXTRAFINA, POTE C/100 GRAMAS - Abrasivo, em pó, pedra pomes, para polimento e profilaxia dental, granulação extrafina, embalado em pote com 100 gramas, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
5	30 KITS	ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA - em pontas de silicone flexíveis ;impregnadas com óxido de alumínio, não produzindo calor excessivo; caixa com 7 pontas sortidas (3 chama de vela, 2 taças e 2discos). Composição de tri polímero (estireno Butadieno-Metacrilato de Metila) Sílica Piroclítica Silanizada, Uretano Dimetanolamina e óxido de alumínio . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
6	60 UND	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - Sistema de adesivo de frasco único (prime e adesivo), com tampa flip top e bico dosador, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, sistema adesivo com nanotecnologia, contendo cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Utilizado nas técnicas de condicionamento ácido total (com prévio condicionamento em esmalte e dentina), auto condicionante (sem condicionamento ácido) ou com condicionamento seletivo em esmalte, indicado para restaurações diretas e indiretas, sem a necessidade de aplicação de um primer metálico e silano.Composição: Metacrilato de 2-hidroxieta (15 a 25% em peso), Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BisGMA) (15 a 25% em peso), Decametileno dimetacrilato (5 a 15% em peso), Etanol (10 a 15% em peso), Sílica tratada de silano (5 a 15% em peso), Água (10 a 15% em peso), 1,10-Decanodiol fosfato metacrilato (1 a 10% em peso), Copolímero de acrílico e ácido itacônico (1 a 5% em peso), Caforoquinona (menor que 2% em peso), N-Dimetilbenzocafina (menor que 2% em peso). Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
7	200 GALÕES	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristalina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5 litros. Com validade mínima de 2 anos da data de entrega.
8	10 CX	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA - Agulha gengival longa em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
9	60 CX	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - Agulha gengival curta em cânulaem aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade,com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
10	25 CX	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA - Agulha Gengival 30G extra curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médico, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plásticaindividual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

11	20 LT	ALCOOL ETILÍCO 92,8 IGPM (CATEGORIA COMERCIAL) - FRASCO COM 1 LITRO - Líquido; com teor de no mínimo 92,8 IGPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rotulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Com registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
12	800 LT	ALCOOL ETILÍCO A 70 % PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES – FRASCO COM 1 LITRO – Indicado para desinfecção de superfícies e artigos semi e não críticos; frasco de 1 litro, contendo dados de identificação, nº de lote, validade e responsável técnico; em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto deverá atender a legislação atual vigente. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
13	120 CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) + Epinefrina 10 µg/mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, cada embalagem contém 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
14	15 CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML - Anestésico local injetável, a base de lidocaína a 3% e norepinefrina, tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as normas de procedimentos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
15	5 CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2 % SEM VASOCONSTRITOR - Tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
16	60 UND	ANESTÉSICO TÓPICO GEL - Frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel, benzocaina a 20%, hidrossolúvel, em pote, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
17	150 UND	BABADOR DESCARTÁVEL – Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável; folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico; maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades.
18	10 UND	BICARBONATO DE SÓDIO - Bicarbonato de sódio odontológico; pó extrafino para polimento e profilaxia dental, pureza (99,6%), sem aroma, sem corantes; em frasco plástico; acondicionados em pote de 250g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, o produto deverá obedecer a legislação vigente; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
19	100 UND	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 COM CABO E LÂMINA - Composto por um cabo plástico resistente, com lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

20	100	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 COM CABO E LÂMINA - Composto por um cabo plástico resistente, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
21	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
22	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
23	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
24	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
25	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
26	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
27	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

28	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
29	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
30	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
31	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 11168F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
32	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
33	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
34	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
35	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.



36	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
37	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
38	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
39	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
40	30 UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF – Broca diamantada para preparocavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
41	30 UND	BROCAS ZÉCRYA HL - Broca do tipo Zécrya número 151, formato tronco-cônico, confeccionada com aço carbide, para motores de alta rotação, com desempenho livre de vibrações, haste longa, com seis lâminas helicoidais sem rebarbas ou sinal de oxidação. Utilizada para odontosecção e corte/desgaste de osso. Ideal para cirurgia de ciso incluso. Tamanho: 28 mm de comprimento total. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.
42	15 UND	BLOCO PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO – Bloco para espatulação; de papel plastificado; tamanho de 15cm x 8cm aproximadamente; com 50 Folhas; embalagem que garanta a integridade do produto.
43	30 PCT	CANUDO DESCARTAVEL EM PP, DIAM. 5,5 mm, LISO - Canudo descartável; de polipropileno; com diâmetro de 5,5mm; medindo 210mm; branco, liso e acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do produto. Embalagem com 100 unidades.



44	30 UND	CARIOSTÁTICO 30 % – Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meioamoniaca, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos proteicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de carióstáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
45	5 UND	CIMENTO CIRÚRGICO – sem eugenol produzido através da mistura de seus componentes, ótima textura e plasticidade após a presa. Produto de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol e cera natural. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido de zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol e BHT. Validade mínima: 2 anos da data de entrega.
46	15 UND	CIMENTO PROVISÓRIO ENDODÔNTICO COM IODOFORMIO – Material temporário para obturação de canal radicular; com Iodofórmio que confere a pasta propriedade anti-infecciosa e intensa radiopacidade; pasta de Hidróxido de Cálcio pronta para o uso; de fácil aplicação; ação anti- bacteriana; que induz a formação de dentina reparadora; com consistência ideal para escoamento no canal radicular; apresentação: 1 seringa de 2,5ge 3 bicos aplicadores. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.
47	6 UND	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ. (10ml) - Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de óxido de zinco com até 10% de óxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por ácido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.
48	6 UND	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO – Benefícios: massa de fácil manipulação; endurecimento rápido; menor microinfiltração marginal. Características: obturador provisório normal. Aplicação: indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos. Apresentação: Embalagem c/25g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
49	150 LT	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO, EMBALAGEM DE 1 LITRO – Solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de clorexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo espectro pronto para o uso. Embalagem contendo 1 litro. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
50	20 UND	CLOREXIDINA 2% - Antisséptico com atividade antibacteriana, com eficácias para gram-negativas, fungos leveduras e alguns dermatófilos. Composição- digluconato de clorhexidina 2%, metilparabeno, água deionizada. (livre de álcool etílico) Frascos com 100ml. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.
51	20 UND	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTE – Capacidade para 05 litros, para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc. Alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853.
52	6.000 UND	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - Com 13 fios, 7,5x7,5 cm; em 100% de viscose branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras; medindo 7,5cm x 7,5 cm; com formato quadrado; estéril; embalado com 10 unidades cada, embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico e laudo analítico laboratorial, de cumprimento da NBR 13843. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.

53	200 PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5x7,5 cm, NÃO ESTÉRIL, PACOTE C/500 UND – Compressa de gaze hidrófila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 5 dobras, 8 camadas, sem filamento radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 cm; com formato quadrado; não estéril; embalado em pacote com 500 unidades que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 anos da data de entrega.
54	60 UND	CONDICIONADOR DENTAL GEL - Gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, espessado com Sílica Coloidal. Composição: Ácido Fosfórico, Sílica Coloidal, Surfactante e Corante. Embalagem com 3 seringas de 3 ml e 3 ponteiros p/ aplicação. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
55	10 KITS	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMICA DE MADEIRA, 5 TAMANHOS, CODIF. POR CORES - Embalagem com 100 unidades; Especificação Técnica: Cunha interdental; confeccionada em madeira; formato anatômico da ameia, em 5 tamanhos diferentes codificados por cores; constando externamente quantidade, marca comercial, procedência de fabricação.
56	15 UND	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM FLUORETO DE SÓDIO 2% E NITRATO DE POTÁSSIO, SER. 2,5g – Gel de baixa viscosidade dessensibilizante oclusivo à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2% que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
57	100 UND	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carbohidrase); sendo as principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; específico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.
58	30 UND	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, (tipo de unha) – Para uso na limpeza de artigos de pequeno e médio porte. Descrição: Escova plástica para limpeza delicada, cor sortida. Dimensões: 9.5 x 2.5 cm.
59	200 UND	ESCOVA ROBSON, PEQUENA, CERDA PLANA, NA COR BRANCA PARA CONTRA ÂNGULO - Escova de Robson; pequena; para profilaxia; com cerda plana; haste metálica, e cerdas em nylon na cor branca; para contra angulo; embalada em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial, numero de lote, data de fabricação e procedência.
60	20 UND	ESPATULA PARA ODONTO PLÁSTICA, FLEXIVEL, PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO - Especificação Técnica: Espátula para odontologia; de plástico, flexível; para manipulação de Ionomero de Vidro. Medidas aprox. 21,50x3,20x0,50cm (c x l x a); embalada individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
61	100 UND	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX - Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos, passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto, embalado individualmente, marca comercial, procedência de fabricação.

62	10 UND	ESPELHO TOUCADOR COM CABO, FORMATO DENTE – Espelho de mão para procedimentos clínicos; toucador com cabo; formato dente; disponível em diversas cores; tamanho aproximado de 19,5cm de comprimento. Embalagem com 1 unidade.
63	20 CX	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UND - Esponja Hemostática produzida com 100% de colágeno porcino liofilizado; com absorção de 40-50 vezes seu próprio peso em sangue total; que seja completamente reabsorvida pelo organismo em 15 dias; material atóxico e não pirogênico; esterilizada por raios gama; com material leve com peso aproximado de 10 mg; dimensões: 1x1x1 cm e com Registro ANVISA. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.
64	40 UND	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA SOLUÇÃO , frasco C/10 ml. Evidenciador de placa bacteriana em solução, em frasco c/10 ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
65	50 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 20 mm- fio agulha de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 2,0 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
66	20 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 - Monofilamento preto, agulha 3/8 Circ – CT 15 mm- fio agulha de sutura nylon monofilamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.
67	30 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 4-0 - Mono filamento preto, agulha 3/8 Circ. – CT 15 mm -Fio agulhado de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 4-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
68	10 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA SEDA, NÚMERO 4-0 - Fio de Sutura de Seda Preta. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm. Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.* Esterilizado em Raio Gama. As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura. Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Uso exclusivo em Odontologia. Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.
69	20 CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 5-0, AGULHA 3/8 Cir. - Fio de sutura de nylon obtido da proteína e goma docasulo do bicho da seda, n.5-0, preto trançado, agulhado -3/8 circ. triangular, CT 1,5cm, fio medindo 45 cm, uso odontológico, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ter comprovação de sua esterilidade, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
70	40 UND	FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

71	5 UND	FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, Nº. 00, CORDÃO TRANÇADO MALEÁVEL, NÃO IMPREGNADO - Fio para retração gengival; composto por cordão trançado e maleável 100% algodão, não impregnado por substância química, n. 00; embalado em frasco com 240 cm aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 02 ano da data de entrega.
72	3 CX	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4 cm. Filme para radiografia periapical para adulto, 3 x 4cm, compatível com processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
73	40 UND	FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe I (ISO 11140-1). Apresentações: Medidas – 19mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
74	60 FRC	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
75	10 UND	FORMOCRESOL, SOLUÇÃO - Formula BUCKLEY, frasco c/10 ml em solução, composição formula buckley, em frasco com 10 ml, embalado individualmente, constando externamente procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
76	50 PCT	GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL EM TNT POLIPROPILENO – Gorro cirúrgico descartável; em não tecido polipropileno, gramatura 50, branco, hipoalergênico, atóxico; com elástica na parte posterior; com formato anatômico; que permita ventilação adequada; embalagem com em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Contendo 10 unidades em cada pacote.
77	06 UND	HEMOSTÁTICO LIQUIDO – Indicações: indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restaurações, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Composição: Álcoois, cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinololna e água purificada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
78	15 UND	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - Indicação capeador pulpar, material para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Propriedades: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões; evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de Hidróxido de Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
79	100 LT	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%- Bactericida, desinfetante, ação química de solvente de tecidos, antisséptico, característica físico química de baixa tensão superficial, embalagem contendo 1000 ml. Validade mínima 2 anos da data de entrega.

80	20 CX	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de <i>GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS</i> que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
81	1CX	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5, COM 100 UND – Descrição: Indicador químico integrador Classe 5, para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, de acordo com a RDC 15; que reaja a todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor (tempo, temperatura e vapor); que permita a leitura imediata do resultado através da migração da tinta para a área identificada. Características: Classificação Classe 5; Composição: produto livre de chumbo, mercúrio, bário e látex. Resíduo comum; Parâmetros: Classe 5 - 135°C por 1,5 minutos / 121°C por 21 minutos; Dimensões da tira: aproximadamente 102 x 19 mm (l x c); Apresentação: Embalagem com 100 unidades; Prazo de validade informado na embalagem do produto; Validado de acordo com as Norma ISO 11140-1:2005 e Registrado no FDA e de acordo com AMMI ST60. Validade de 2 anos da data de entrega.
82	20 UND	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
83	80 KITS	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDADE: Apresentação: kit contendo um frasco de pó com no mínimo 5g e um frasco de líquido composto por ácidos orgânicos solúveis em água, com quantidade compatível com o quantitativo de pó, com medidor pó/líquido; Características do material: o cimento de ionômero de vidro restaurador deve ser do tipo de alta viscosidade, condensável, quimicamente ativado, radiopaco, autopolimerizável, com erosão máxima: 0,17mm, máximo 5 min, conjunto completo indicado para realização do tratamento restaurador atraumático (ART); Descrição complementar: resultados comprovados pela norma iso 9917; proporção de mistura pó/líquido superior a 3,5; resistência à compressão: mínima de 200mpa; resistência flexural: mínima de 25mpa; o produto deve ser reconhecido no meio científico através de estudos publicados em jornais e revistas de circulação do meio acadêmico, nacional e internacional; As embalagens primária e secundária deverão estar em conformidade com a legislação vigente do ministério da saúde e código de defesa do consumidor. Validade mínima de 2 anos da data de validade.
84	80 KITS	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão do esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Ionômero pó (10g), composto de Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de Bário, Ácido Poliacrílico. Pigmentos, composição do líquido: Ácido Tartárico e Água Destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
85	20 KITS	KIT REVELADOR E FIXADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO – REVELADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. FIXADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475ml. Ambos da mesma marca comercial. Validade mínima de ambos de 2 anos da data de entrega.
86	2 CX	LÂMINA DE BISTURÍ Nº12 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
87	2 CX	LÂMINA DE BISTURÍ Nº15 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.



88	1000 PARES	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5- Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes elásticas, oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.
89	1000 PARES	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.
90	3000	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL TAMANHO 7,5 Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.
91	100 CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO M- Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante. Microtexturizada. Ação Antiderrapante. Totalmente isenta de pó. Hipoalergênica. Ambidestra. Embalagem: 100 Unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
92	150 CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega
93	200 CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
94	500 CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.
95	15 UND	MANDRIL ODONTOLÓGICO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, PARA ENCAIXE DE DISCOS POP-ON- Para polimento e acabamento de restaurações, adaptação em contra-ângulo, com haste de 15mm de comprimento; embalagem individual que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.



96	20 PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, Nº 1 – Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, nº 1, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
97	20 PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, PRÉ-MOLAR– Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo pré-molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
98	20 PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO BULMERANGUE, MOLAR– Banda de aço inox matriz Tofflemire, tipo bulmerangue, modelo molar, espessura de 0,05mm, pré-cortadas, prontas para uso, sem rebarbas, pacote com 12 unidades. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
99	30 UND	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm - Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 nos da data de entrega.
100	30 UND	MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm – Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
101	10 KIT	MATRIZ SECCIONAL PRE CONTORNADA - Kit com 50 matrizes seccionais, pré contornadas de tamanho variado, com espessura das matrizes de 0,05mm e em aço inox. Facilidade na reconstrução do ponto de contato, obtenção de uma anatomia natural devido a convexidade das matrizes. Maior conforto para o paciente. Espessura das matrizes de 0,05mm. Embalagem com dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação e data de validade, apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde.
102	8 UND	MEDICAÇÃO OCLUSIVA; PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE - Medicação oclusiva; pasta para tratamento de alveolite composta basicamente por: Lidocaína, Eugenol, Laurilsulfato de sódio, Carbonato de cálcio, Penghawar djambi, Azeite, Água purificada e Aromatizante de hortelã; Composição do aroma natural de hortelã: mistura de óleoessencial de hortelã-verde e de óleo essencial de eucalipto; exclusivamentepara uso tópico; embalada em frasco de 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 18 mesesda data da entrega.
103	5 CX	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS SORTIDAS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR EM GEL - Para aplicação tópica de flúor em gel, feita em cera maleável, revestida com espuma hidrófila; adapta-se à arcada dentária, facilitando a penetração do gel de flúor nos espaços interproximais; em tamanhos diferentes para pacientes de 3 a 6 anos (amarela) e 6 a 12 anos (azul); caixas com moldeiras sortidas. Apresentação caixa com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
104	40 UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO – Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
105	30 UND	PAPACÁRIE DUO GEL – Apresentação: seringa com 1 ml; Características: gel com base em papaína, azul de toluidina e cloramina; Embalagem contendo dados de identificação, procedência, nº lote, data de fabricação e data validade. Validade de no mínimo 18 meses da data de entrega.

106	50 UND	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE AZUL E VERMELHO utilizado para marcação de pontos oclusais possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais que atinja anatomicamente os pontos oclusais. Possua folhas especiais 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelha e 100 micras de espessura. Embalagem com 10 folhas -25mm x 97 mm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
107	30 RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx100m - Composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxicidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
108	15 RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
109	30 RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
110	20RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m -- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
111	50 RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citotoxicidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.
112	15 UND	PARAMONOCLOROFENOL - material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
113	25 UND	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos

		ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas + 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas + 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
114	50 UND	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado Apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
115	5 UND	PEDRA DE AFIAR DE ARKANSAS, GRANULAÇÃO FINA - Especificação Técnica: Pedra de Afiar Instrumental Odontológico; de Arkansas; granulação fina; tamanho: 10 x 2,5 x 6 cm; Tipo: Pedra natural, em tonalidades que variam de cor branca a cinza, sedo suaves para afiação dos instrumentais com desgaste mínimo da ponta. Embalada Individualmente; Constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
116	20 CX	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO - Indicado para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiaposque permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
117	30 CX	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR - Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90°, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
118	6 UND	PORTA AMALGAMA ADULTO DE PLÁSTICO ATÓXICO - Porta amalgama; adulto; corpo contendo inscrição de marca; confeccionado em plástico/similar atóxico; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.
119	5 KITS	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO ADULTO - Kit com 4 peças sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis, utilizados para dentes anteriores e posteriores, esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.
120	30 UND	POTE DAPPEN, PLÁSTICO, AUTOCLAVÁVEL – Pote Dappen; plástico; composto a base de nylon; com boa resistência; esterilizável em autoclave a 137°C; possuindo duas cavidades para as manipulações; Medindo: altura 3 cm, concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml, concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; possuindo 12 dimensões; embalagem Individual.
121	20 UND	POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO COLORIDO, AUTOCLAVÁVEL - Pote Dappen; de vidro temperado colorido, autoclavável; espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarba, com 2 concavidades e capacidade de 5ml e 2ml; para manipulação de materiais odontológicos; embalagem individual.
122	30 UND	PRENDEDOR DE GUARDANAPO DE METAL JACARÉ - Prensador de guardanapo; de metal, passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.

123	10 UND	RESINA COMPOSTA COR A1 - Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO - Resina micro-híbrida, seringa com 4 g; cor A1; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência defabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
124	30 UND	RESINA COMPOSTA COR A2 Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A2; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência defabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
125	15 UND	RESINA COMPOSTA COR A3 Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A3; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
126	15 UND	RESINA COMPOSTA A3,5 Z100 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; cor A3,5; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência defabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
127	15 UND	RESINA COMPOSTA A2 Z250 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; cor A2; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
128	15 UND	RESINA COMPOSTA A3 Z250 FOTOPOLIMERIZÁVEL REPOSIÇÃO - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; cor A3; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
129	06 UND	RESINA COMPOSTA COR OA2 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação : seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.

130	06 UND	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação: seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
131	15 UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A2 - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g nacor A2. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
132	15 UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A3 - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g nacor A3. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
133	5 UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW OPACA - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fósulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: seringa com 2,4g nacor OPACA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
134	6 KITS	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO TIPO II, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL- KIT PÓ 38g E LIQUIDO 15ml – Cimento de óxido de zinco uso odontológico; tipo II reforçado para restaurações temporárias de longa spera; apresentação kit pó e líquido; pó cor marfim em frasco com aproximadamente 38g; composto basicamente de óxido de zinco metacrilato de metila; líquido em frasco com aproximadamente 15ml; composto basicamente por eugenol 99,5% e ácido acético 0,5%; embalado individualmente kit pó, líquido, conta gotas + colher dosadora; constando externamente marca comercial e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
135	500 UND	ROLETE DE ALGODÃO –com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
136	300 RL	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO-com fibra 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos; embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
137	100 PCT	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE, POLIETILENO, PROTEÇÃO DE CANETA, 4,5x23CM, PAC. 100 und. - Saco plástico descartável; de polietileno; para proteção de caneta (tipo Geladinho); medindo aproximadamente 4,5 x 23 cm; pacote c/ 100 unidades.



138	100 PCT	SACO PLASTICO LEITOSO 17x17cm, TIPO PARA LANCHE - Saco plástico leitoso, tipo para lanche; medindo aproximadamente 17x17 cm; embalagem com 100 unidades.
139	5 KITS	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS – Apresentação Kit contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação; fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
140	20 UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO FINA REPOSIÇÃO – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
141	20 UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO MÉDIA REPOSIÇÃO – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
142	20 UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO GROSSA REPOSIÇÃO – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
143	200 UND	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDRIGÊNIO 3% - AGUA OXIGENADA 10 vol FRASCO COM 100 ml - Água oxigenada 10 volumes; princípio ativo: peróxido de hidrogênio 3%; sem conservantes; medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos; apresentação: em frasco plástico opaco, tipo almotolia, contendo 100 ml; rotulo com número de lote, data de fabricação/validade, fórmula e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega
144	5 UND	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA – Especificação técnica: Acondicionada em frasco com 10 ml; hemostático local uso odontológico; em solução sem epinefrina atóxica; embalado em material apropriado que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; Registro Conforme Legislação Vigente. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
145	200 PCT	SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM 40 UND - Sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti-frutti colorido, rosa, verde, transparente e azul; cada pacote contendo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
146	50 UND	TIRA DE LIXA DE AÇO – Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 6 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 6 mm x 150mm. Embalagem individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.



147	50 UND	TIRA DE LIXA DE AÇO – Indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 4 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 4 mm x 150mm. Embalagem individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação.
148	15 CX	TIRA DE LIXA DE POLIESTER SOF-LEX REPOSIÇÃO - indicada para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Características : tamanho das tiras 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Tira possuindo um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies Inter proximais dos dentes. apresentação: caixa com 50 tiras .com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
149	100 PCT	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – Atóxico 100% polipropileno, gramatura 20 colorido não estéril, diâmetro: 50 x 50 não inflamável, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 3 anos da data de entrega
150	6 UND	TRICRESOL - Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96° água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução. Embalagem com 50 tiras. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.
151	10 UND	VASELINA SÓLIDA- Indicada como emoliente; mistura de hidrocarbonetos parafínicos, naftênicos e aromáticos; auxilia no tratamento de rachaduras de pele, como umectante; tem efeito emoliente e melhora a elasticidade; embalagem com 1 pote de 90g. Validade de no mínimo 2 anos da data de entrega.
152	15 BISN	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz de flúor para uso profissional; apresentação em bisnaga com 10 ml; com alta concentração de flúor - 22.600ppm (NaF 5%); sem a necessidade da adição de solventes; deve ser: altamente tolerante a água e com cobertura mesmo em superfícies úmidas, com filme verniz de boa aderência e endurecendo com a saliva; Composição: Aqua, Calcium Carbonate, Sorbitol, Arginine Bicarbonate, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Bicarbonate, Tetrasodium Pyrophosphate, Tricalcium Phosphate, Sodium Saccharin, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, CI 77891, Limonene. Contém Monofluorofosfato de Sódio (1450ppm de Flúor). Validade de no mínimo 2 anos da data de fabricação.

## 7. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO (Art. 18, § 1º, inc. V):

7.1 A contratação em questão é necessária para dar continuidade às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Não foram identificadas situações específicas ou de complexidade técnica que justifiquem outra abordagem. A solução mais adequada para atender aos interesses e necessidades da Administração é a contratação de uma pessoa jurídica especializada para fornecer os produtos com as especificações exigidas pela Secretaria de Saúde.

7.2 Considerando a grande diversidade de fabricantes, marcas, modelos e empresas fornecedoras desses produtos no mercado, a escolha se baseia nas especificações básicas necessárias e no menor preço encontrado. Não há outra solução no mercado que atenda à demanda, uma vez que a locação desses produtos não é comum e a produção pelo município é inviável.

7.3 Portanto, essa estratégia é economicamente e tecnicamente viável para a Administração Pública, pois oferece uma boa relação custo-benefício e qualidade na prestação do serviço.

## 8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. VI):

8.1 A estimativa foi baseada no valor da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 055/2023, referente ao Pregão Eletrônico nº 064/2023, da Prefeitura Municipal de Cajati – SP. Além disso, foram realizadas consultas de preços em empresas do setor odontológico, tanto por meio de websites quanto por e-mail, conforme detalhado no Anexo I.

8.2 A contratação está estimada em **R\$ 155.267,44** (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

8.2.1 *Ressaltamos que os preços obtidos no DFD nº 002/2024, pela Seção de Saúde Bucal, foram atualizados com base nos sites consultados, resultando em alterações nos valores. Dessa forma, o preço estimado deste ETP é superior ao do DFD.*

## 9. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18, § 1º, inc. VII):

9.1 Diante da especificidade dos materiais necessários e das opções disponíveis, conclui-se que a melhor solução para atender ao interesse público é a aquisição de materiais odontológicos por meio de uma Ata de Registro de Preços, utilizando-se de potenciais fornecedores e fabricantes, com o objetivo de suprir as necessidades institucionais.

9.2 Além de ser uma necessidade nesses produtos no local odontológico, a compra oferece vantagens como agilidade na aquisição e garantia de qualidade nos atendimentos aos munícipes.

9.3 Todos os detalhes necessários para atender à demanda da Administração estarão descritos no Termo de Referência, incluindo as obrigações e responsabilidades da contratada, bem como outras especificidades do objeto.

## 10. DAS JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18, § 1º, inc. VIII):

10.1 Considerando que a licitação poderá ser realizada por item, onde o objeto é divisível, onde foi verificado não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia, e que levando em consideração o mercado fornecedor, a viabilidade técnica e econômica do parcelamento, o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade, conclui-se pela necessidade da Administração em adotar o parcelamento da solução desta licitação através de itens, pois o objeto é divisível.

10.2 Diante disto, a contratação poderá ser realizada por meio de Pregão Eletrônico, com o tipo de julgamento sendo o de **menor preço por item**, visando à contratação através do Sistema de Registro de Preços, conforme estabelecido na Lei 14.133/21.

10.3 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

10.4 Todos os detalhes necessários para atender à demanda da Administração estarão descritos no Termo de Referência, incluindo as obrigações e responsabilidades da contratada, bem como outras especificidades do objeto.

## 11. DO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (Art. 18, § 1º, inc. IX):

11.1 A aquisição dos insumos odontológicos visa garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde bucal oferecidos à população, assegurando que o Centro Odontológico possa atender de forma eficaz e sem interrupções.

11.2 Espera-se que essa aquisição resulte em um atendimento mais ágil e seguro, com diagnósticos precisos e tratamentos completos, prevenindo complicações e reduzindo a necessidade de intervenções de urgência.

11.3 Além disso, a disponibilidade constante de materiais permitirá que o município cumpra as metas estabelecidas pela Política Nacional de Saúde Bucal, promovendo a equidade no acesso aos serviços de saúde e fortalecendo a confiança da população no SUS.

11.4 Outro resultado esperado é a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos, pois um cuidado odontológico adequado contribui para a saúde geral, o bem-estar e a autoestima dos pacientes.

11.5 Assim, a aquisição desses insumos busca não apenas atender às demandas imediatas, mas também contribuir para a sustentabilidade e eficiência do sistema de saúde pública em Cajati/SP.

## **12. DAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO (Art. 18, § 1º, inc. X):**

12.1 Antes da celebração do contrato, a administração deve adotar algumas providências essenciais. Isso inclui verificar a regularidade fiscal e jurídica da empresa contratada, elaborar e obter autorização orçamentária, além de garantir o atendimento as qualificações técnicas mencionadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

12.2 Essas medidas são fundamentais para garantir que a contratação seja realizada de forma adequada e em conformidade com as normas vigentes.

## **13. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (Art. 18, § 1º, inc. XI):**

13.1 Esta contratação não possui correlação ou interdependência com outras contratações no âmbito da Secretaria de Saúde.

## **14. DA DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (Art. 18, § 1º, inc. XII):**

14.1 Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, não se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores quanto à sua atividade.

## **15. DO POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (Art. 18, § 1º, inc. XIII):**

15.1 O posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina é favorável, considerando que a aquisição dos insumos odontológicos é essencial para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pelo Centro Odontológico.

15.2 A contratação é plenamente adequada e justificada, uma vez que atende diretamente às demandas de saúde bucal da população, assegura o cumprimento das metas estabelecidas pelas políticas públicas de saúde e reforça os princípios de equidade e justiça social.

15.3 A aquisição desses materiais não apenas mantém a operacionalidade do serviço, mas também promove a saúde e o bem-estar da comunidade, sendo, portanto, uma medida necessária e de grande relevância para o município.

## **16. RESPONSÁVEIS**

Conforme o Memorando nº 11.395/2024 na plataforma 1Doc, onde foi designada a servidora para compor a Equipe de Planejamento da Contratação, visando à elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP), como parte das demandas para fins de "**Aquisição de materiais odontológicos**", a saber:

**Bruna Morelli Rodrigues Pereira**  
Inscrito sob a Matrícula nº 4255  
**Escriturária**



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**  
- SÃO PAULO -  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



# ANEXO I



# MAPA DE PREÇOS - INSUMOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	PE nº 64/2023 - Ata nº 55/2023		WEBSITES/E-MAIL	
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
1	100	PCT	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM SABOR, PONTA			R\$ 34,43	R\$ 3.443,00
2	10	KIT	ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO EM KIT (1			R\$ 17,79	R\$ 177,90
3	10	UND	ABRIDOR DE BOCA ANATÔMICO PARA			R\$ 236,68	R\$ 2.366,80
4	15	PCT	ABRASIVO EM PÓ, PEDRA POMES, PARA			R\$ 13,49	R\$ 202,35
5	30	KIT	ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA -			R\$ 149,90	R\$ 4.497,00
6	60	UND	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - Sistema de	R\$ 90,89	R\$ 5.453,40		
7	200	GL	ÁGUA DEIONIZADA – Quimicamente pura, livres de	R\$ 8,80	R\$ 1.760,00		
8	10	CX	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA - Agulha gengival	R\$ 30,25	R\$ 302,50		
9	60	CX	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - Agulha gengival	R\$ 30,24	R\$ 1.814,40		
10	25	CX	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA - Agulha	R\$ 30,24	R\$ 756,00		
11	20	LT	ALCOOL ETILÍCO 92,8 IGPM (CATEGORIA	R\$ 6,79	R\$ 135,80		
12	800	LT	ALCOOL ETILÍCO A 70 % PARA	R\$ 5,28	R\$ 4.224,00		
13	120	CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO	R\$ 92,30	R\$ 11.076,00		
14	15	CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO	R\$ 115,76	R\$ 1.736,40		
15	5	CX	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO	R\$ 237,60	R\$ 1.188,00		
16	60	UND	ANESTÉSICO TÓPICO GEL - Frascos com 12g sabor	R\$ 13,00	R\$ 780,00		
17	150	UND	BABADOR DESCARTÁVEL – Indicado para proteger o	R\$ 13,90	R\$ 2.085,00		
18	10	UND	BICARBONATO DE SÓDIO - Bicarbonato de sódio	R\$ 9,99	R\$ 99,90		
19	100	UND	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22 COM CABO E	R\$ 0,44	R\$ 44,00		
20	100	UND	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 COM CABO E	R\$ 0,44	R\$ 44,00		
21	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1013 – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
22	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 – Broca	R\$ 2,14	R\$ 64,20		
23	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015 – Broca	R\$ 2,14	R\$ 64,20		
24	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca	R\$ 2,25	R\$ 67,50		
25	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1032 – Broca			R\$ 3,90	R\$ 117,00
26	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1033 – Broca			R\$ 3,90	R\$ 117,00
27	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1034 – Broca			R\$ 3,90	R\$ 117,00
28	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
29	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1112FF – Broca			R\$ 4,90	R\$ 147,00
30	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F – Broca			R\$ 18,39	R\$ 551,70
31	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F – Broca			R\$ 18,39	R\$ 551,70
32	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1190F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
33	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1302 – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
34	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1312 – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
35	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1342 – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
36	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 2135F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
37	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3118F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
38	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3168F – Broca			R\$ 20,90	R\$ 627,00
39	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195F – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
40	30	UND	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 3195FF – Broca			R\$ 3,99	R\$ 119,70
41	30	UND	BROCAS ZÉCRYA HL - Broca do tipo Zécrya número			R\$ 27,99	R\$ 839,70
42	15	UND	BLOCO PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO			R\$ 9,90	R\$ 148,50
43	30	PCT	CANUDO DESCARTAVEL EM PP, DIAM. 5,5 mm,			R\$ 3,27	R\$ 98,10
44	30	UND	CARIOSTÁTICO 30 % – Solução de diamino fluoreto	R\$ 20,16	R\$ 604,80		
45	5	UND	CIMENTO CIRÚRGICO – sem eugenol produzido	R\$ 114,00	R\$ 570,00		
46	15	UND	CIMENTO PROVISÓRIO ENDODÔNTICO COM	R\$ 22,91	R\$ 343,65		
47	6	UND	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ.	R\$ 21,53	R\$ 129,18		
48	6	UND	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO –	R\$ 7,32	R\$ 43,92		
49	150	LT	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO,	R\$ 20,86	R\$ 3.129,00		
50	20	UND	CLOREXIDINA 2% - Antisséptico com atividade	R\$ 3,84	R\$ 76,80		
51	20	UND	COLETOR PARA MATERIAL	R\$ 3,85	R\$ 77,00		
52	6000	UND	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL -	R\$ 0,52	R\$ 3.120,00		
53	200	PCT	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS,	R\$ 14,41	R\$ 2.882,00		
54	60	UND	CONDICIONADOR DENTAL GEL - Gel à base de	R\$ 3,61	R\$ 216,60		
55	10	KIT	CUNHA INTERDENTAL ANATÔMOCA DE			R\$ 54,90	R\$ 549,00
56	15	UND	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM	R\$ 7,67	R\$ 115,05		
57	100	UND	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora	R\$ 17,30	R\$ 1.730,00		

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F





58	30	UND	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,	R\$ 4,50	R\$ 135,00		
59	200	UND	ESCOVA ROBSON, PEQUENA, CERDA PLANA,			R\$ 3,09	R\$ 618,00
60	20	UND	ESPATULA PARA ODONTO PLÁSTICA,			R\$ 2,10	R\$ 42,00
61	100	UND	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO	R\$ 2,45	R\$ 245,00		
62	10	UND	ESPELHO TOUCADOR COM CABO, FORMATO			R\$ 28,90	R\$ 289,00
63	20	CX	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO	R\$ 40,49	R\$ 809,80		
64	40	UND	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA	R\$ 6,54	R\$ 261,60		
65	50	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON,	R\$ 34,80	R\$ 1.740,00		
66	20	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON,	R\$ 34,50	R\$ 690,00		
67	30	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON,	R\$ 36,40	R\$ 1.092,00		
68	10	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA SEDA, NÚMERO	R\$ 36,25	R\$ 362,50		
69	20	CX	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON,	R\$ 34,80	R\$ 696,00		
70	40	UND	FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui	R\$ 10,25	R\$ 410,00		
71	5	UND	FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, N°. 00,	R\$ 14,04	R\$ 70,20		
72	3	CX	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4			R\$ 208,99	R\$ 626,97
73	40	UND	FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA	R\$ 3,90	R\$ 156,00		
74	60	FR	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% -	R\$ 4,32	R\$ 259,20		
75	10	UND	FORMOCRESOL, SOLUÇÃO - Formula BUCKLEY,	R\$ 4,92	R\$ 49,20		
76	50	PCT	GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL	R\$ 10,00	R\$ 500,00		
77	6	UND	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO – Indicações: indicado	R\$ 12,89	R\$ 77,34		
78	15	UND	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - Indicação capeador	R\$ 4,37	R\$ 65,55		
79	100	LT	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%- Bactericida,	R\$ 2,73	R\$ 273,00		
80	20	CX	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo	R\$ 24,00	R\$ 480,00		
81	1	CX	INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE 5,			R\$ 224,91	R\$ 224,91
82	20	UND	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso	R\$ 22,82	R\$ 456,40		
83	80	KIT	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR DE			R\$ 139,90	R\$ 11.192,00
84	80	KIT	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR	R\$ 28,90	R\$ 2.312,00		
85	20	KIT	KIT REVELADOR E FIXADOR PARA FILME	R\$ 18,42	R\$ 368,40		
86	2	CX	LÂMINA DE BISTURÍ N°12 – Lâminas em aço carbono	R\$ 24,12	R\$ 48,24		
87	2	CX	LÂMINA DE BISTURÍ N°15 – Lâminas em aço carbono	R\$ 24,12	R\$ 48,24		
88	1000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5-	R\$ 1,05	R\$ 1.050,00		
89	1000	PAR	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 -	R\$ 1,05	R\$ 1.050,00		
90	3000	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5	R\$ 1,05	R\$ 3.150,00		
91	100	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX	R\$ 27,03	R\$ 2.703,00		
92	150	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO	R\$ 24,91	R\$ 3.736,50		
93	200	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M -	R\$ 24,82	R\$ 4.964,00		
94	500	CX	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P -	R\$ 24,82	R\$ 12.410,00		
95	15	UND	MANDRIL ODONTOLÓGICO, AÇO INOX,	R\$ 30,90	R\$ 463,50		
96	20	PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO			R\$ 11,90	R\$ 238,00
97	20	PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO			R\$ 14,00	R\$ 280,00
98	20	PCT	MATRIZ METÁLICA TOFFLEMIRE, TIPO			R\$ 16,90	R\$ 338,00
99	30	UND	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm - Matriz	R\$ 1,08	R\$ 32,40		
100	30	UND	MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm – Matriz de	R\$ 1,26	R\$ 37,80		
101	10	KIT	MATRIZ SECCIONAL PRE CONTORNADA - Kit			R\$ 79,90	R\$ 799,00
102	8	UND	MEDICAÇÃO OCLUSIVA; PASTA PARA	R\$ 29,85	R\$ 238,80		
103	5	CX	MOLDEIRAS DESCARTÁVEIS SORTIDAS PARA			R\$ 110,50	R\$ 552,50
104	40	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA	R\$ 16,25	R\$ 650,00		
105	30	UND	PAPACÁRIE DUO GEL – Apresentação: seringa com 1			R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
106	50	UND	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA	R\$ 4,62	R\$ 231,00		
107	30	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx100m - Composto	R\$ 42,63	R\$ 1.278,90		
108	15	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25cm x 100m- composto	R\$ 110,00	R\$ 1.650,00		
109	30	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100m- composto	R\$ 23,63	R\$ 708,90		
110	20	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m --	R\$ 118,00	R\$ 2.360,00		
111	50	RL	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m- composto	R\$ 34,89	R\$ 1.744,50		
112	15	UND	PARAMONOCLOROFENOL - material para	R\$ 6,84	R\$ 102,60		
113	25	UND	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Indicado para	R\$ 19,09	R\$ 477,25		
114	50	UND	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para	R\$ 4,53	R\$ 226,50		
115	5	UND	PEDRA DE AFIAR DE ARKANSAS,			R\$ 272,99	R\$ 1.364,95
116	20	CX	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL	R\$ 8,04	R\$ 160,80		
117	30	CX	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR	R\$ 8,04	R\$ 241,20		
118	6	UND	PORTA AMALGAMA ADULTO DE PLÁSTICO			R\$ 10,82	R\$ 64,92
119	5	KIT	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA	R\$ 47,40	R\$ 237,00		
120	30	UND	POTE DAPPEN, PLASTICO, AUTOCLAVÁVEL –	R\$ 2,19	R\$ 65,70		
121	20	UND	POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO	R\$ 2,52	R\$ 50,40		

122	30	UND	PRENDEDOR DE GUARDANAPO DE METAL			R\$ 9,90	R\$ 297,00
123	10	UND	RESINA COMPOSTA COR A1 - Z100	R\$ 34,21	R\$ 342,10		
124	30	UND	RESINA COMPOSTA COR A2 Z100	R\$ 34,21	R\$ 1.026,30		
125	15	UND	RESINA COMPOSTA COR A3 Z100	R\$ 34,21	R\$ 513,15		
126	15	UND	RESINA COMPOSTA A 3,5 Z 100	R\$ 34,21	R\$ 513,15		
127	15	UND	RESINA COMPOSTA A2 Z250	R\$ 52,13	R\$ 781,95		
128	15	UND	RESINA COMPOSTA A3 Z250	R\$ 52,13	R\$ 781,95		
129	6	UND	RESINA COMPOSTA COR OA2 - Resina composta	R\$ 34,21	R\$ 205,26		
130	6	UND	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta	R\$ 34,21	R\$ 205,26		
131	15	UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW	R\$ 10,60	R\$ 159,00		
132	15	UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW	R\$ 13,50	R\$ 202,50		
133	5	UND	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW	R\$ 24,00	R\$ 120,00		
134	6	KIT	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO	R\$ 16,05	R\$ 96,30		
135	500	UND	ROLETE DE ALGODÃO –com 100% de fibras de	R\$ 2,08	R\$ 1.040,00		
136	300	RL	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO-com fibra 100%	R\$ 13,05	R\$ 3.915,00		
137	100	PCT	SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL,			R\$ 2,19	R\$ 219,00
138	100	PCT	SACO PLASTICO LEITOSO 17x17cm, TIPO PARA			R\$ 5,00	R\$ 500,00
139	5	KIT	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS –	R\$ 69,20	R\$ 346,00		
140	20	UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-	R\$ 64,53	R\$ 1.290,60		
141	20	UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-	R\$ 64,53	R\$ 1.290,60		
142	20	UND	SISTEMA DE ACABAMNETO E POLIMENTO SOF-	R\$ 64,53	R\$ 1.290,60		
143	200	UND	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDRIGÊNIO 3% -			R\$ 2,29	R\$ 458,00
144	5	UND	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA – Especificação	R\$ 12,66	R\$ 63,30		
145	200	PCT	SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM	R\$ 7,10	R\$ 1.420,00		
146	50	UND	TIRA DE LIXA DE AÇO – Indicada para dar	R\$ 4,56	R\$ 228,00		
147	50	UND	TIRA DE LIXA DE AÇO – Indicada para dar	R\$ 4,56	R\$ 228,00		
148	15	CX	TIRA DE LIXA DE POLIESTER SOF-LEX	R\$ 42,55	R\$ 638,25		
149	100	PCT	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM	R\$ 9,32	R\$ 932,00		
150	6	UND	TRICRESOL - Tricresol formalina, indicado para casos	R\$ 5,00	R\$ 30,00		
151	10	UND	VASELINA SÓLIDA- Indicada como emoliente; mistura	R\$ 7,66	R\$ 76,60		
152	15	BIS	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz de flúor para uso			R\$ 187,99	R\$ 2.819,85
Total :				R\$ 114.095,59		R\$ 41.171,85	
Total Geral : R\$ 155.267,44							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli  
Exercício: 2024  
Página: 1/14

JL SOFT      RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

**Modalidade:** 12 - Pregão Eletrônico      **Sequência:** 64/2023      **Data Início:** 14/08/2023      **Ata:** 55/2023  
**Processo/Ano:** 552/2023      **Data da Licitação:** 18/07/2023      **Data Fim:** 14/08/2024

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0001	42.02462	ACABAMENTO E POLIMENTO PARA RESINA - em pontas de silicone flexíveis ;impregnadas com óxido de alumínio, não produzindo calor excessivo; caixa com 7 pontas sortidas {3 chama de vela, 2 taças e 2 discos }. Composição de tri polímero {estireno Butadieno-Metacrilato de Metila} Sílica Pirofítica Silanizada, Uretano Dimetanolamina e óxido de alumínio .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	50,6300	10,0000	506,30
0002	42.02463	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL -Sistema de adesivo de frasco único, utilizado para reparos em porcelana, em resinas, restauração em amálgama adesivo, dessensibilização de raízes expostas, primer e adesivo e um só frasco, solvente à base de água e álcool, alto rendimento, frascos de 6g rende até 280 gotas, menor espessura de película, sistema adesivo com nanotecnologia, contém cargas que proporcionam uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	90,8900	45,0000	4.090,05
0003	42.02464	Almotolia plástica branca, bico reto, com tampa presa ao bico, capacidade de 500 ml, graduada na lateral, autoclavável.	UND	3,8400	40,0000	153,60
0004	42.02465	ÁGUA DEIONIZADA –quimicamente pura, livres de íons, metais pesados etc. apenas os métodos de obtenção que são diferentes, seu uso é recomendado em autoclaves o que evita manchar os instrumentais cirúrgicos, e não causa depósitos nas paredes do equipamento. Característica do produto. Cristina, insípida, inodora, de pH 7,0. Galões contendo de 5l.validade mínima de 2 anos da data de entrega.	GL	8,8000	0,0000	0,00
0005	42.02466	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA- Agulha gengival longa em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.	CX	30,2500	5,0000	151,25
0006	42.02467	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA - Agulha gengival curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médio, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	30,2400	45,0000	1.360,80
0007	42.02468	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA CURTA - Agulha Gengival 30G extra curta em cânula em aço inoxidável recoberta com silicone grau médico, de alta flexibilidade, com bisel trifacetado, parede ultrafina, livre de látex, com canhão em plástico atóxico com seta indicadora que facilita o posicionamento correto do bisel. Acondicionado em embalagem plástica individual, esterilizado por óxido de etileno. Caixa com 100 unidades. Certificadas pelo INMETRO®. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	30,2400	15,0000	453,60
0008	42.02469	ALCOOL ETILÍCO 92,8 IGPM (CATEGORIA COMERCIAL) - FRASCO COM 1 LITRO - Liquido; com teor de no mínimo 92,8 IGPM ou 96 GI; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rotulo com nº de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência. Com registro na ANVISA. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	L	6,7900	0,0000	0,00



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 2/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0009	42.02470	ALCOOL ETILÍCO A 70 % PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES – FRASCO COM 1 LITRO – Indicado para desinfecção de superfícies e artigos semi e não críticos; frasco de 1 litro, contendo dados de identificação, nº de lote, validade e responsável técnico; em material que garanta a integridade do produto; a apresentação do produto devera atender a legislação atual vigente. Com registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	L	5,2800	500,0000	2.640,00
0010	42.02471	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 - Cloridrato de lidocaína 2% (20mg/mL) +Epinefina 10 µg /mL acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 ml, cada embalagem contém 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	92,3000	0,0000	0,00
0011	42.02472	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3% COM HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML - Anestésico local injetável, a base de lidocaína a 3% e norepinefrina, tubetes com 1,8 ml, embalados em caixa com 50 tubetes, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações de acordo com as normas de procedimentos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	115,7600	15,0000	1.736,40
0012	42.02473	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2 % SEM VASOCONSTRITOR - Tubetes com 1.8 ml, embalados em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação e recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	237,6000	5,0000	1.188,00
0013	42.02474	ANESTÉSICO TÓPICO GEL - Frascos com 12g sabor tutti-frutti, em forma de gel, benzocaina a 20%, hidrossolúvel, em pote, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	13,0000	20,0000	260,00
0014	42.02475	BABADOR DESCARTÁVEL - Indicado para proteger o paciente durante procedimentos odontológicos. Características: Impermeável e descartável; folhas de alta qualidade; com duas camadas: papel 28gr/m² + filme plástico; maior absorção dos líquidos; sem adesivo; medidas: 33x48cm; cor branca ou colorido. Embalagens com 100 unidades.	UND	13,9000	50,0000	695,00
0015	42.02476	BICARBONATO DE SÓDIO Bicarbonato de sódio odontológico; pó extrafino para polimento e profilaxia dental, pureza (99,6%), sem aroma, sem corantes; em frasco plástico; acondicionados em pote de 250g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, o produto deverá obedecer a legislação vigente; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	9,9900	10,0000	99,90
0016	42.02477	Bisturi descartável nº 22, composto por um cabo plástico resistente, com lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	0,4400	0,0000	0,00
0017	42.02478	Bisturi descartável nº 11, composto por um cabo plástico resistente, lâmina de aço de superior qualidade, isenta de manchas, rebarbas ou sinais de oxidação, afiada e com protetor plástico para a lâmina, embalado individualmente em blister plástico, garantindo a integridade e esterilidade do produto até o momento do uso. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	0,4400	0,0000	0,00
0018	42.02479	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1014 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1400	20,0000	42,80



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1000-41f7-89d9-0b9f.com.br/verificacao/880004789d9-0b9f>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 3/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0019	42.02480	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1015 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,1400	20,0000	42,8000
0020	42.02481	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1016 – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.	UND	2,2500	20,0000	45,0000
0022	42.02483	CARIOSTÁTICO – Solução de diamino fluoreto de prata a 30% em meio amoniacal, promove o fortalecimento da estrutura do esmalte pela formação de Ca F2(Fluoreto de Cálcio) e Ag3 PO4(Fosfato de Prata) através de sua reação com a estrutura dentária, além ainda da formação de complexos proteicos de prata na superfície do dente. A ação preventiva está relacionada com o íon fluoreto e a ação controladora com o íon prata. A ação cariostática se dá pela estimulação da esclerose da dentina, não permitindo o avanço da cárie dental. A ação antimicrobiana se dá principalmente por sua ação sobre o S. Mutans. Estudos relatam uma diminuição de 65% do índice de cárie em molares, com a aplicação trimestral de cariostáticos. Frasco contendo 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	20,1600	15,0000	302,4000
0023	42.02484	CIMENTO CIRÚRGICO – sem eugenol produzido através da mistura de seus componentes, ótima textura e plasticidade após a presa. Produto de uso exclusivo do cirurgião dentista. Composição da pasta base: ácido graxos, resina natural, resina sintética, óleo mineral, timol e cera natural. Composição da pasta aceleradora: óleo mineral, óleo vegetal, óxido de zinco, óxido de magnésio, pigmento de óxido de ferro, timol e BHT. Validade mínima: 2 anos da data de entrega.	UND	114,0000	4,0000	456,0000
0024	42.02485	CIMENTO PROVISÓRIO ENDODÔNTICO COM IODOFORMIO - Material temporário para obturação de canal radicular; com Iodofórmio que confere a pasta propriedade anti-infecciosa e intensa radiopacidade; pasta de Hidróxido de Cálcio pronta para o uso; de fácil aplicação; ação anti-bacteriana; que induz a formação de dentina reparadora; com consistência ideal para escoamento no canal radicular; apresentação: 1 seringa de 2,5g e 3 bicos aplicadores. Validade mínima de 12 meses da data de entrega.	UND	22,9100	5,0000	114,5500
0025	42.02486	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ (28g) + LIQ. (10ml) - Cimento de fosfato de zinco; conjunto de pó e líquido; pó em frasco com aproximadamente 28 gramas; composto basicamente de oxido de zinco com até 10% de oxido de magnésio e pigmentos; líquido em frasco com aproximadamente 10ml; composto basicamente por ácido ortofosfórico concentrado, água e fosfato al; embalado individualmente em caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	21,5300	6,0000	129,1800
0026	42.02487	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO benefícios massa de Fácil manipulação; Endurecimento rápido; Menor microinfiltração marginal. Características Obturador provisório normal. Aplicação: indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega APRESENTAÇÃO: Embalagem c/ 25g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	7,3200	4,0000	29,2800
0027	42.02488	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO, EMBALAGEM DE 1 LITRO – Solução antisséptica bucal, sabor menta, contendo gluconato de corthexidina a 0,12%, agente microbiano de amplo aspecto pronto para o uso. Embalagem contendo 1 litro. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	L	20,8600	90,0000	1.877,4000



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matras.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 4/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0028	42.02489	CLOREXIDINA 2%- Antisséptico com atividade antibacteriana, com eficácias para gram-negativas, fungos leveduras e alguns dermatófilos. Composição- digluconato de clorhexidina 2%, metilparabeno, água deionizada. (livre de álcool etílico) Frascos com 100ml. Validade mínima de 18 meses da data de entrega.	UND	3,8400	10,0000	38,4000
0029	42.02490	COLETOR PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE Capacidade para 05 litros, para desprezar todo material que corta ou perfura, como agulhas, lancetas, vidros em geral, lâminas de bisturi, ampolas, cateter, etc. Alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853.	UND	3,8500	10,0000	38,5000
0030	42.02491	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL ,com 13 fios, 7,5x7,5 cm ; em 100% de viscose branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado ; dobras uniformes e perfeitas variando de 08 dobras ;medindo 7,5cm x 7,5 cm; com formato quadrado ;estéril ;embalado com 10 unidades cada, embalado em material que garante a integridade do produto ;o produto deverá ser entregue com laudo analítico e laudo analítico laboratorial , de cumprimento da NBR 13843.validade mínima de 3 anos da data de entrega.	UND	0,5200	0,0000	0,5200
0031	42.02492	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS, 7,5x7,5 cm, NAO ESTÉRIL, PACOTE C/500 UND – Compressa de gaze hidrófila; em fios de algodão puro e branco; sem falhas ou fiapos soltos com 13 fios por cm quadrado; dobras uniformes e perfeitas variando de 5 dobras, 8 camadas, sem filamento radiopaco; medindo 7,5 x 7,5 cm; com formato quadrado; não estéril; embalado em pacote com 500 unidades que garanta a integridade do produto; o produto deverá ser entregue com laudo analítico conforme legislação vigente. Validade mínima de 4 anos da data de entrega	PCT	14,4100	0,0000	0,0000
0032	42.02493	CONDICIONADOR DENTAL GEL - Gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, espessado com Sílica Coloidal. Composição: Ácido Fosfórico, Sílica Coloidal, Surfactante e Corante. Embalagem com 3 seringas de 3 ml e 3 ponteiros p/ aplicação. Possui corante azul que facilita sua visualização e controle durante a aplicação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	3,6100	20,0000	72,2000
0033	42.02494	DESENSIBILIZANTE DE DENTINA, GEL, COM FLUORETO DE SÓDIO 2% E NITRATO DE POTÁSSIO, SER. 2,5g – Gel de baixa viscosidade dessensibilizante oclusivo à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2% que lhe conferem dupla ação dessensibilizante. Somente para uso profissional, contendo uma seringa com 2,5 g de produto e 1 ponteira. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	7,6700	7,0000	53,6900
0034	42.02495	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Solução Limpadora Enzimática. Composto por 4 enzimas (Protease, Lipase, Amilase e Carboidrase); sendo as principais; amilase e protease. Biodegradável, não espumante e não corrosiva. Contendo tensoativo não iônico, PH neutro, teste de comprovação das atividades das enzimas protease e amilase. Indicado para limpeza manual ou automatizada; específico para digerir matérias orgânicas com alta eficácia dos artigos em torno de 3 a 5 minutos. Embalagem contendo rótulo com identificação, procedência, instrução de uso, diluição do produto, prazo de validade, nº de lote. Embalagem com 1 litro. Validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega.	UND	17,3000	76,0000	1.316,4000
0035	42.02496	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, (tipo de unha) – Para uso na limpeza de artigos de pequeno e médio porte. Descrição: Escova plástica para limpeza delicada, cor sortida. Dimensões: 9.5 x 2.5 cm	UND	4,5000	0,0000	0,0000
0036	42.02497	ESPELHO BUCAL PLANO, N.5, S/CABO, ACO INOX - Espelho bucal plano num.05, s/cabo, imagem frontal de precisão, confeccionado conforme NBA 7153-1 em aço inoxidável polido, superfície espelhada s/dupla imagem, acabamento e polimento perfeitos, passível de esterilização em meios físico-químicos sem danificar o produto, embalado individualmente, marca comercial, procedência de fabricação.	UND	2,4500	0,0000	0,0000

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/8800041F7-89D9-0B9F-8800041F7-89D9-0B9F





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 5/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0037	42.02498	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA C/10 UNID.- tamanho 1x1x1 cm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	CX	40,4900	20,0000	809,80
0038	42.02499	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA SOLUÇÃO , frasco C/10 ml. Evidenciador de placa bacteriana em solução, em frasco c/10 ml, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima 2 anos a partir da data	UND	6,5400	15,0000	98,10
0039	42.02500	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 mono filamento preto, agulha 3/8 Circ –CT 20 mm- fio agulha de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 2,0 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.	CX	34,8000	30,0000	1.044,00
0040	42.02501	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 3-0 monofilamento preto, agulha 3/8 Circ –CT 15 mm- fio agulha de sutura nylon monofilamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 3-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em matéria que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente; caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos da data de entrega.	CX	34,4500	20,0000	689,00
0041	42.02502	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 4-0, mono filamento preto, agulha 3/8 Circ. – CT 15 mm - Fio agulhado de sutura nylon mono filamento, não absorvível, medindo 45 cm de comprimento, trançado número 4-0, agulhado, agulha triangular 3/8 circular CT 1,5 cm, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ser entregue de acordo com a legislação atual vigente, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	36,4000	0,0000	0,00
0042	42.02503	FIO AGULHADO PARA SUTURA SEDA, NÚMERO 4-0, Fio de Sutura de Seda Preta. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT 1,7cm.Fio sintetizado com material natural, filamento de Seda Natural e Trançada.* Esterilizado em Raio Gama.As agulhas são inspecionadas individualmente quanto à ponta, lubrificação e fixação para garantir punção fácil e segura.Atóxico, não pirogênico, de uso único e estéril. Embalados individualmente em Papel Grau Cirúrgicos, sendo que a embalagem primária trata-se de envelope metalizado internamente, garantindo a integridade do fio. Uso exclusivo em Odontologia.Validade mínima de 2 anos a partir da data de entrega.	CX	36,2500	0,0000	0,00
0043	42.02504	FIO AGULHADO PARA SUTURA NYLON, NÚMERO 5-0, AGULHA 3/8 Cir. - Fio de sutura de nylon obtido da proteína e goma do casulo do bicho da seda, n.5-0, preto trançado, agulhado -3/8 circ. triangular, CT 1,5cm, fio medindo 45 cm, uso odontológico, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, o produto deverá ter comprovação de sua esterilidade, caixa contendo 24 unidades. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	34,8000	20,0000	696,00
0044	42.02505	FIO DENTAL FIO DENTAL - Embalagem c/ 500 metros. Contribui para evitar a formação da placa, prevenir o tártaro e as cáries. Validade mínima de dois anos da data de entrega. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10,2500	10,0000	102,50
0045	42.02506	FIO PARA RETRAÇÃO GENGIVAL, Nº. 00, CORDÃO TRANÇADO MALEÁVEL, NÃO IMPREGNADO - Fio para retração gengival; composto por cordão trançado e maleável 100% algodão, não impregnado por substancia química, n. 00; embalado em frasco com 240 cm aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 02 ano da data de entrega.	UND	14,0400	5,0000	70,20

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/8800-417-80> o código 8800-417-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 6/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0046	42.02507	FILME P/RX, PERIAPICAL, ADULTO, 3X4 cm. Filme para radiografia periapical para adulto, 3 x 4cm, compatível com processamento manual, acondicionado em caixa com 150 unidades, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	172,8000	2,0000	345,60
0047	42.02508	FITA PARA AUTOCLAVE FITA PARA AUTOCLAVE - Fita utilizada como indicador de processo de esterilização a vapor em autoclaves. A viragem ocorre em listas negras bem identificáveis, após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Classe1(ISO11140-1). Apresentações: Medidas – 19mm x 30 m. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	3,9000	10,0000	39,00
0048	42.02509	FLÚOR GEL – Fluoreto fosfatado acidulado 1,23% - Tixotrópico, contendo fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propileno glicol, aroma, corante e água deionizada, 200 ml/208G. Sabor Morango. Constando externamente marca comercial e procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	FR	4,3200	50,0000	216,00
0049	42.02510	FORMOCRESOL, SOLUÇÃO - Formula BUCKLEY, frasco c/10 ml em solução, composição formula buckley, em frasco com 10 ml, embalado individualmente, constando externamente procedência de fabricação, recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4,9200	7,0000	34,44
0050	42.02511	GORRO CIRURGICO DESCARTÁVEL EM TNT POLIPROPILENO – Gorro cirúrgico descartável; em não tecido polipropileno, gramatura 50, branco, hipoalergenico, atóxico; com elástico na parte posterior; com formato anatômico; que permita ventilação adequada; embalagem com em material que garanta a integridade do produto; o produto deverá obedecer à legislação atual vigente. Contendo 10 unidades em cada pacote.	PCT	10,0000	30,0000	300,00
0051	42.02512	TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO – Atóxico 100% polipropileno, gramatura 20 colorido não estéril, diâmetro: 50 x 50 não inflamável, contendo 100 unidades em cada pacote. Validade mínima de 3 anos da data de entrega	PCT	9,3200	0,0000	0,00
0052	42.02513	HEMOSTÁTICO LIQUIDO – indicações: indicado para hemostasia e retração gengival, atuando como coadjuvante durante preparos cavitários para fins de restaurações, quando se necessita de um campo livre de sangramento. Composição: Álcoois, cloreto de alumínio, sulfato de hidroxiquinoloina e água purificada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	12,8900	5,0000	64,45
0053	42.02514	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. - Indicação capeador pulpar, material para induzir a formação da dentina reparadora, apresentando propriedades imprescindíveis para materiais que atuam em procedimentos sobre a dentina. Propriedades: Permitir um aumento da calcificação da camada de dentina preexistente dando melhores condições de proteção à polpa quando submetida a lesões;evitar que o procedimento ou material usado cause irritação às estruturas adjacentes. Na Endodontia é empregado como material intracanal, sendo potente antimicrobiano (pela inibição das enzimas bacterianas), possuindo excelente histocompatibilidade e estimula o tecido hospedeiro, favorecendo a reparação tecidual (pela ativação enzimática tecidual, gerando efeito mineralizador). Apresentação: frasco com 10g de Hidróxido de Cálcio P.A. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4,3700	12,0000	52,44
0054	42.02515	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - Bactericida, desinfectante ,ação química de solvente de tecidos, antisséptico, característica físico química de baixa tensão superficial ,embalagem contendo 1000 ml. Validade mínima 2 anos da data de entrega.	L	2,7300	0,0000	0,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.br/verificacao>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 7/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0055	42.02516	INDICADOR BIOLÓGICO - Ampolas contendo esporos que permitem monitoração do funcionamento da Autoclave, oferecendo, com seu uso periódico, confiabilidade e segurança ao processo de esterilização. Conforme NBR ISO 11138-3, cada ampola contém em seu interior uma população definida de <i>GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS</i> que irá reagir sensivelmente ao processo, indicando a eficácia do ciclo de esterilização, após o período de incubação. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	CX	24,0000	5,0000	120,0000
0056	42.02517	IODOFÓRMIO - Iodofórmio; em pó; para uso endodôntico; em frasco com aproximadamente 10 g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	22,8200	0,0000	0,0000
0057	42.02518	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR pó/líquido, cor U - universal. Frasco com 10g - Ionômero de vidro para restauração, possuindo comprovada adesão do esmalte à dentina, aliada as propriedades anticariogênicas com liberação de flúor. Ionômero pó (10g), composto de Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, Sulfato de Bário, Ácido Poliacrílico. Pigmentos, composição do líquido: Ácido Tartárico e Água Destilada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	28,9000	35,0000	1.011,5000
0058	42.02519	KIT REVELADOR E FIXADOR PARA FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO – REVELADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (85-90%), sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona (1-5%), com 475ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. FIXADOR: Para radiografias periapicais, contendo água (80-85%), tiossulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%), com 475 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega. Ambos deverão ser da mesma marca comercial.	KIT	18,4200	0,0000	0,0000
0059	42.02520	LÂMINA DE BISTURÍ Nº12 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	24,1200	1,0000	24,1200
0060	42.02521	LÂMINA DE BISTURÍ Nº15 – Lâminas em aço carbono em embalagens com 100 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	24,1200	1,0000	24,1200
0061	42.02522	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas , oferecendo a máxima proteção e conforto. Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima de 3 anos da data de entrega.	PAR	1,0500	400,0000	420,0000
0062	42.02523	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 7,0 - Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.	PAR	1,0500	0,0000	0,0000
0063	42.02524	LUVA CIRÚRGICA ESTEREL TAMANHO 7,5 Indicada para procedimentos cirúrgicos e que ofereça proteção para as mãos de agentes biológicos (cirurgia); Características: alta sensibilidade para controle e manuseio dos procedimentos cirúrgicos, de látex estéril lubrificada com pó, com superfície texturizada e antiderrapante, com formato anatômico, fortes e elásticas oferecendo a máxima proteção e conforto; Esterilização: Raios Gama ou Feixes de Elétron. Validade mínima 3 anos a partir da data de entrega.	PAR	1,0500	900,0000	945,0000

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://e-cadastr>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 8/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0064	42.02525	LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX SEM TALCO TAMANHO M - Luva totalmente isenta de pó, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam reações alérgicas ao contato com o amido (pó). Apresenta microtextura antiderrapante. Microtexturizada. Ação Antiderrapante. Totalmente isenta de pó. Hipoalergênica. Ambidestra. Embalagem: 100 Unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	27,0375	0,0000	0,0000
0065	42.02526	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP- Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega	CX	24,9109	0,0000	0,0000
0066	42.02527	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	24,8273	200,0000	4.965,46
0067	42.02528	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - Luvas de procedimentos não cirúrgico lisa. Descrição: fabricada em látex, não estéril, ambidestra, punho com bainha, produto de uso único, talcada com pó bioabsorvível atóxico e ambidestra. Indicação: Proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos. Embalagem: 100 unidades /caixa. Validade mínima 2 anos a partir da data de entrega.	CX	24,8273	0,0000	0,0000
0068	42.02529	MANDRIL ODONTOLÓGICO, AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, PARA ENCAIXE DE DISCOS POP-ON- Para polimento e acabamento de restaurações, adaptação em contra- ângulo, com haste de 15mm de comprimento; embalagem individual que garanta a integridade do produto; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.	UND	30,9000	0,0000	0,0000
0069	42.02530	MATRIZ DE AÇO, ROLO DE 5mm X 50cm - Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 5mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. Validade mínima de 2 nos da data de entrega.	UND	1,0800	0,0000	0,0000
0070	42.02531	MATRIZ DE AÇO, ROLO de 7mm x 50cm – Matriz de aço para restaurações de amálgama; em rolo de 7mm x 50cm; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação .Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	1,2600	30,0000	38,2800
0071	42.02532	MEDICAÇÃO OCLUSIVA; PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE - Medicação oclusiva; pasta para tratamento de alveolite composta basicamente por: Lidocaína, Eugenol, Laurilsulfato de sódio, Carbonato de cálcio, Penghawar djambi, Azeite, Água purificada e Aroma natural de hortelã; Composição do aroma natural de hortelã: mistura de óleo essencial de hortelã-verde e de óleo essencial de eucalipto; exclusivamente para uso tópico; embalada em frasco de 12 g; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. Validade mínima de 18 meses da data da entrega.	UND	29,8500	5,0000	149,2500
0072	42.02533	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA/BAIXA ROTAÇÃO – Lubrificante para instrumentos de alta e baixa rotação, óleo lubrificante mineral, ação detergente e bactericida, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos que previnem oxidação e reduzem o atrito entre as paredes móveis, frascos com 200ml, acompanhados de bicos aplicadores. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	16,2500	15,0000	243,7500
0073	42.02534	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE AZUL E VERMELHO utilizado para marcação de pontos oclusais possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais que atinja anatomicamente os pontos oclusais. Possua folhas especiais 100% vegetal de dupla face na cor azul e vermelha e 100 micras de espessura. Embalagem com 10 folhas -25mm x 97 mm. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4,6200	15,0000	69,3000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 9/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0074	42.02535	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10cmx100m - Composto de Papel Grau Cirúrgico e filme laminado Poliéster/Polipropileno. Com barreira bacteriológica, laudo de Citotoxicidade, laudo de Filtração Viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – Sistemas de embalagem grau cirúrgico para Saúde e Registro na ANVISA 80473960001. Compatível para máquina seladora manual de embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. Contendo indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	42,6300	20,0000	852,60
0075	42.02536	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	110,0000	5,0000	550,00
0076	42.02537	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	23,6300	0,0000	0,00
0077	42.02538	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 17cm X 100m -- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	118,0000	10,0000	1.180,00
0078	42.02539	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 7cm x 100m- composto de papel grau cirúrgico e filme laminado poliéster/prolipropileno.com barreira bacteriológica, laudo de citoxidade, laudo de filtração viral (VFE) atendendo a norma NBR 14.990 – sistemas de embalagem grau cirúrgico para saúde e registro na ANVISA 80473960001 – compatível para maquina seladora manual de embalagens confeccionada em papel grau cirúrgico de uso médico e odontológico. contendo ainda indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno, selagem tripla sentido de abertura do envelope .Validade mínima 2 anos da data de entrega.	RL	34,8900	10,0000	348,90
0079	42.02540	PARAMONOCLOROFENOL -material para desinfecção de canal radicular, com medicação curativa intracanal, efeito antibacteriano de curta duração, com a presença de nitrofurazona, apresentação em frasco de 20ml . Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	6,8400	10,0000	68,40

informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F para verificação das assinaturas, acesse <https://caja120.doc.com.br/verificaca>

Assinado por: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificação da validade das assinaturas, acesse <https://caja120.doc.com.br/verificaca>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 10/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0080	42.02541	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Não inibe a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresenta uma coloração semelhante à da dentina, o que impede a influência na coloração final das restaurações em resinas compostas. Formulado para apresentar alta resistência à dissolução causada pelos ácidos utilizados no condicionamento das estruturas dentais. Estojo com: 1 Tubo de Pasta Base de 13 gramas + 1 Tubo de Pasta Catalizadora de 11 gramas + 1 Bloco de Mistura. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	19,0900	15,0000	286,35
0081	42.02542	PASTA PROFILÁTICA 90GR – Pasta indicada para utilização em procedimentos de limpeza, remoção de detritos, manchas, placas bacterianas, polimento, com sabor refrescante e abrasivo adequadamente dosado Apresentação em bisnaga de 90gr. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	4,5300	30,0000	135,90
0082	42.02543	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL EXTRAFINO - Indicado para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90º, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	8,0400	10,0000	80,40
0083	42.02544	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL REGULAR - Indicados para levar e aplicar soluções como: evidenciadores, adesivos, selantes, soluções hemostáticas, ácidos etc. Aplicadores com pontas em fibra não absorventes e resistentes à abrasão com minúsculas fibras isentam de fiapos que permite a aplicação precisa de soluções em áreas de difícil acesso, dobram facilmente até 90º, apresentação um tubo com 100 aplicadores cada. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	8,0400	10,0000	80,40
0084	42.02545	POSICIONADOR RADIOGRÁFICO PARA EXAMES PERIAPICAIS PARALELISMO ADULTO - Kit com 4 peças sendo dois posicionadores laterais posteriores superior e inferior , um posicionador frontal e um para exames de bite wing, autoclavável, com pote especial que permite a esterilização das peças em seu interior e garanta a esterilização de forma mais segura e prática, mordedor em silicone, peças reversíveis que alternam para dentes superiores e inferiores, peças desmontáveis, utilizados para dentes anteriores e posteriores, esterilização química e autoclavável, tamanho adulto.	KIT	47,4000	2,0000	94,80
0085	42.02546	POTE DAPPEN, PLASTICO, AUTOCLAVÁVEL – Pote Dappen; plástico; composto a base de nylon; com boa resistência; esterilizável em autoclave a 137°C; possuindo duas cavidades para as manipulações; Medindo: altura 3 cm, concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml, concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml; possuindo 12 dimensões; embalagem Individual.	UND	2,1900	0,0000	0,00
0086	42.02547	POTE DAPPEN, VIDRO TEMPERADO COLORIDO, AUTOCLAVÁVEL - Pote Dappen; de vidro temperado colorido, autoclavável; espessura mínima de 3 mm, sextavado, sem rebarba, com 2 concavidades e capacidade de 5ml e 2ml; para manipulação de materiais odontológicos; embalagem individual.	UND	2,5200	0,0000	0,00
0087	42.02548	RESINA COMPOSTA A 3,5 Z 100 FOTOPOLIMERIZÁVEL- Resina micro hibrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	34,2100	2,0000	68,42

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://cajati.sp.gov.br/verificacao>





ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 11/14 0

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0088	42.02549	RESINA COMPOSTA A2- Z 250 FOTOPOLIMERIZÁVELRESINA COMPOSTA COR A2 FILTEK Z250 XT - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	52,1300	10,0000	521,3000
0089	42.02550	RESINA COMPOSTA A3- Z 250 FOTOPOLIMERIZÁVELRESINA COMPOSTA COR A3 FILTEK Z250 XT - Resina micro híbrida fotopolimerizável; composta com carga inorgânica única de 100% de zircônia/sílica; seringa com 4g; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, proced. de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	52,1300	0,0000	0,0000
0090	42.02551	RESINA COMPOSTA COR A1 - Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL - Resina micro-híbrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	34,2100	7,0000	239,4700
0091	42.02552	RESINA COMPOSTA COR A2-Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	34,2100	0,0000	0,0000
0092	42.02553	RESINA COMPOSTA COR A3-Z100 FOTOPOLIMERIZAVEL - Resina micro híbrida, seringa com 4 g; composta basicamente por zircônia/sílica, bis-GMA e TEGDMA; com conteúdo de carga inorgânica de 66% em volume e 84,5% em peso com tamanho de partícula que varia de 3.5 a 0.01 micrômetros e tamanho médio de 0,6 micrômetros; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, recomendações p/armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	34,2100	0,0000	0,0000
0093	42.02554	RESINA COMPOSTA COR OA2 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação : seringa de 4q. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	38,5300	6,0000	231,9180

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1docsig.com.br>



ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 12/14 90

JL SOFT

### RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0094	42.02555	RESINA COMPOSTA COR OA3 - Resina composta micro-híbrida à base de Microglass para dentes anteriores e posteriores. De manipulação fácil e rápida (não-pegajosa), fácil de ser esculpido, excelente acabamento e polimento, seleção de cores rápida e precisa, efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural, três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. Partículas com alta transmissibilidade, radiopaca, tamanho médio de partículas: 0,7 microns, liberação de fluoretos /recarregável. Excelente adaptação marginal, resistente à descoloração marginal, resistente ao desgaste, não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista, excelente lisura superficial. Apresentação: seringa de 4g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	36,1500	6,0000	216,9000
0095	42.02556	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A2 - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fôssulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g na cor A2. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	10,6000	7,0000	74,2000
0096	42.02557	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW COR A3 - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fôssulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: Seringa com 1,2g na cor A3. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	13,5000	4,0000	54,0000
0097	42.02558	RESINA COMPOSTA HÍBRIDA NATURAL FLOW OPACA - Indicada para restaurações classe III, classe V, selamentos de fôssulas e fissuras, cimentação de facetas de porcelana, reparo em resina composta, colagem de fragmentos. Não solúvel nos fluidos bucais, promovendo inacreditável estética, disponível nas cores da escala vita, fotoativada, tixotrópico. Com registro na ANVISA. Apresentação: seringa com 2,4g na cor OPACA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	UND	24,0000	3,0000	72,0000
0098	42.02559	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO REFORÇADO TIPO II, À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL-KIT PÓ 38g E LIQUIDO 15ml – Cimento de óxido de zinco uso odontológico; tipo II reforçado para restaurações temporárias de longa espera; apresentação kit pó e líquido; pó cor marfim em frasco com aproximadamente 38g; composto basicamente de óxido de zinco metacrilato de metila; líquido em frasco com aproximadamente 15ml; composto basicamente por eugenol 99,5%e ácido acético 0,5%; embalado individualmente kit pó, líquido, conta gotas + colher dosadora; constando externamente marca comercial e procedência. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	16,0500	4,0000	64,2000
0099	42.02560	ROLETES DE ALGODÃO – com 100% de fibras de algodão, em formato cilíndrico compactado, não estéril, com alto poder de absorção de saliva, fluidos e sangue, extra macio, pacotes contendo 100 bastões cilíndricos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	2,0800	200,0000	416,0000
0100	42.02561	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO - com fibra 100% algodão, alvejado, isento de produtos químicos; embalagem contendo 01 rolo de 500g. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	RL	13,0500	130,0000	1.696,5000
0103	42.02564	SELANTES PARA FÓSSULAS E FISSURAS – Apresentação Kit contendo 5 seringas de selantes com 2 gramas cada, 1 seringa de condicionador dental gel com 3 ml e vinte pontas aplicadoras descartáveis, de fácil aplicação; fotopolimerizável, com 50% de peso de cargas inorgânicas, libera flúor, cor matizado, com alto índice de adesão, proteção por período mais longo. Validade mínima de 2 anos da data de entrega	KIT	69,2000	3,0000	207,6000
0104	42.02565	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO FINA – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra- ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	64,5300	5,0000	322,6500

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 13/14

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

JL SOFT

Cd. Item	Cd. Produto	Descrição	Unidade	Vi. Unitário	Qtd. Saldo	Vi. Total (Saldo)
0105	42.02566	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO MÉDIA – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra- ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	64,5300	5,0000	322,65
0106	42.02567	SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO SOF-LEX POP-ON GRANULAÇÃO GROSSA – Lixas em discos com 01 granulação grossa, de cor preta, tamanho 1/2, com centro metálico que facilite o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra- ângulo. Embalagem com 30 discos. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	64,5300	5,0000	322,65
0107	42.02568	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA –acondicionada em frasco com 10 ml. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	12,6600	2,0000	25,32
0108	42.02569	SUGADORES DESCARTÁVEIS DE SALIVA COM 40 UND - sugador descartável de saliva. Tubo confeccionado em PVC transparente e atóxico com arame em aço especial, desenvolvido para a fixação imediata na posição desejada para o profissional, ponteira confeccionada em PVC macio e atóxico, vazada e aromatizada artificialmente em tutti- frutti colorido, rosa, verde ,transparente e azul; cada pacote contendo 40 unidades. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	PCT	7,1000	100,0000	710,00
0109	42.02570	TIRA DE LIXA DE AÇO – indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 6 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 6 mm x 150mm.Embalagem individualmente ;constando Externamente Marca comercial, procedência de fabricação.	UND	4,5600	50,0000	228,00
0110	42.02571	TIRA DE LIXA DE AÇO – indicada para dar acabamento e polimento nas restaurações dentais de amalgama entre dois dentes. Características: confeccionadas em aço inox, possuindo face abrasiva de ótima qualidade; medindo: 4 mm X 150mm. Embalagem contendo 12 unidades de 4 mm x 150mm.Embalagem individualmente ;constando Externamente Marca comercial, procedência de fabricação.	UND	4,5600	50,0000	228,00
0111	42.02572	TIRA DE LIXA DE POLIESTER Sof –Lex- indicada para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Características : tamanho das tiras 4 mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Tira possuindo um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies Inter proximais dos dentes. apresentação: caixa com 50 tiras .com registro na ANVISA. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	CX	42,5500	0,0000	0,00
0112	42.02573	TRICRESOL - Tricresol formalina, indicado para casos de necropulpectomia, composição: formaldeído, O-cresol, álcool etílico 96º e água purificada; apresentação: cx. contendo um frasco com 10ml de solução. Embalagem com 50 tiras. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	UND	5,0000	5,0000	25,00
0113	42.02574	VASELINA SÓLIDA - Indicada como emoliente; mistura de hidrocarbonetos parafinicos, naftênicos e aromáticos; auxilia no tratamento de rachaduras de pele, como umectante; tem efeito emoliente e melhora a elasticidade; embalagem com 1 pote de 90g. Validade de no mínimo 2 anos da data de entrega.	UND	7,6600	6,0000	45,96
0114	42.02575	VERNIZ COM FLÚOR - Verniz; a base de resina natural ou sintética com 5% de fluoreto de sódio ou 2,26% de íon flúor; compatível com aplicação tópica de flúor; em frasco com 10 ml, com acessórios conforme o fabricante; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	KIT	25,2400	0,0000	0,00

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bruna.morelli.rodriques.pereira.docosign.com.br/verificacao>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: bruna.morelli

Exercício: 2024

Página: 14/14

JL SOFT

RELAÇÃO DE SALDO DISPONÍVEL PARA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Valor Total: 40.233,48

CAJATI, 13 de Agosto de 2024.

Rosemeire Vieira dos Santos  
Diretora do Departamento de Suprimentos  
RG 29.009.502-5


Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



A loja mais completa do  
Brasil!

Consulte **FRETE GRÁTIS\*** para **SUL** e **SUDESTE** acima de  
R\$450,00 (/faq/envio-e-frete/)

Até **6x** SEM juros  
(/faq/formas-de-  
pagamento/)

Entregas Nacionais 



**MAGAZINE  
MÉDICA**.COM



Bem Vindo

Entre

(/accounts/registro/login/)

ou



cadastre-se

(/accounts/registro/login/)



Fale

conosco  
(/ajuda/)



0

O que você procura?



INICIAL (/) / DESCARTÁVEIS (/CATEGORIAS/DESCARTAVEIS/) / ABAIXADORES DE LÍNGUA (/CATEGORIAS/DESCARTAVEIS/ABAIXADORES-DE-LINGUA/) / ABAIXADOR DE LÍNGUA MODELO ANIMAL JUNIOR 40 UN TIC-TONG

# Abaixador de Língua Modelo Animal Junior 40 UN TIC-TONG

Cód.: 7353



(/marcas/tic-tong/)

★★★★★

De R\$ 41,18

**Por R\$ 34,43 à vista**

no pix (5% desc. já calculado)

No cartão em **1x de R\$ 34,80** sem juros (4% de desc. já calculado)

 **FORMAS DE PAGAMENTO**



Agosto com ➡ cashback ⬅ de até R\$ 100! Use ainda neste mês. 



[Home](#) > [Instrumentais](#) > [Abridor De Boca](#) > Abridor De Boca Abritec - Maquira



Abridor De Boca Abritec - Maquira

Embalagem com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Escolha a cor.  
Cod. de Referência: DC11372

★★★★★ (7)

A PARTIR DE 2 unidades, PAGUE R\$ 16,69 CADA.

Escolha uma opção \*

Escolha uma opção...

~~R\$20,90~~ 15% OFF

R\$17,79

—

1

+





Olá, seja bem-vindo(a)!

Atendimento ao cliente: 43 3378 8300

Rastrear minha compra



o que procura hoje?



Precisa de ajuda?



Minha conta



Meu carrinho

USO  
GERAL

CIRURGIA E  
ESTERILIZAÇÃO

DENTÍSTICA E  
ESTÉTICA

ENDODONTIA

FOTOGRAFIA

RADIOLOGIA

POR  
ITEM

IMPLANTODONTIA

CATEGORIAS



VÍDEO



# ABRIDOR DE BOCA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ABRITEC PCD INDUSBELLO

DESTAQUE

0 OPINIÕES

**R\$ 236,68**

R\$ 227,21 à vista com desconto ou 3x de R\$  
78,89 Sem juros

[Mais informações](#)

1

COMPRA





## DESCRIÇÃO GERAL

é um produto que foi produzido em conjunto com a Dra. Andreia de Aquino Marsiglio, uma profissional que vive as adversidades do meio e nos auxiliou na produção desse produto inovador que vem fazendo a diferença na rotina dos profissionais da área odontológica

### ABRITEC PcD

Abridor de boca indicado para uso em Pessoas com Deficiências.

Agosto com ➡ cashback ➡ de até R\$ 100! Use ainda neste mês. ➡

[Home](#) > [Prevenção e Profilaxia](#) > [Pedra Pomes](#) > Pedra Pomes Extra Fina - Maquira

1/3



## Pedra Pomes Extra Fina - Maquira

Embalagem com 1 unidade de 100g.

Cod. de Referência: 384765

A PARTIR DE 2 unidades, PAGUE  
R\$ 12,69 CADA.~~R\$15,90~~ 15% OFF**R\$13,49**

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

+Adicionar a lista de desejos✓

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

**Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento ▼

Detalhes ^

1Doc: Memorando 11- 11.395/2024 198/6450



## Kit para Acabamento e Polimento de Resina

### Enhance Sortida CA com 07 unidades - Dentsply

Cód 187020003

(0)

**R\$ 149,90**

3% de desconto no boleto à vista

1 x R\$ 149,90 sem juros

Resgate por 12000 pontos  
no **Surya Club**

Quantidade



1



seus favoritos com até **50% off**

Aproveite

[Laboratório](#)[Universitários](#)[Home](#) > [Prótese Clínica](#) > [Ponta Diamantada](#) > Ponta Diamantada Esférica FG - AllPrime

## Ponta Diamantada Esférica FG - AllPrime

Embalagem com 1 unidade

Cod. de Referência: ALP913

Cód Fabricante: 101101013

★★★★★ (2)

### Escolha uma opção

1013

~~R\$5,90~~ 32% OFF**R\$3,99**

— 1

**Adicionar ao Carrinho**

Adicionar a lista de desejos

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicial é de 10 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Mais Speed.** ganhar muitas vantagens

1Doc: Memorando 11- 11.395/2024 200/6450

DentalMaster > Materiais de Consumo > Brocas Diamantadas

CÔNICA INVERTIDA/DUPLO	CÓD.	ISO/FIG.	Ø	L <sup>1</sup>	L <sup>2</sup>	Granulometria	
	1153	225/807	016	4.0	16.5		
	1031	010/805	009	0.9	19		
	1032	010/805	010	1.0	19		
	1033	010/805	012	1.0	19		  
	1034	010/805	014	1.0	19		  
	1035	010/805	016	1.6	19		  
	1036	010/805	018	1.8	19		  

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F







PONTA DIAMANTADA CÔNICA INVERTIDA

Cód. 16012 | Marca: Microdont

1153

AVISE-ME

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

OK



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F

AVISE-ME

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

OK

1032

Por: **R\$ 3,90**

-

1

+

ADICIONAR AO CARRINHO

1033

 Compra 100% segura

AVISE-ME

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

OK

1034

AVISE-ME

Para ser avisado da disponibilidade deste Produto, basta preencher os campos abaixo.

OK



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F





Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ▼   🛒

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

Q Pesquise por caracte








♡   -46%

~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99

📄 Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

	Ponta Diamantada FG N° 1016HL - Microdont Cód 047026001	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1
	Ponta Diamantada FG N° 1111 - Microdont Cód 047026002	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1
	Ponta Diamantada FG N° 1111F - Microdont Cód 047026003	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1
	Ponta Diamantada FG N° 1112 - Microdont Cód 047026004	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1
	Ponta Diamantada FG N° 1112F - Microdont Cód 047026005	R\$ 3,99 <del>R\$ 7,39</del>	— 1

Ver mais variações   Mais informações

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caja.11doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F

Agosto com ➡ cashback ⬅ de até R\$ 100! Use ainda neste mês. 



[Home](#) > [Brocas](#) > [Broca Diamantada](#) > Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - Fava

1/2



### Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - Fava

Embalagem com 1 unidade. FG (alta rotação). Escolha o modelo.  
Cod. de Referência: DC11434H


★★★★★ (6)

Escolha uma opção \*

Escolha uma opção...

R\$4,90





—

1

+

Adicionar ao Carrinho

+

Adicionar a lista de desejos

▼

Calcular frete e prazo

Digite o CEP

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Calcular

- Lovers. Acumule e troque por benefícios exclusivos.
- Frete Grátis. Em compras acima de R\$ 200.
- Troca Grátis. Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento

▼

Detalhes

^

## Broca Diamantada Ponta Cônica

- Haste fabricada em aço inoxidável.
- Ponta diamantada com formato cônico extremidade em chama.
- Feita em diferentes granulações:  
Ultrafina (FF) Amarelo - 20µm.  
Fina (F) Vermelho - 40µm.  
Média (ø) Cinza - 100µm.  
Grossa (G) Verde - 125µm.
- Ponta diamantada para alta rotação (FG).
- Validade: indeterminada.
- Registro ANVISA: 81629170009.

## Nível de Rotação

A rotação varia conforme o diâmetro da parte ativa da broca:

- ISO 0,09mm - rotação 450,000.
- ISO 0,25mm - rotação 300,000.

## Dimensões das Brocas Fava (comprimento total - parte ativa)

- 1112: 19mm – 5,0mm.
- 1112F: 19mm – 5,0mm.
- 1112FF: 19mm – 5,0mm.
- 1112G: 19mm – 5,0mm.
- 1190: 19mm – 3,2mm.





- 1190F: 19mm – 3,2mm.
- 1190FF: 19mm – 3,2mm.
- 1191F: 19mm – 1,0mm.
- 2112: 19mm – 6,0mm.
- 2137F: 19mm – 1,0mm.
- 2191: 24mm – 1,0mm.
- 2200: 21mm – 10,0mm.
- 2200F: 21mm – 7,0mm.
- 2200FF: 21mm – 7,0mm.
- 3113: 20mm – 8,0mm.
- 3113FF: 20mm – 8,0mm.
- 3138: 19mm – 1,0mm.
- 3138F: 19mm – 1,0mm.
- 3193: 24mm – 8,0mm.
- 3193F: 24mm – 8,0mm.
- 3195: 24mm – 1,0mm.
- 3195F: 24mm – 10mm.
- 3195FF: 24mm – 10,0mm.
- 3200: 24mm – 10,0mm.
- 3203: 24mm – 10,0mm.
- 3203F: 24mm – 10,0mm.
- 3205: 24mm – 10,0mm.
- 4114: 22mm – 10,0mm.



**URGENTE :::: Solicitação de cotação - BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO**

Gestão Saúde Cajati &lt;gestaosaudecajati@gmail.com&gt;

13 de agosto de 2024 às 10:47

Cco: licitacao01@cralab.com.br, distribuidorasupermed@outlook.com, sysma@sysmasolucoes.com.br, licitacao@distrimedica.com.br, medmaia16@gmail.com, licitacao@cmfdistribuidora.com.br, licitacao@panoramamed.com.br, licitacao@jgpharma.com.br, dental@dentalcentrosul.com.br, ybpcomercial@gmail.com, licitach3negocios@gmail.com, licitacaomaxxidistribuidora@gmail.com, dimecedro@yahoo.com.br, licitacao@prohospital.com.br, licitacao2@fprinter.com.br, doc.pharmaplus@hotmail.com, licitacao2@licitacoes.londrina.br, licitacao@evencomercial.com.br, financeiro.odg@hotmail.com, licitacao@gtgroup.net.br, pregaoeletronico.erimed@outlook.com, licita@forlabexpress.com.br, drogariacasanova@gmail.com, ppf-innova@live.com, licitacao2@renylab.ind.br, pglima.lic@gmail.com, licitacao.ipo@gmail.com, miamimedlicita@gmail.com, financeiro@solutemedical.com.br, dfmedical10@gmail.com, dauana.silva@maquira.com.br, dismathdistribuidora@gmail.com, diagnosticacomercial2@gmail.com, cpm0308@gmail.com, edilberto.brabo@biomedica.bio.br, prscgoiania@gmail.com, costadistribuidora2024@gmail.com, licitacao@ebram.com, mjdistribuidora@gmail.com, licitacao@novamed-saude.com, a2xrcomercial@outlook.com, geison\_guimaraes@outlook.com, tcjm@tcjmimport.com, sabrina@dipromfarma.com.br, licitacao.hospitalar@maquira.com.br, jhmaquinaspr@hotmail.com, distribuidorakmmmedical@gmail.com, 3tprodutosuniversal@gmail.com, PEROLA IMPORTADORA <perolaimportadora@gmail.com>, brumedadm@gmail.com, lokalmed@outlook.com, ursaltda@gmail.com, originalbandeiras@gmail.com, inovacoes.licitacoes@outlook.com, fusao.licita@hotmail.com, calulicacoes@gmail.com, licitacao@dentalprimecwb.com.br, licitacao@hiperdental.com.br, licitacao@hcgroudpobrasil.com, licitacao@athenaprodutos.com.br, olimpoequipamentos@gmail.com, licitacao@higix.com.br, licitacao@dentaxodonto.com.br, prepara.negocios@gmail.com, editais@poluxcomercial.com.br, ynemed.saude@gmail.com, cirurgiaabiomedica@hotmail.com, licitacoes@altermed.com.br, licitacaovl@gmail.com, contrato.02@majlab.com.br, licita@equipsul.com, saopaulohospitalar@gmail.com, licita@dldental.com.br, camilaprodosimo@hotmail.com, licitacao2@emigeodonto.com.br, gm.distribuidorabr@gmail.com, diabeticos.epp@hotmail.com, multifarmaltda@gmail.com, odontomedicontratos@outlook.com, omar.mourad@primemedhospitalar.com.br, copaulista@live.com, comercial@erdobrasil.com.br

Prezado(s),  
Bom dia!

Solicito, gentilmente, cotação de preços para **Aquisição de brocas de alta rotação** para uso do Centro Odontológico do município, conforme segue:

\* **30 UND** : BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

\* **30 UND** : BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F – Broca diamantada para preparo cavitário, em aço inoxidável, ponta com granulação uniforme, encaixe em aço inoxidável adaptável às diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação e sem rebarbas. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde.

**Aguardo retorno o mais breve possível.**

Atenciosamente,

--

**Bruna Morelli R. Pereira**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
Prefeitura Municipal de Cajati/SP  
CNPJ 64.037.815/0001-28  
Telefone: (13)3854-8500 | Ramal: 2156  
[www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br)

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



Gestão Saúde Cajati &lt;gestaosaudecajati@gmail.com&gt;

---

**Orçamento GM Distribuidora**

---

**Comercial2** <comercial2@gmdistribuidora.com.br>

13 de agosto de 2024 às 16:10

Para: "gestaosaudecajati@gmail.com" &lt;gestaosaudecajati@gmail.com&gt;

Boa Tarde !!!

Segue o Anexo do Orçamento Referente aos Produtos Odontológicos / Brocas de Rotação Sorensen.

Atendemos Também em nosso Portifólio, Produtos De Enfermagem, Odontológicos, Fisioterapêuticos, Clínicos e Equipamentos Médicos.

Demais Duvidas e Esclarecimentos Responderemos Via este E-mail ou Telefone / WhatsApp.

**José Henrique**

13/08/2024

**José Henrique**  
Auxiliar administrativo

17 99681-6379

f@IGM\_DISTRIBUIDORASAUDE  
www.gmdistribuidora.com.br**Orçamento GM Distribuidora ao Municipio de Cajati - São Paulo.pdf**  
32601KAssinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



# GM Distribuidora

Materiais hospitalares, odontológicos  
fisioterapia e equipamentos para saúde

GM Distribuidora de Materiais Odontológicos, Médicos e Hospitalares  
CNPJ: 33.521.966/0001-23  
IE: 743.008.589.116  
Rua Martina Dias Fernandes, 31 Conjunto HBTC. Benedito Zancaner  
Telefone: 17 99681-6379 - 17 99686-1199  
comercial2@gmdistribuidora.com.br  
administracao@gmdistribuidora.com.br

**Prefeitura Municipal de Cajati - São Paulo**  
Centro Odontológico do município  
**Orçamento para Aquisição de brocas de alta rotação**

Lote	DESCRIÇÃO	Unidade	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Final
1	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1116F	Unidade	Sorensen	30	R\$ 18,39	R\$ 551,70
2	BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO 1168F	Unidade	Sorensen	30	R\$ 18,39	R\$ 551,70
Total						R\$ 1.103,40

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 Dias  
PRAZO DE ENTREGA: 07 Dias  
FATURAMENTO MINIMO : R\$ 200,00  
PRAZO DE PAGAMENTO : 30 Dias  
MARIANA PRUDENCIO DE AGUIAR  
CPF : 399.235.898-46  
RG : 46.248.095-1  
DADOS BANCARIOS DA PESSOA JURIDICA:  
GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODNTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES  
BANCO: 001  
AGENCIA: 50 - 7  
CONTA: 590371

GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS  
MEDIC:3352196600123  
0123

Assinado de forma digital por GM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS  
MEDIC:33521966000123  
Dados: 2024.08.13 16:08:32 -03'00'

**GM Distribuidora de Materiais Odontológicos, Medicos e Hospitalares**  
13 de Agosto de 2024  
Elisario / Sp



🔍

Pesquise por produtos ou marcas

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000 (0)



R\$ 7,39

R\$ 3,99

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros



📄 Resgate por 450 pontos no **Surya Club**

Selecionar variações

🔍

1190

×

	<div>Ponta Diamantada FG N° 1190 - Microdont</div> <div>Cód 047026008</div>	<div>R\$ 3,99 R\$ 7,39</div> <div><div>—</div><div>1</div><div>+</div></div>	<div>Adicionar</div>
	<div>Ponta Diamantada FG N° 1190F - Microdont</div> <div>Cód 047026009</div>	<div>R\$ 3,99 R\$ 7,39</div> <div><div>—</div><div>1</div><div>+</div></div>	<div>Adicionar</div>
	<div>Ponta Diamantada FG N° 1190EF - Microdont</div> <div>Cód 047026046</div>	<div>R\$ 3,99 R\$ 7,39</div> <div><div>—</div><div>1</div><div>+</div></div>	<div>Adicionar</div>

Mais informações Avaliações do produto





Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ▾   🏠

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya Club

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont   🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações   🔍 1312



Ponta Diamantada FG N° 1312 - Microdont   R\$ 3,99 ~~R\$ 7,39~~  
Cód 047026011   — 1


~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   📄 Resgate por 450 pontos no Surya Club


3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros


Você está economizando R\$ 3,40



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F






Pesquise por produtos ou marcas

Categorias

Entrar 

Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000 (0)


Selecionar variações

 1302



Ponta Diamantada FG N° 1302 - Microdont  
Cód 047026010

~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99

 Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ▾   🏠

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya Club

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont   🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações   🔍 1342



Ponta Diamantada FG N° 1342 - Microdont   R\$ 3,99 ~~R\$ 7,99~~  
Cód 047026012   — 1

~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   📄 Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ▼   🏠

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

Q 2135



Ponta Diamantada FG N° 2135EF - Microdont   R\$ 3,99 ~~R\$ 7,99~~  
Cód 047026057   —   1



Ponta Diamantada FG N° 2135F - Microdont  
Cód 047026058

~~R\$ 7,99~~  
R\$ 3,99   📄 Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F





Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ▼   🏠

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

Q 311



Ponta Diamantada FG N° 3118F - Microdont  
Cód 047026044

~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F

Agosto com  
de até R\$ 100![Home](#) > [Brocas](#) > [Broca Diamantada](#) > Ponta Diamantada Chama FG - KG Sorensen

## Ponta Diamantada Chama FG - KG Sorensen

Unidade. Alta Rotação. Escolha a numeração.

Cod. de Referência: 376838

★★★★★ ( [avaliar!](#) )

### Escolha uma opção \*

3168F

**R\$20,90**

—

1

+

**Adicionar ao Carrinho**

+Adicionar a lista de desejos

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Calcular**



**Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.



**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.



**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

**Formas de pagamento**



**Detalhes**



1Doc: Memorando 11- 11.395/2024

218/6450





Q Pesquise por produtos ou marcas

♡   👤 Entrar   ▼   🏠

☰ Todas categorias   Saldão   Equipamentos   Harmonização   Endodontia   Ortodontia   Dentística   Descartáveis   Surya

🏠 > Marcas > Microdont > Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

🔗 Compartilhar

Ponta diamantada para alta rotacao - Microdont

Cód 047026000   (0)

Selecionar variações

Q 3195



Ponta Diamantada FG N° 3195F - Microdont  
Cód 047026080

~~R\$ 7,39~~  
R\$ 3,99   📄 Resgate por 450 pontos no Surya Club

3% de desconto no boleto à vista  
1 x R\$ 3,99 sem juros

Você está economizando R\$ 3,40

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F





Descrição

Espelho de mão para procedimentos clínicos.

- Espelho toucador com cabo.
- Disponível em diversas cores.
- 19,5cm de comprimento.

Espelho de Mão - Ortoguaru

Cód.: P28R|002169    Ortoguaru

UNIDADE. ESCOLHA A COR.

R\$ 28,90

ou 5% Desconto à vista no Boleto ou Pix

	AZUL	R\$ 28,90 /cada	- 1 +	Adicionar
	CRISTAL	R\$ 28,90 /cada	- 1 +	Adicionar
	ROSA	R\$ 28,90 /cada	- 1 +	Adicionar
	VERDE	R\$ 28,90 /cada	- 1 +	Adicionar
	LARANJA	R\$ 28,90 /cada	- 1 +	Adicionar

Quem Viu Comprou Também

Espelho de Mão com Glitter - Confort Odonto	Espéculo Hartmann Adulto 2 - Quinelato	Saca Prótese Pneumático Automático - BSZ	Espátula de Inserção de Fio Retrator Fischer Ultrapak Pequena -...	Gancho para Castração - BSZ	Espátula de Inserção de Fio Retrator Fischer Ultrapak Pequena -...
a partir de R\$ 34,63	a partir de R\$ 234,07	a partir de R\$ 729,90	a partir de R\$ 388,90	a partir de R\$ 93,90	a partir de R\$ 388,90
		4x de R\$ 182,47 sem juros	2x de R\$ 194,45 sem juros	Disponível em 2 opções	2x de R\$ 194,45 sem juros
Adicionar	Adicionar	Adicionar	Adicionar	Adicionar	Adicionar



Home > Radiologia > Filme Radiográfico > Filme Radiográfico Adulto Periapical E-Speed - Carestream

1/4



Filme Radiográfico Adulto Periapical E-Speed - Carestream

Embalagem com 150 unidades.

Cod. de Referência: 238693

★★★★★ (71)

R\$239,90 13% OFF

R\$208,99

2x de R\$104,50 sem juros

—1+

Adicionar ao Carrinho

+Adicionar a lista de desejos▼

Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular

♥ Lovers. Acumule e troque por benefícios exclusivos.

🚚 Frete Grátis. Em compras acima de R\$ 200.

↔ Troca Grátis. Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento▼

Detalhes

Filme Radiográfico Odontológico

- Filme E-Speed Radiográfico para Odontologia.
- Cor azul.
- Modelo: adulto.
- Velocidade intermediária (Velocidade E).
- Compatibilidade com os métodos de processamento manual e automático.
- Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.
- Registro ANVISA: 80378750033.

Aplicação▼

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F








[Laboratório](#)  
[Universitários](#)

[Home](#) > [Dentística e Estética](#) > [Ionômero de Vidro](#) > Ionômero De Vidro Restaurador Vitro Molar - DFL

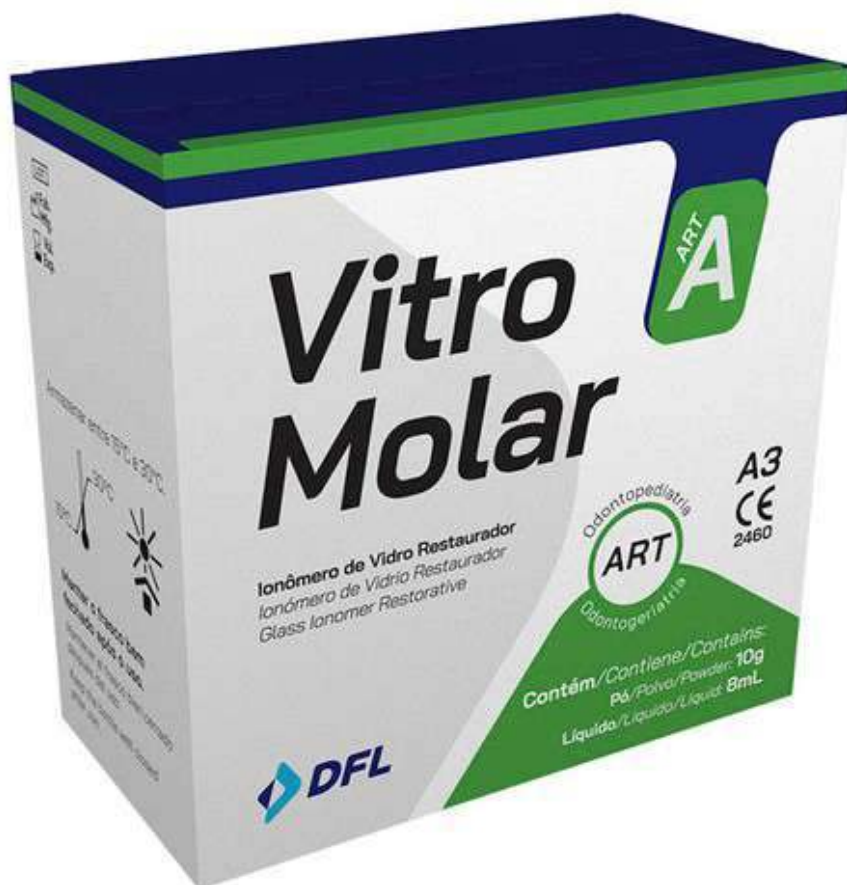

## Ionômero De Vidro Restaurador Vitro Molar - DFL

Kit com 10g de pó + 8ml de líquido.

Cod. de Referência:  
DVM7998A

Cód Fabricante: 51041

★★★★★ (1)

**R\$139,90**

— 1 +

Adicionar  
ao  
Carrinho

Adicionar a lista de  
desejos

**Calcular frete e  
prazo**

A previsão de entrega  
inicia-se após a emissão  
da Nota Fiscal.

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



Agosto com  
de até R\$ 100![Home](#) > [Dentística e Estética](#) > [Matriz](#) > Banda Aço Matriz Tofflemire Nº 1 - Microdont

1/4



## Banda Aço Matriz Tofflemire Nº 1 - Microdont

Embalagem c/ 12 unidades.

Cod. de Referência: 109109

★★★★★ ( [avaliar!](#) )**R\$11,90**

— 1 +

**Adicionar ao Carrinho**

+Adicionar a lista de desejos✓

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Calcular****Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.**Formas de pagamento** ▼**Detalhes** ^

Sua principal característica é a flexibilidade que permite facilmente contornar as paredes, melhorando a

1Doc: Memorando 11- 11.395/2024 224/6450

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



O que você está buscando?



[Início](#) > [Produtos Odontológicos](#) > [Endodontia](#) > [Matriz Seccional Pré-Contornada Odontológica Sortida C/50 - Lysanda](#)

## Matriz Seccional Pré-Contornada Odontológica Sortida C/50 - Lysanda

**R\$79,90**

12 x de R\$8,10

[Ver mais detalhes](#)

**15% OFF COMPRANDO 5 OU MAIS!**

Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.

COMPRAR

Meios de envio

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)

### Descrição

Descrição

Ao navegar por este site **você aceita o uso de cookies** para agilizar a sua experiência de compra.

ENTENDI

1Doc: Memorando 11- 11.395/2024 225/6450

[https://www.newdentale.com.br/produtos/matriz-seccional-pre-contornada-odontologica-sortida-c-50-lysanda/?variant=788146918&pf=mc&gad\\_s...](https://www.newdentale.com.br/produtos/matriz-seccional-pre-contornada-odontologica-sortida-c-50-lysanda/?variant=788146918&pf=mc&gad_s...)

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F







O que você está buscando?



Início > Produtos Odontológicos > Ceras > Moldeira De Cera Descartável - Aplicação de Flúor - Lysanda

## Moldeira De Cera Descartável - Aplicação de Flúor - Lysanda

**R\$110,50**

12 x de R\$11,20

[Ver mais detalhes](#)

**15% OFF COMPRANDO 5 OU MAIS!**

Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.

Cor: **Sortida**



Quantidade: **100**

50 100

< 1 >

COMPRAR

Meios de envio

Seu CEP

CALCULAR

[Não sei meu CEP](#)



Busque aqui seu produto



## Papacárie Duo Gel

Embalagem com 1 seringa com 1ml.

FÓRMULA & AÇÃO

Código do produto: 026031

**R\$ 150,00**

Quantidade:

1

Adicionar ao carrinho



Calcule frete e prazo



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F> e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F





[Laboratório](#)  
[Universitários](#)

[Home](#) > [Instrumentais](#) > [Acessórios](#) > [Pedra para Afiar](#) > Pedra para Afiar Arkansas - Hu-Friedy

1/2



## Pedra para Afiar Arkansas - Hu-Friedy

Embalagem com 1 unidade.

Cod. de Referência: HUF11680A

Cód Fabricante: SS4

★★★★★ (1)

~~R\$286,90~~ 5% OFF

**R\$272,99**

2x de R\$136,50 sem juros

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

+Adicionar a lista de desejos

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular



**Mais Speed.** Pontue para ganhar muitos descontos e vantagens



**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 199.



**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F>



receba **cashback** campeão de **5%**

Aproveite

Olá, o que você procura?



Precisa de Ajuda?

2ª via Boleto

0

categorias Acadêmicos Endodontia Ortodontia Dentística e Estética Descartáveis Instrumentais Harmonização Orofacial

Home > Instrumentais > Porta Amálgama > Porta Amalgama Delrin de Plástico - Jon

Porta Amalgama Delrin de Plástico - Jon

Código: 2003

A partir de R\$ 24,84 economize R\$ 14,02

Condições de pagamento

R\$ 10,82

Preço Quantidade

R\$ 10,82

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Compre e receba de volta até R\$ 0,54!



Calcular o frete

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Compartilhar

Descrição do Produto

Embalagem com 1 unidade

CARACTERÍSTICAS

- Material Plástico;
- Autoclavável;
- Validade: Indeterminada;
- Registro ANVISA: 10415649017.

INDICAÇÃO

- Indicado para transporte e inserção de amalgama na cavidade dentária.

Quem viu, viu também

-56%



Porta Amalgama Delrin de Plástico - Jon  
Embalagem com 1 unidade

R\$ 24,84 R\$ 10,82

- 1 +



Porta Amálgama Micro - Golgran  
Embalagem com 1 unidade

R\$ 63,90

- 1 +



Porta Amálgama de Plástico - Maquira  
Embalagem com 1 unidade

R\$ 19,90

- 1 +



Porta Amálgama - Uma  
Embalagem com 1 unidade

R\$ 27,93

- 1 +



Porta Amálgama Simples - Golgran  
Embalagem com 1 unidade

R\$ 93,36

- 1 +



Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F e informe o código 8800-41F7-89D9-0B9F



[Laboratório](#)[Universitários](#)[Home](#) > [Instrumentais](#) > [Prendedor de Guardanapo](#) > Prendedor de Guardanapo Jacaré Corrente - Preven

1/2



## Prendedor de Guardanapo Jacaré Corrente - Preven

Embalagem com 1 unidade.

Cod. de Referência: PRE16194A

Cód Fabricante: 358

★★★★★ (2)

**R\$9,90**

- 1 +

**Adicionar ao Carrinho**

+ Adicionar a lista de desejos

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

**Calcular****Mais Speed.** Pontue para ganhar muitos descontos e vantagens**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 199.**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.**Formas de pagamento** ▾Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F>

Agosto com **cashback**  
de até **R\$ 100!**[Home](#) > [Biossegurança](#) > [Protetor Descartável](#) > Saco Plástico Sacolé - Segplast

1/2



## Saco Plástico Sacolé - Segplast

Embalagem com 100 unidades. 5cm x 23cm.

Cod. de Referência: 600599

★★★★★ (13)

**R\$2,19**

— 1 +

Adicionar ao Carrinho

+Adicionar a lista de desejos✓

### Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da Nota Fiscal.

Digite o CEP

Calcular



**Lovers.** Acumule e troque por benefícios exclusivos.



**Frete Grátis.** Em compras acima de R\$ 200.



**Troca Grátis.** Você tem 07 dias a partir da data de recebimento.

Formas de pagamento



Detalhes



\* Embalagem com 100 unidades.

1Doc: Memorando 11- 11.395/2024

231/6450







Super ofertas

Departamentos

Cursos

Descartáveis

Embalagens

Ingredientes


Pintura

Perfumaria

Marcas

Tire suas dúvidas

Saco Plástico para Hambúguer ou Tapioca "G" 17x17cm Montyplast (100 unidades)

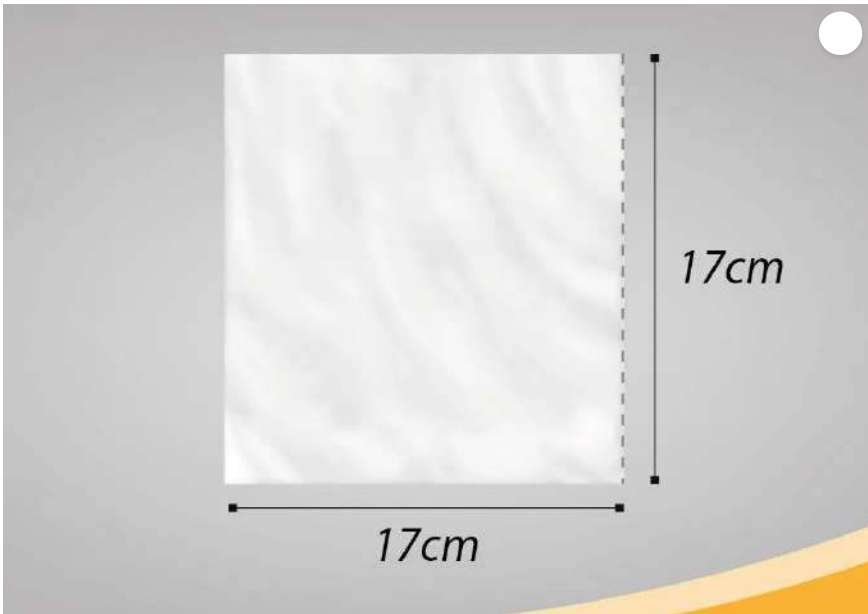

[adicionar aos favoritos](#)

Compartilhar



Saco Plástico para Hambúguer ou Tapioca "G" 17x17cm Montyplast (100 unidades)

[ver as avaliações](#)

Código de barras: 247376

Saco plástico para Hambúguer e Tapiocas grande  
Produzido em Polietileno de Alta Densidade

Ver mais

RECEBA EM ATÉ 24H ÚTEIS

R\$ 5,00

Valor promocional

Compre 10 por R\$ 4,00 cada

- 1 +

Comprar

Insira seu CEP

Calcular

[Não sei meu CEP](#)

### Descrição do produto

Saco plástico para Hambúguer e Tapiocas grande

Produzido em Polietileno de Alta Densidade 100% virgem na cor branca

Produto inodoro e atóxico

Dimensões:

17cm Largura

17cm Altura

Embalagem contém 100 sacos

### Especificações

Material

Polietileno de Alta Densidade

Modelo

Sacos Fundo Reto

### Avaliações



Classificação média: 0 (0 avaliações)

[Faça login para escrever uma avaliação](#)

Nenhuma avaliação

### Promoções



novidade



Pague com PIX

E GANHE 5% OFF NO SEU PEDIDO

Aprove

Categorias Esterilização Estetoscópios Descartáveis Veterinária Novidades Rotina T

Acadêmica

Digite o que você procura...

Home Antisseptico Curativos Agua Oxigenada 10 Volumes Antisseptica 100ml - FARMAX FARMACEUTICOS



18%  
OFF

# Água Oxigenada 10 Volumes Antisséptic 100ml - FARMAX FARMACEUTICOS

(avaliar agora!)

Cód.: FAR26360A

Embalagem com 1 unidade.

R\$2,79 por  
**R\$2,29**

Quantidade

1

## Calcular frete e prazo

A previsão de entrega inicia-se após a emissão da nota fiscal.

Calcular Frete

## Detalhes

Água Oxigenada 100ml 10V

- A água oxigenada 10 volumes da Farmax é um produto com peróxido de hidrogênio a 3% para uso tópico ou em gargarejos.
- É utilizado em locais previamente limpos para assepsia de feridas e queimaduras.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Fabricante: Farmax
- Produto: Água Oxigenada 10 Volumes
- Uso: Antisséptico Tópico e Gargarejos
- Volume: 100 ml
- Validade: 36 meses

### COMPOSIÇÃO

- Peróxido de Hidrogênio 3%.
- Excipientes: Água Purificada, Fenacetina, Ácido Fosfórico.

Assinado por 1 pessoa: BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8800-41f7-89d9-0b9f> e informe o código 8800-41f7-89d9-0b9f



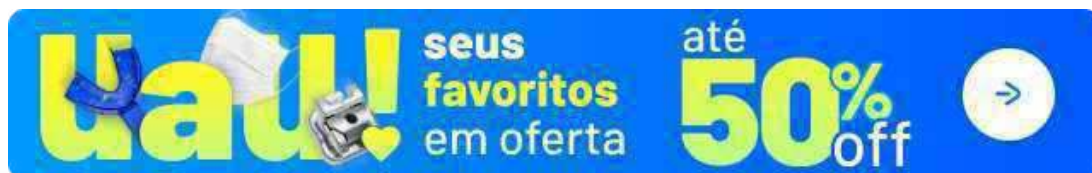

[Laboratório](#)  
[Universitários](#)

[Home](#) > [Prevenção e Profilaxia](#) > [Verniz](#) > Verniz de Flúor Duraphat - Colgate



1/5



## Verniz de Flúor Duraphat - Colgate

Embalagem com 10ml.

Cod. de Referência: COL4839A

Cód Fabricante: FBR10612

★★★★★ (9)

ATENÇÃO! Produto de venda restrita a cirurgiões-dentistas com inscrição ativa em conselho profissional, pessoas jurídicas que prestem serviços odontológicos e estudantes de odontologia.

Nas compras em  
**COLGATE**

Compre acima de **R\$1.499** e  
ganhe 1 **Kit churrasqueira**

Compre acima de **R\$2.999** e  
ganhe 1 **Churrasqueira**

~~R\$216,90~~ 13% OFF

**R\$187,99**

1Doc: Memorando 11- 11.395/2024 234/6450





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8800-41F7-89D9-0B9F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



BRUNA MORELLI RODRIGUES PEREIRA (CPF 427.XXX.XXX-74) em 14/08/2024 11:45:56  
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8800-41F7-89D9-0B9F>

**Memorando 12- 11.395/2024**

**De:** Gustavo C. - SEADM-DAGEP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/08/2024 às 12:10:20

Prezados,

O ETP apresentado pela equipe possui todos os elementos do art. 18, § 1º, da Lei Federal 14.133/2021 e, por isso, está apto a produzir seus efeitos. Esta análise, de caráter formal, não adentra aos aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da prática do referido ato administrativo (ou seja, não analisa o mérito), que estão reservados à autoridade competente. Por fim, as unidades requisitantes cumpriram a fase de planejamento.

Desta forma, solicitamos que seja elaborado o respectivo **Termo de Referência e encaminhado ao Departamento de Suprimentos** **sem novo despacho neste memorando**, para o prosseguimento da contratação da melhor solução apresentada pela unidade demandante.

Atenciosamente,

—

**Gustavo Henrique Martins Cordeiro**  
*Agente Administrativo*